

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции изменения № 1 от 05.12.2014)
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 12 мая 2013 г. № 16383

Наименование типа средств измерений и их обозначение:

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ208ВУ.

Назначение и область применения:

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ208ВУ (далее - счетчики) предназначены для измерения только активной или активной и реактивной энергии в одном или в двух направлениях в однофазных двухпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

Область применения: промышленность, энергетика и другие области хозяйственной деятельности.

Описание:

Счетчики имеют в своем составе: один или два измерительных элемента (шунт или трансформатор тока, два шунта или шунт и трансформатор тока, один измерительный шунт в цепи фазы и индикатор в цепи нейтрали), микроконтроллер, энергонезависимую память данных, встроенные часы реального времени (позволяющие вести учет электрической энергии по нескольким тарифам, тарифным зонам суток), испытательные выходные устройства (электрическое, оптическое), интерфейс для работы в системах автоматизированного учета потребленной электрической энергии, ЖК-дисплей для просмотра измеряемой информации.

Принцип действия счетчиков основан на измерении аналого-цифровым преобразователем мгновенных значений входных сигналов напряжения и тока в цепи «фазы» и в цепи «нуля» для двухэлементных счетчиков или только в цепи «фазы» для одноэлементных счетчиков, с последующим вычислением микроконтроллером значений активной энергии и других параметров сети. В зависимости от исполнения, счетчики могут измерять среднеквадратические значения напряжений и токов, активной, реактивной и полной мощности, реактивной энергии, частоты сети.

Параметризация счетчиков производится с помощью свободно распространяемого технологического ПО «AdminTools», которое доступно для скачивания с сайта производителя (www.energomera.by).

Счетчики подключаются к сети переменного тока непосредственно.

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа средств измерений приведена в приложении 3.



CE208BY XX.XXX.X.XXX.XXX XXX

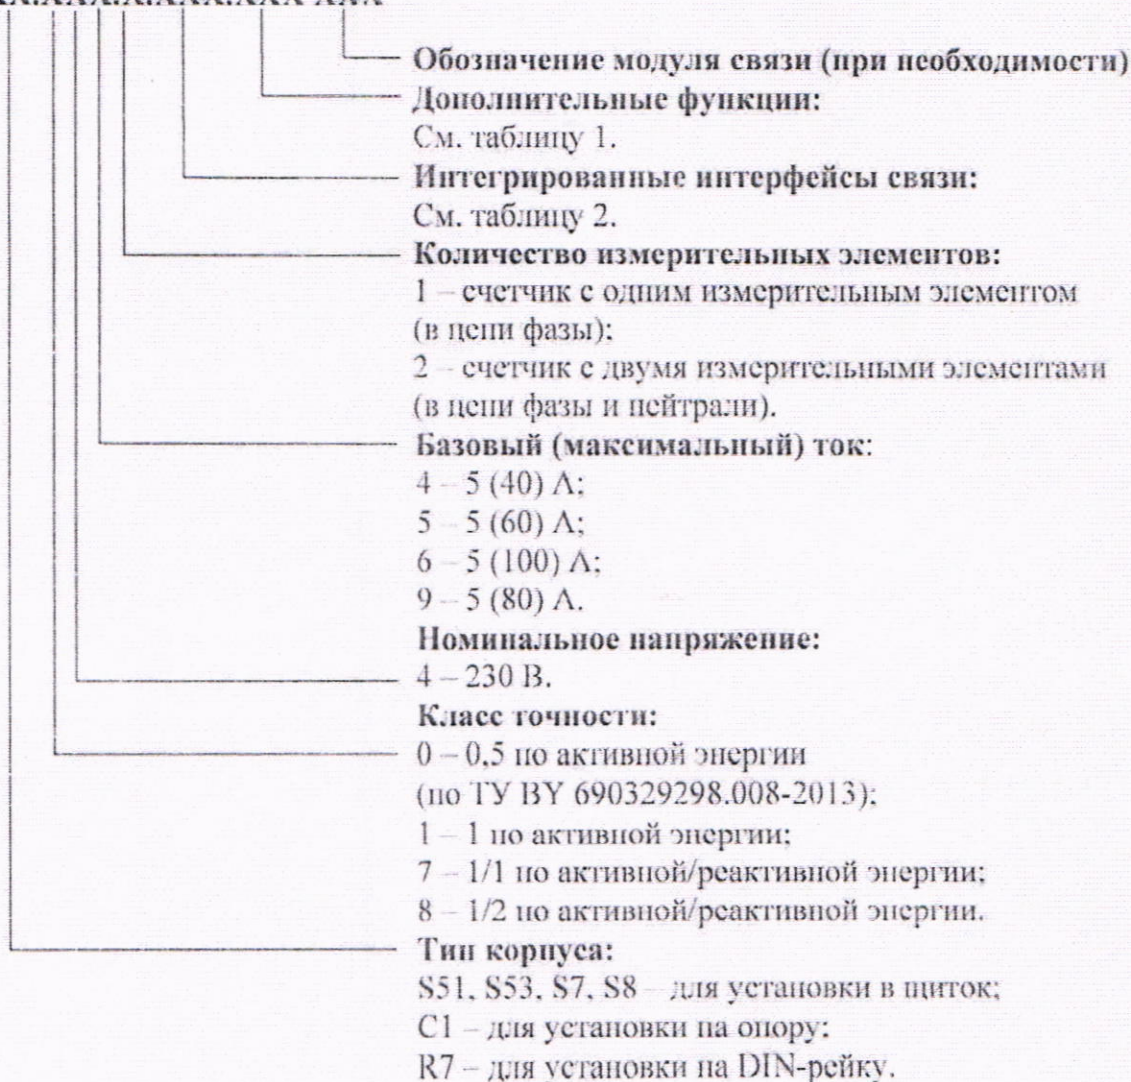


Рисунок 1 - Структура условного обозначения счетчиков

Таблица 1 - Дополнительные функции

№ п/п	Обозначение	Дополнительная функция
1	Q	Реле управления
2	S	Реле сигнализации
3	U	Параметры сети
4	Y	2 направления учета
5	K	Телеметрический выход
6	V	Электронная пломба
7	F	Датчик постоянного магнитного поля
8	M	Датчик переменного магнитного поля
9	L	Подсветка ЖКИ
10	Z	С расширенным набором данных
11	N	С пониженным потреблением по напряжению
12	C	Поддержка протокола обмена СПОД



Таблица 2 - Интегрированные интерфейсы связи

№ п/п	Обозначение	Интерфейс
1	J	Оптический порт
2	A	RS485
3	P	PLC
4	R	Радиоинтерфейс с встроенной антенной
5	R1	Радиоинтерфейс с внутренней и внешней антенной
6	G	GSM
7	E	Ethernet
8	W	WiFi

Обязательные метрологические требования: представлены в таблицах 3, 4.

Таблица 3

Наименование	Значение
Класс точности по активной энергии: по ГОСТ 31819.21-2012	1
по ТУ ВУ 690329298.008-2013	0,5 (см. таблицу 4)
Класс точности по реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012	1 или 2
Номинальное напряжение $U_{ном}$, В	230
Базовый ток I_b , А	5
Максимальный ток $I_{макс}$, А*	40, 60, 80, 100
Стартовый ток (чувствительность): для счетчиков класса 0,5 и 1	$0,002 \cdot I_b$
для счетчиков класса 2	$0,004 \cdot I_b$
Суточный ход встроенных часов в нормальных условиях, с	± 1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении среднеквадратических значений силы тока при $0,05 I_b \leq I \leq I_{макс}$, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения при $0,75 U_{ном} \leq U \leq 1,15 U_{ном}$, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении частоты переменного тока, в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц, Гц	$\pm 0,1$
*В зависимости от модификации счетчика.	
где I_b - значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением;	
$I_{макс}$ - наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности;	
$U_{ном}$ - значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику;	
U, I - значения напряжения, тока в допустимых диапазонах.	



КОПИЯ ВЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк

Таблица 4

Наименование	Значение
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика при измерении активной энергии, %:	
$0,05 \cdot I_b \leq I < 0,10 \cdot I_b$ при $\cos\varphi = 1$	$\pm 0,7$
$0,10 \cdot I_b \leq I < 0,20 \cdot I_b$ при $\cos\varphi = 0,5$ ($\cos\varphi = 0,8$)	$\pm 0,7$
$0,10 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 1$	$\pm 0,5$
$0,20 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 0,5$ ($\cos\varphi = 0,8$)	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчика при измерении активной энергии, вызванной изменением напряжения в пределах $\pm 10\%$ от номинального значения, %:	
$0,05 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 1$	$\pm 0,4$
$0,10 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 0,5$	$\pm 0,6$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчика при измерении активной энергии, вызванной изменением частоты в пределах $\pm 2\%$ от номинального значения, %:	
$0,05 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 1$	$\pm 0,4$
$0,10 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 0,5$	$\pm 0,6$
Средний температурный коэффициент счетчика при измерении активной энергии, %/К:	
$0,10 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 1$	$\pm 0,03$
$0,20 \cdot I_b \leq I \leq I_{\text{макс}}$ при $\cos\varphi = 0,5$	$\pm 0,05$
Примечание - Пределы допускаемых погрешностей счетчика при измерении активной энергии (класс 0,5 по ТУ ВУ 690329298.008-2013), не указанных в таблице, соответствуют значениям по ГОСТ 31819.21-2012 для счетчиков класса точности 1.	

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Значение
Предельный рабочий диапазон напряжений, В	от $0,8 U_{\text{ном}}$ до $1,15 U_{\text{ном}}$
Рабочий диапазон частоты сети, Гц	от 47,5 до 52,5
Диапазон температуры окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °C	от 21 до 25
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч)*	от 800 до 4800
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока счетчика при нормальной температуре, номинальной частоте и номинальном токе для каждой цепи тока, В·А, не более	0,2 для счетчиков исполнения Q; 0,1 для остальных счетчиков



Продолжение таблицы 5

Наименование	Значение
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха для счетчика, °C	от минус 40 до 70
Пределы изменения суточного хода часов при отклонении температуры окружающего воздуха на 1 °C от (23 ± 2) °C в пределах рабочего диапазона температур (от минус 40 °C до плюс 70 °C), с/сут	±0,2
Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин*	от 1 до 60
Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений, не менее*	6144
Число тарифов*	до 8
Скорость обмена по интерфейсам, бит/с*	от 300 до 57600
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении активной мощности более 100 Вт, %	±1,0
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика при номинальном значении напряжения, частоте и нормальной температуре, не более: S52.XXX.X.R.XXX S51/S53/S8.XXX.X.JR.XXX: в режиме ожидания в режиме обмена данными по радиointерфейсу S53.XXX.X.JR.XXXN, S51.XXX.X.JR.XXXN: в режиме ожидания в режиме обмена данными по радиointерфейсу S51.XXX.X.JPR.XXX, S51.XXX.X.JP.XXX, S53.XXX.X.JPR.XXX, S53.XXX.X.JP.XXX S53/S8/R7.XXX.X.JA.XXX (RS485) S7.XXX.X.JXX.XXX (с каналами связи радио и/или PLC) S8.XXX.X.JG.XXX (GSM): в режиме ожидания в режиме обмена данными по GSM C1/R7.XXX.X.JR.XXX: в режиме ожидания в режиме обмена данными по радиointерфейсу	2 В·А (0,8 Вт) 2 В·А (0,6 Вт) 2 В·А (0,7 Вт) 0,7 В·А (0,3 Вт) 1,0 В·А (0,4 Вт) 3,0 В·А (2,0 Вт) 2,0 В·А (1,0 Вт) 3,5 В·А (2,0 Вт) 2,5 В·А (1,6 Вт) 3,0 В·А (2,2 Вт) 2,5 В·А (1,0 Вт) 3,0 В·А (1,1 Вт)



КОПИЯ ВЕРНА
 Помощник директора по качеству
В.М.Дектерюк

Окончание таблицы 5

Наименование	Значение
Габаритные размеры корпуса (длина × ширина × глубина), мм, не более:	
для S7	200×122×73;
для S53	200×122×73;
для S51,	200×122×116;
для S52/x	215×135×116;
для S8	155×120×52;
для C1	230×160×80;
для R7	129×90×62.
Масса счетчика, кг, не более	0,9
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	220000
Средний срок службы, лет, не менее	30
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75	II
Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015	
для SXX, R7	IP51
для C1	IP64
* - зависит от исполнения счетчика	

Комплектность: представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Количество
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208BY	1
Устройство отображения информации CE901BY (для счетчиков исполнения в корпусе C1)	-*
Руководство по эксплуатации	-*
Формуляр	1
Методика поверки**	-*
Упаковка**	1
*Количество определяется договором на поставку	
**В поверку не предоставляется	

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средств измерений наносится на титульные листы руководства по эксплуатации, формуляра и на переднюю панель счетчика.

Поверка осуществляется по МРБ МИ.3602-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные CE208BY. Методика поверки» в редакции с изменением № 1.

Сведения о методиках (методах) измерений отсутствуют.



Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

ГОСТ 31818.11-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии";

ГОСТ 31819.21-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2";

ГОСТ 31819.23-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии";

ТУ ВУ 690329298.008-2013 "Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные СЕ208ВУ. Технические условия";

технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

технический регламент Республики Беларусь «Средства электросвязи. Безопасность» (ТР 2018/024/ВУ);

методику поверки:

МРБ МП.3602-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики электрической энергии однофазные multifunctional СЕ208ВУ. Методика поверки» в редакции с изменением № 1.

Перечень средств поверки: представлен в таблице 7.

Таблица 7

Наименование и тип средств поверки	
Барометр-анероид БАММ-01	
Гигрометр психрометрический ВИТ-1	
Универсальная пробойная установка УПУ-10	
Установка для поверки однофазных счетчиков электрической энергии CLOU CI.1000	
Секундомер «Интеграл С-01»	
Блок питания Б5-47	
Частотомер электронно-счетный ЧЗ-84	
Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.	

Идентификация программного обеспечения: информация о программном обеспечении (далее – ПО) представлена в таблице 8.

Таблица 8

Исполнение счетчика	Встроенное ПО		Прикладное ПО	
	Версия	КС*	Наименование	Версия
СЕ208ВУ S51/S53	124.x.x.x	734022C5	«AminTools»	3.x
СЕ208ВУ S7	132.x.x.x	734022C5	«AminTools»	3.x
СЕ208ВУ S8	137.x.x.x	734022C5	«AminTools»	3.x
СЕ208ВУ C1	156.x.x.x	734022C5	«AminTools»	3.x
СЕ208ВУ R7	156.x.x.x	734022C5	«AminTools»	3.x

*контрольная сумма метрологической значимой части



Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ208ВУ соответствуют требованиям ТУ ВУ 690329298.008-2013, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 2018/024/ВУ.

Производитель средств измерений

ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера»

Республика Беларусь, 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь,

ул. Комсомольская, д. 30

тел./факс (017) 211-01-42

E-mail: FZIP@energomera.by

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленинский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38

e-mail: info@belgim.by

- Приложения:
1. Фотографии общего вида средств измерений на 2 листах.
 2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 3 листах.
 3. Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа средств измерений на 3 листах.

Заместитель директора БелГИМ


Ю.В. Козак




Приложение 1
(обязательное)
Фотографии общего вида средств измерений




а) общий вид счетчика
CE208BY с типом корпуса S7

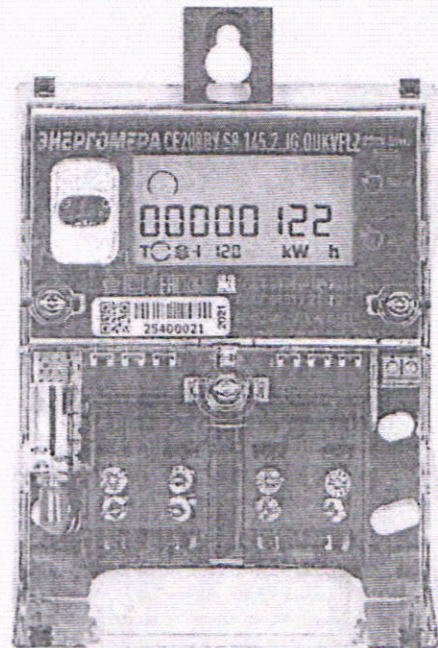

б) общий вид счетчика
CE208BY с типом корпуса S8

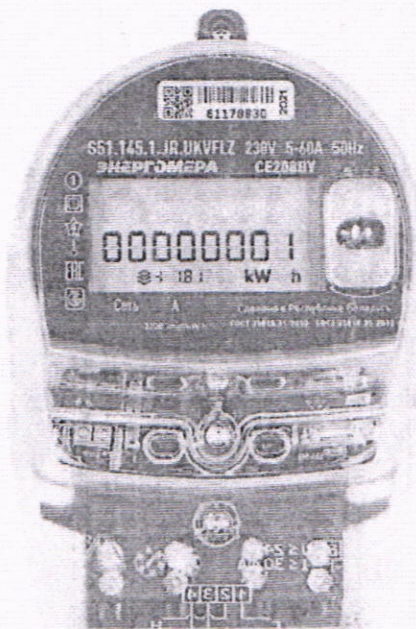

в) общий вид счетчика
CE208BY с типом корпуса S51

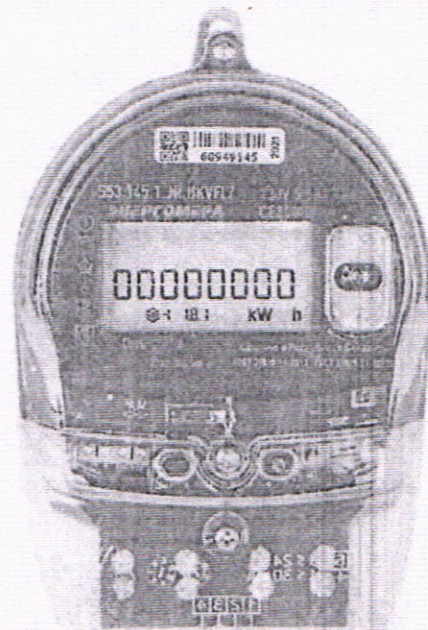


г) общий вид счетчика
CE208BY с типом корпуса S53



КОПИЯ ЖЕРНА
помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк



д) общий вид счетчика CE208BY с типом корпуса C1

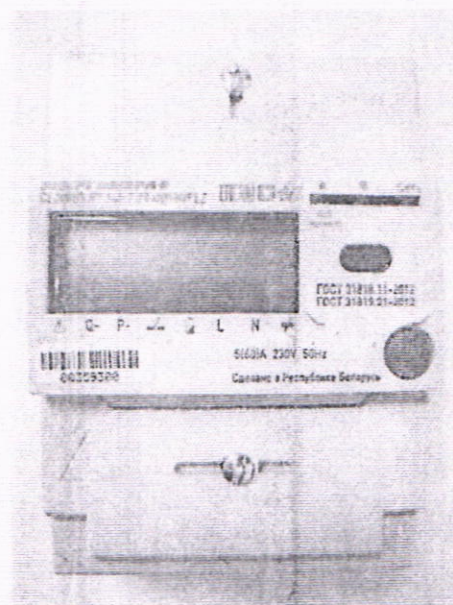

е) общий вид счетчика CE208BY с типом корпуса R7

Рисунок 1.1 – Фотографии общего вида и установки счетчиков CE208BY (изображение носит иллюстративный характер)



Приложение 2
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений

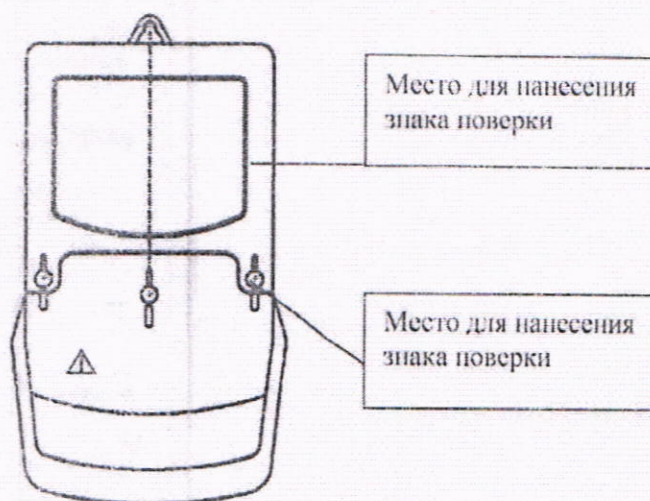


Рисунок 2.1 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на счетчик СЕ208ВУ S7

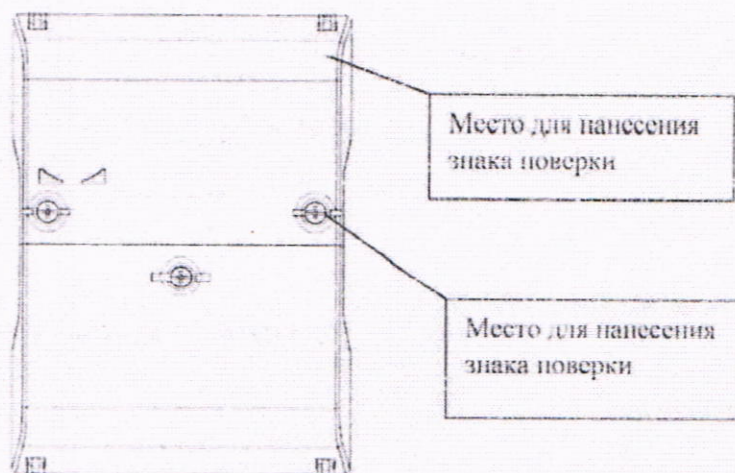


Рисунок 2.2 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на счетчик СЕ208ВУ S8



КОПИЯ БЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк

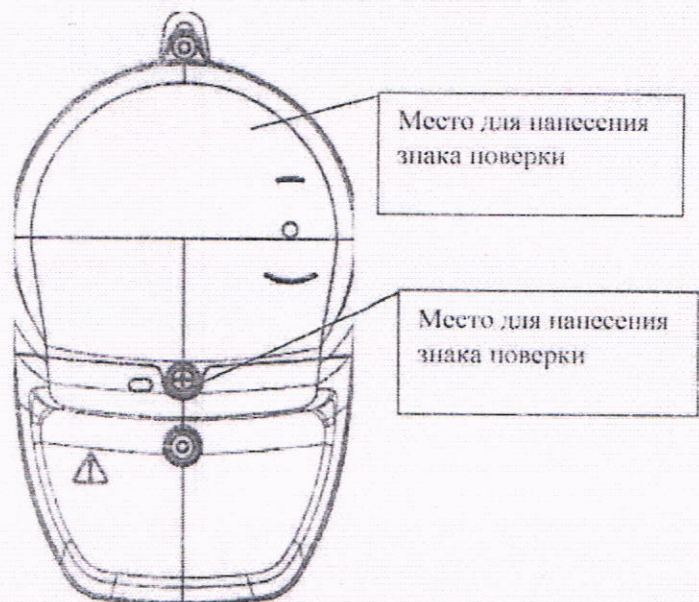


Рисунок 2.3 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на счетчик CE208BY S51

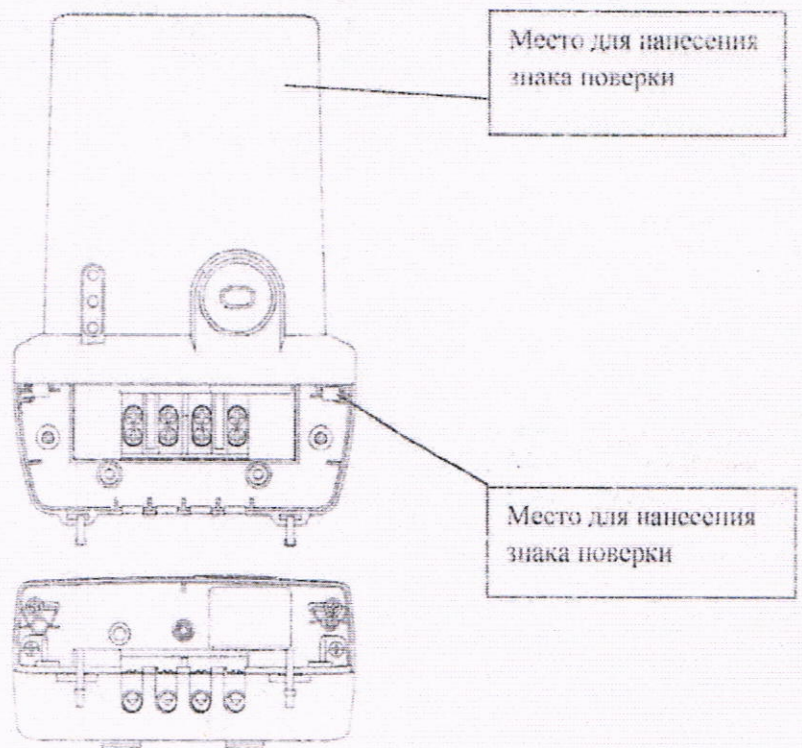


Рисунок 2.4 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на счетчик CE208BY C1



КОПИЯ ВЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк В.М. Дектерюк

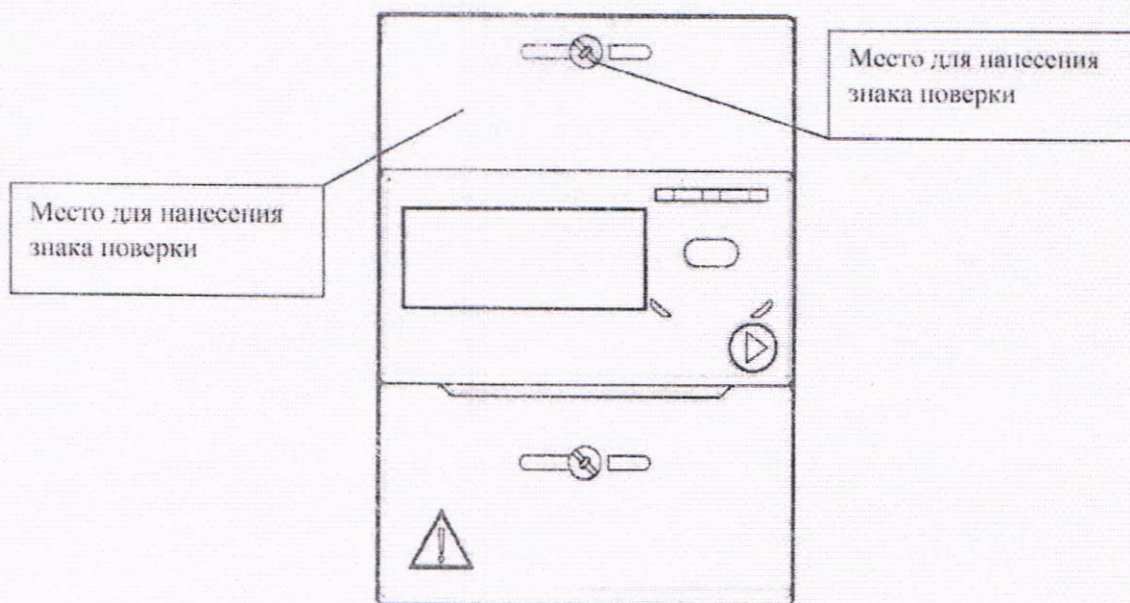


Рисунок 2.5 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на счетчик CE208BY R7



КСИЯ ВЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк
В.М. Дектерюк

Приложение 3
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа средств измерений

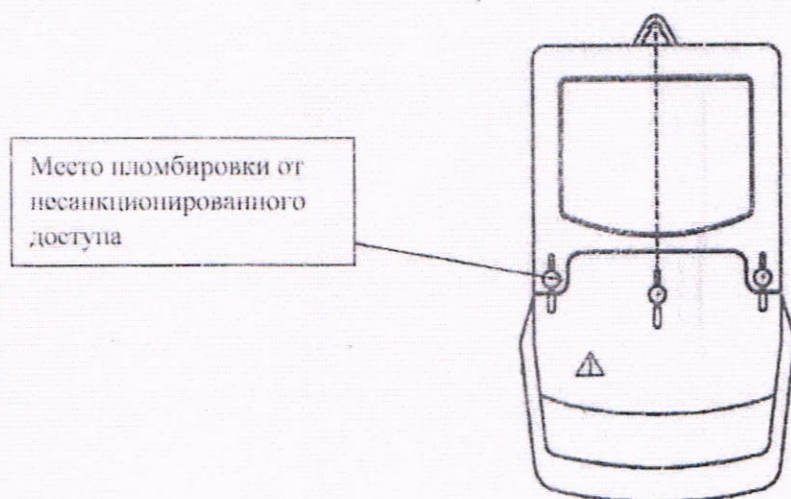


Рисунок 3.1 - Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа на счетчик СЕ208ВУ S7

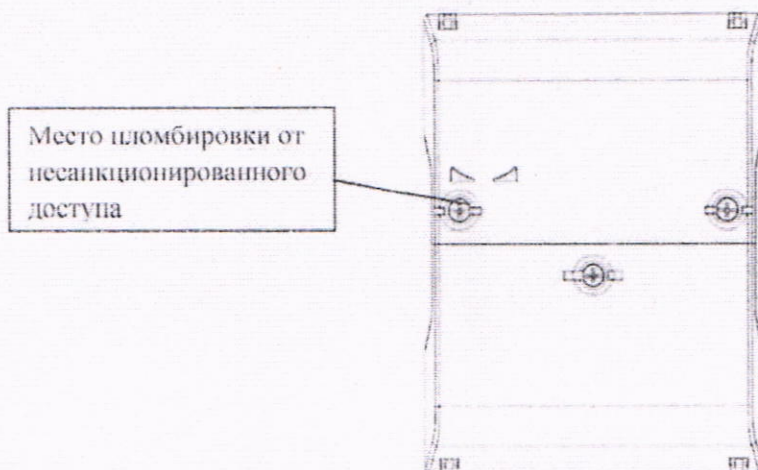


Рисунок 3.2 - Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа на счетчик СЕ208ВУ S8



КОПИЯ ВЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк
В.М. Дектерюк

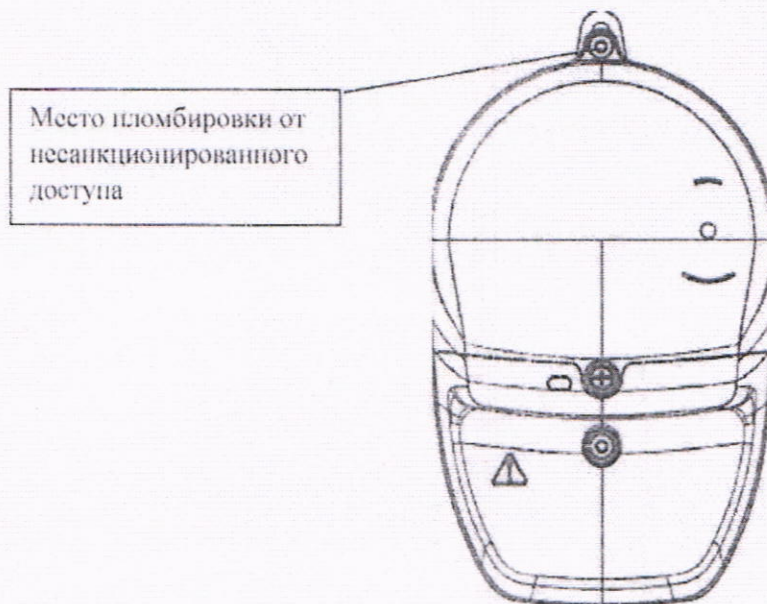


Рисунок 3.3 - Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа на счетчик СЕ208ВУ S51, S52/х, S53

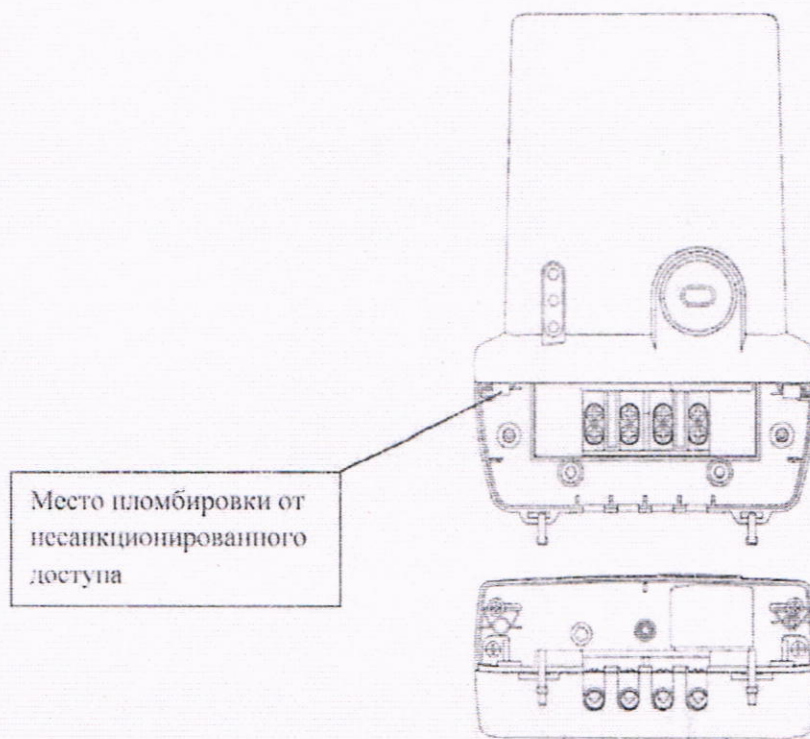


Рисунок 3.4 - Схема (рисунок) с указанием места пломбировки от несанкционированного доступа на счетчик СЕ208ВУ С1



КОПИЯ ВЕРНА
Помощник директора по качеству
В.М. Дектерюк

