

Регистрационный № 90769-23

Лист № 1
Всего листов 14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы жидкости MT Measurement

Назначение средства измерений

Анализаторы жидкости MT Measurement (далее – анализаторы) предназначены для автоматических автономных измерений показателя активности ионов водорода (pH), окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости (УЭП), общего солесодержания (TDS) (условно по NaCl), массовой концентрации ионов (ISE) (кальций (Ca^{2+}), калий (K^{+}), натрий (Na^{+}), фтор (F^{-}), аммоний (NH_4), свинец (Pb^{2+}), серебро (Ag^{+}), сульфиды (S^{2-}), иодиды (I^{-}), медь (Cu^{+}), бром (Br^{-}), хлориды (Cl^{-}), нитраты (NO_3)) и массовой концентрации растворенного кислорода (DO) с одновременным измерением температуры и температурной компенсацией результатов измерений в жидких средах.

Описание средства измерений

Принцип действия измерительных каналов (далее – ИК) pH, ОВП и массовой концентрации ионов (ISE) – потенциометрический, принцип действия ИК массовой концентрации растворенного в воде кислорода (DO) – амперометрический, принцип действия ИК УЭП и общего солесодержания (TDS) (условно по NaCl) – кондуктометрический, принцип действия ИК температуры основан на преобразовании электрического сопротивления, поступающего в электронный блок от первичного преобразователя, пропорционально измеряемой величине.

Анализаторы выпускаются в настольном или портативном исполнении и конструктивно состоят из первичных преобразователей (датчиков) и вторичного преобразователя (микропроцессорного блока с дисплеем). К данному типу средств измерений относятся анализаторы жидкости, выпускаемые под товарным знаком «MT Measurement».

Анализаторы выпускаются в 47 модификациях: M300F, M310F, M310T, M500T, M510T, M600L, M300F-A, M310F-A, M500T-A, M510T-A, PH100B, PH110B, PH200EM, PH200E, PH210E, PH300F, PH310F, PH310T, PH400F, PH500T, PH510T, PH600L, I300F, I310T, I400F, I500T, I510T, I600L, EC100B, EC110B, EC200EM, EC200E, EC210E, EC300F, EC310F, EC310T, EC400F, EC500T, EC510T, EC600L, DO210E, DO310F, DO400F, DO500T, DO510T, DO511T, DO600L. Модификации различаются типом первичного преобразователя (датчика), исполнением вторичного преобразователя (настольное, портативное), техническими характеристиками и измеряемыми параметрами. Назначение модификаций анализаторов приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Назначение модификаций анализаторов

Модификация	Измеряемый параметр						
	pH	ОВП	УЭП	ISE	TDS	DO	t
M300F, M310F, M310T, M500T, M510T, M600L	+	+	+	+	+	+	+
M300F-A, M310F-A, M500T-A, M510T-A	+	+	+	+	+	-	+
PH100B, PH110B, PH200EM	+	+	-	-	-	-	-
PH200E, PH210E, PH300F, PH310F, PH310T, PH400F, PH500T, PH510T, PH600L	+	+	-	-	-	-	+
I300F, I310T, I400F, I500T, I510T, I600L	+	+	-	+	-	-	+
EC100B, EC110B, EC200EM	-	-	+	-	-	-	-
EC200E, EC210E	-	-	+	-	+	-	+
EC300F, EC310F, EC310T, EC400F, EC500T, EC510T, EC600L	-	-	+	-	+	-	+
DO210E, DO310F, DO400F, DO500T, DO510T, DO511T, DO600L	-	-	-	-	-	+	+

Настольное исполнение: модификации M300F, M500T, M600L, M300F-A, M500T-A, PH100B, PH200EM, PH200E, PH300F, PH400F, PH500T, PH600L, I300F, I400F, I500T, I600L, EC100B, EC200EM, EC200E, EC300F, EC400F, EC500T, EC600L, DO400F, DO500T, DO600L.

Портативное исполнение: модификации M310F, M310T, M510T, M310F-A, M510T-A, PH110B, PH210E, PH310F, PH310T, PH510T, I310T, I510T, EC110B, EC210E, EC310F, EC310T, EC510T, DO210E, DO310F, DO510T, DO511T.

В датчиках предусмотрено наличие платиновых термисторов для измерения температуры и выполнения автоматической компенсации температуры при измерениях. Микропроцессорный контроллер блока управления выполняет математическую обработку полученной информации, автоматическую компенсацию функции преобразования, корректировку нулевых показаний и чувствительности датчиков.

Общий вид анализаторов и датчиков приведен на рисунках 1а-1п. Наименование модификации, состоящее из буквенно-цифрового обозначения, и товарный знак «MT Measurement» нанесены на лицевой панели анализатора. Заводской номер анализатора, содержащий от 6 до 16 арабских цифр и от 1 до 3 латинских заглавных букв, нанесен типографским методом на клеевую этикетку, расположенную на боковой или задней/нижней панели микропроцессорного блока. Заводской номер датчика (в зависимости от типа датчика) содержит от 6 до 15 арабских цифр и от 1 до 3 заглавных латинских букв. Место нанесения: на проводе датчика (в виде запаянной этикетки) или на корпусе датчика (нанесение методом шелкографии/гравировки/клеевой этикетки). Товарный знак «MT Measurement» нанесен на корпус датчиков. Заводские номера микропроцессорного блока и датчиков, входящих в состав анализатора, указываются в паспорте на анализатор. Заводским номером, идентифицирующим анализатор, является заводской номер микропроцессорного блока.

Нанесение знака поверки на анализатор не предусмотрено.

Пломбирование анализаторов не предусмотрено.



Рисунок 1а – Общий вид анализаторов модификаций PH100B, EC100B



Рисунок 1б – Общий вид анализаторов модификаций PH200E, EC200E, PH200EM, EC200EM



ИЛИ



Рисунок 1в – Общий вид анализаторов модификаций M300F, M300F-A, PH300F, EC300F, I300F



ИЛИ



Рисунок 1г – Общий вид анализаторов модификаций PH400F, EC400F, I400F, DO400F



Рисунок 1д – Общий вид анализаторов модификаций M500T, M500T-A, PH500T, EC500T, I500T, DO500T



Рисунок 1е – Общий вид анализаторов модификаций M600L, PH600L, EC600L, I600L, DO600L



Рисунок 1ж – Общий вид анализаторов модификаций PH110B, EC110B, PH210E, EC210E, DO210E



Рисунок 1з – Общий вид анализаторов модификаций M310F, M310F-A, PH310F, EC310F, DO310F



Рисунок 1и – Общий вид анализаторов модификаций M310T, PH310T, EC310T, I310T



Рисунок 1к – Общий вид анализаторов модификаций M510T, M510T-A, PH510T, EC510T, I510T, DO510T, DO511T



Рисунок 1л – Общий вид датчиков рН/ОВП



Рисунок 1м – Общий вид датчиков УЭП/TDS



Рисунок 1н – Общий вид датчиков
растворенного кислорода



Рисунок 1о – Общий вид датчика температуры



Рисунок 1п – Общий вид ионселективных датчиков

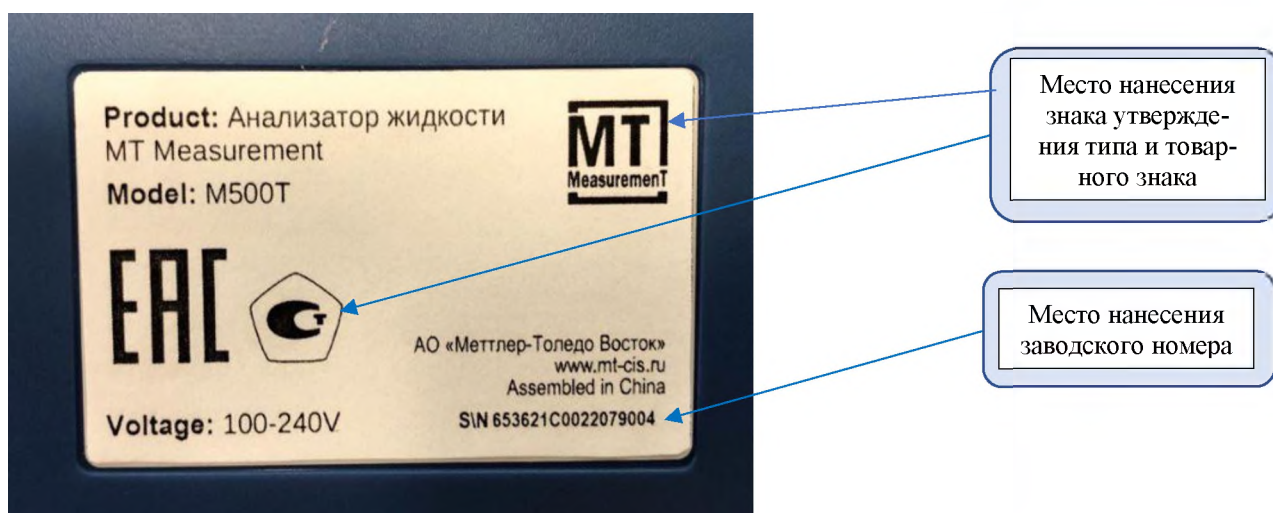


Рисунок 1р – Общий вид задней поверхности вторичного преобразователя с указанием места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

Анализаторы оснащены встроенным программным обеспечением (далее – ПО), которое осуществляет их функционирование, сбор измерительных данных, их обработку, визуализацию и хранение. Конструктивно анализаторы имеют защиту ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Уровень защиты ПО для модификаций M300F, M310F, M310T, M500T, M510T, M600L, M300F-A, M310F-A, M500T-A, M510T-A, PH300F, PH310F, PH310T, PH400F, PH500T, PH510T, PH600L, I300F, I310T, I400F, I500T, I510T, I600L, EC300F, EC310F, EC310T, EC400F, EC500T, EC510T, EC600L, DO310F, DO400F, DO500T, DO510T, DO511T, DO600L «средний» в соответствии с Р.50.2.077-2014.

Уровень защиты ПО для модификаций PH100B, PH110B, PH200EM, PH200E, PH210E, EC100B, EC110B, EC200EM, EC200E, EC210E, DO210E «высокий» в соответствии с Р.50.2.077-2014. Конструкция анализаторов модификаций PH100B, PH110B, PH200EM, PH200E, PH210E, EC100B, EC110B, EC200EM, EC200E, EC210E, DO210E исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Влияние ПО на метрологические характеристики анализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.

Таблица 2 – Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	M300F, M310F, M310T, M500T, M510T, M600L, M300F-A, M310F-A, M500T-A, M510T-A, PH300F, PH310F, PH310T, PH400F, PH500T, PH510T, PH600L, I300F, I310T, I400F, I500T, I510T, I600L, EC300F, EC310F, EC310T, EC400F, EC500T, EC510T, EC600L, DO310F, DO400F, DO500T, DO510T, DO511T, DO600L	PH100B, PH110B, PH200EM, PH200E, PH210E, EC100B, EC110B, EC200EM, EC200E, EC210E, DO210E
Идентификационное наименование ПО	-	-
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.00	-
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон показаний pH: Настольные модификации: - M300F, M300F-A, PH300F, I300F, PH400F, I400F, M500T, M500T-A, PH500T, I500T, M600L, PH600L, I600L - PH200E, PH200EM - PH100B Портативные модификации: - M310F, M310F-A, PH310F, M310T, PH310T, I310T, M510T, M510T-A, PH510T, I510T - PH210E - PH110B	от -2 до 20 от -2 до 18 от -2 до 14 от -2 до 20 от -2 до 18 от -2 до 14
Диапазон измерений pH: Настольные модификации: - PH100B, PH200E, PH200EM, M300F, M300F-A, PH300F, I300F, PH400F, I400F, M500T, M500T-A, PH500T, I500T, M600L, PH600L, I600L Портативные модификации: - PH110B, PH210E, M310F, M310F-A, PH310F, M310T, PH310T, I310T, M510T, M510T-A, PH510T, I510T	от 1 до 14 от 1 до 14
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pH: Настольные модификации: - PH100B, PH200E, PH200EM, M300F, M300F-A, PH300F, I300F - PH400F, I400F, M500T, M500T-A, PH500T, I500T, M600L, PH600L, I600L Портативные модификации: - PH110B, PH210E, M310F, M310F-A, PH310F, M310T, PH310T, I310T - M510T, M510T-A, PH510T, I510T	±0,1 ±0,03 ±0,1 ±0,03
Диапазон показаний ОВП, мВ: Настольные модификации:	

Наименование характеристики	Значение
- PH100B - PH200E, PH200EM - M300F, M300F-A, PH300F, I300F, PH400F, I400F, M500T, M500T-A, PH500T, I500T, M600L, PH600L, I600L Портативные модификации: - PH110B - PH210E - M310F, M310F-A, PH310F, M310T, PH310T, I310T, M510T, M510T-A, PH510T, I510T	от -1800 до +1800 от -1999 до +1999 от -2000 до +2000 от -1800 до +1800 от -1999 до +1999 от -2000 до +2000
Диапазон измерений ОВП, мВ (для всех модификаций)	от -133 до +1236
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ОВП, мВ (для всех модификаций)	±6
Диапазон показаний температуры, °С: Настольные модификации: - PH200E, EC200E, PH300F, EC300F, I300F, M300F, M300F-A - PH400F, EC400F, I400F, DO400F, M500T, M500T-A, PH500T, EC500T, I500T, DO500T - M600L, PH600L, EC600L, I600L, DO600L Портативные модификации: - PH210E, EC210E, DO210E, M310F, M310F-A, PH310F, EC310F, DO310F, M310T, PH310T, EC310T, I310T - M510T, M510T-A, PH510T, EC510T, DO510T, I510T - DO511T	от -5 до +110 от -10 до +135 от -5 до +130 от -5 до +110 от -10 до +135 от 0 до +50
Диапазон измерений температуры, °С - для DO511T - для всех остальных модификаций	от 0 до +50 от 0 до +90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С (для всех модификаций)	±0,5
Диапазон показаний УЭП, См/м Настольные модификации: - EC100B - EC200E, EC200EM - M300F, M300F-A, EC300F, EC400F - M500T, M500T-A, EC500T - M600L, EC600L Портативные модификации: - EC110B - EC210E - M310F, M310F-A, EC310F - M310T, EC310T - M510T, M510T-A, EC510T	от 0 до 10 от 0 до 20 от 0 до 100 от 0 до 200 от 0 до 300 от 0 до 10 от 0 до 20 от 0 до 50 от 0 до 100 от 0 до 300
Диапазон измерений УЭП, См/м: Настольные модификации: - EC100B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - EC100B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC100B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC100B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10 - EC200E, EC200EM, M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01	от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,02 от $2 \cdot 10^{-4}$ до 2 от 0,2 до 10 от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-4}$

Наименование характеристики	Значение
- EC200E, EC200EM, M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC200E, EC200EM, M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC200E, EC200EM, M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10	от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,02 от $2 \cdot 10^{-4}$ до 2 от 0,2 до 20
Портативные модификации: - EC110B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - EC110B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC110B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC110B, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10	от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,02 от $2 \cdot 10^{-4}$ до 2 от 0,2 до 10
- EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10	от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,02 от $2 \cdot 10^{-4}$ до 2 от 0,2 до 20
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений УЭП, % (для всех модификаций)	± 2
Диапазон показаний общего солесодержания (условно по NaCl), мг/дм ³ : Настольные модификации: - EC200E - M300F, M300F-A, EC300F - EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L Портативные модификации: - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T - M510T, M510T-A, EC510T	от 0 до $1 \cdot 10^5$ от 0 до $3 \cdot 10^5$ от 0 до $1 \cdot 10^6$ от 0 до $3 \cdot 10^5$ от 0 до $1 \cdot 10^6$
Диапазон измерений общего солесодержания (условно по NaCl), мг/дм ³ : Настольные модификации: - EC200E, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - EC200E, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC200E, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC200E, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10 - M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1	от 0,01 до 0,49 от 0,03 до 98 от 0,98 до $9,8 \cdot 10^3$ от 980 до $4,9 \cdot 10^4$ от 0,01 до 0,49 от 0,03 до 98

Наименование характеристики	Значение
ка 1 - M300F, M300F-A, EC300F, EC400F, M500T, M500T-A, EC500T, M600L, EC600L, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10 Портативные модификации: - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,01 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 0,1 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 1 - EC210E, M310F, M310F-A, EC310F, M310T, EC310T, M510T, M510T-A, EC510T, номинальное значение постоянной ячейки датчика 10	от 0,98 до $9,8 \cdot 10^3$ от 980 до $9,8 \cdot 10^4$ от 0,01 до 0,49 от 0,03 до 98 от 0,98 до $9,8 \cdot 10^3$ от 980 до $9,8 \cdot 10^4$
Пределы допускаемой приведенной (к верхней границе диапазона) погрешности измерений общего содержания (условно по NaCl), % (для всех модификаций)	$\pm 0,5$
Диапазон измерений массовой концентрации ионов*, г/дм ³ (для всех модификаций)	от 0,001 до 1
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации ионов, % (для всех модификаций)	± 5
Диапазон показаний массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм ³ : Настольные модификации: - M300F - DO400F, M500T, DO500T, M600L, DO600L Портативные модификации: - DO210E, DO511T - M310F, DO310F, M310T - M510T, DO510T	от 0 до 20 от 0 до 99,99 от 0 до 20 от 0 до 50 от 0 до 99,99
Диапазон измерений массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм ³ (для всех модификаций):	от 0,01 до 20
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации растворенного кислорода, % (для всех модификаций)	± 2
Условия окружающей среды (нормальные условия): – температура окружающего воздуха, °C: – относительная влажность воздуха, % – атмосферное давление, кПа:	20 $\pm$ 5 от 30 до 80 от 84 до 106
* Ионы из нижеперечисленных: кальций (Ca ²⁺), калий (K ⁺), натрий (Na ⁺), фтор (F ⁻), аммоний (NH ₄ ⁺), свинец (Pb ²⁺), серебро (Ag ⁺), сульфиды (S ²⁻), иодиды (I ⁻), медь (Cu ⁺), бром (Br ⁻), хлориды (Cl ⁻), нитраты (NO ₃ ⁻)	

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры вторичного преобразователя, мм, не более: - для настольных модификаций M600L, PH600L, EC600L, I600L, DO600L - длина 310 - ширина 280 - высота 130 - для настольных модификаций M500T, M500T-A, PH500T, EC500T, I500T, DO500T - длина 220 - ширина 195 - высота 68 - для настольных модификаций PH200E, PH200EM, EC200E, EC200EM M300F, M300F-A, PH300F, EC300F, I300F, PH400F, EC400F, I400F, DO400F - длина 242 - ширина 195 - высота 68 - для настольных модификаций PH100B, EC100B - длина 200 - ширина 160 - высота 63 - для портативных модификаций M310T, PH310T, EC310T, I310T, M510T, M510T-A, PH510T, EC510T, DO510T, I510T, DO511T - длина 255 - ширина 90 - высота 40 - для портативных модификаций PH110B, EC110B, PH210E, EC210E, DO210E, M310F, M310F-A, PH310F, EC310F, DO310F - длина 225 - ширина 80 - высота 35	
Масса вторичного преобразователя, кг, не более: - для настольных модификаций M600L, PH600L, EC600L, I600L, DO600L 2,5 - для настольных модификаций M500T, M500T-A, PH500T, EC500T, I500T, DO500T 0,95 - для настольных модификаций PH200E, PH200EM, EC200E, EC200EM M300F, M300F-A, PH300F, EC300F, I300F, PH400F, EC400F, I400F, DO400F 0,90 - для настольных модификаций PH100B, EC100B 0,60 - для портативных модификаций M310T, PH310T, EC310T, I310T, M510T, M510T-A, PH510T, EC510T, DO510T, I510T, DO511T 0,50 - для портативных модификаций PH110B, EC110B, PH210E, EC210E, DO210E, M310F, M310F-A, PH310F, EC310F, DO310F 0,40	
Габаритные размеры первичных преобразователей (датчиков), мм, не более: - длина 260 - диаметр 18	
Масса первичных преобразователей (датчиков), кг, не более	0,2
Параметры электрического питания для настольных модификаций: - напряжение переменного тока, В 220±22 - частота переменного тока, Гц 50±1	

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания для портативных модификаций: - напряжение постоянного тока, В (при питании от литий-ионного аккумулятора)	5
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, - атмосферное давление, кПа - температура анализируемой среды, °С - для настольных модификаций - для портативных модификаций	от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106,0 25±2 от 0 до +90

Таблица 5 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Вероятность безотказной работы анализатора за 1000 ч, не менее	0,95
Средний срок службы, лет	5
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	20500

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом и типографским способом на клеевую этикетку, расположенную на боковой или задней/нижней панели микропроцессорного блока анализаторов.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность анализатора

Наименование	Обозначение	Количество
Анализатор жидкости	MT Measurement	1 шт.
Сетевой адаптер (для настольных модификаций)	—	1 шт.
Штатив для электродов (для настольных модификаций)	—	1 шт.
Руководство по эксплуатации	—	1 экз.
Поставляется по требованию заказчика из нижеперечисленных: 1) датчики (первичные преобразователи) с товарным знаком MT Measurement: - комбинированные рН-электроды модификаций 962201, 962245, 962102, 962103, 962121, 962122, 962246, 962221, 962224, 962241, 962242, 962243, 962244, 962223, E-301-QC, E-201F, E-201-C, E-201, E-201-Z, E-201-P, 65-1C; - измерительные рН-электроды 231-01; - электроды сравнения модификаций C(K ₂ SO ₄)-1-X, 217-01-X, 232-01-X; - комбинированные ОБП-электроды модификаций 501, ORP-503; - комбинированные ионселективные электроды модификаций PF-202-C, PF-202, 972101, 972102, 972103, 972104, 972121, 701, 972207, 972124, 972105, 972106, 972125, 972126, 972123, 972140, 972122; - ионселективные электроды модификаций PF-2-01, PF-3-01, PCl-1-01, PBr-1-01, PI-1-01, PK-1-01, PCa-1-01, PCu-1-01, PPb-1-01, PBF4-1-01, PCIO4-1-01, PNO3-1-01, PCN-1-01, PAg/S-1-01, PNH3-1-01, 972150; 2) Кондуктометрические датчики с товарным знаком MT Measurement модификаций DJS-0.01VT, DJS-0.1VTG, DJS-1VG, DJS-1VTG, DJS-1VTC, DJS-1VC, DJS-10VTC; 3) Датчики растворенного кислорода с товарным знаком MT Measurement модификаций DO-957-Q, DO-958-Q, DO-958-L, DO-968-HC.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 5.5.5 «Измерение pH», п. 5.6.3 «Непосредственное измерение», п. 5.7.3 «Процедура измерения ОВП», п. 5.8.4 «Процедура измерения», п. 5.10 «Измерение концентрации растворенного кислорода» и п. 5.13.3 «Отчет» документа «Анализаторы жидкости MT Measurement. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02 февраля 2026 года № 166

Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 января 2026 года № 147

Государственная поверочная схема для средств измерений показателя pH активности ионов водорода в водных растворах, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.02.2022 № 324

Государственная поверочная схема для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.03.2026 № 534

ТУ26.51.5-011-45862615-2022 Анализаторы жидкости MT Measurement. Технические условия.

Правообладатель

Акционерное общество «Меттлер-Толедо Восток»

(АО «Меттлер-Толедо Восток»)

ИНН 7705125499

Юридический адрес: 101000, РФ, г. Москва, б-р Сретенский, д. 6/1, стр. 1, ком. 8, 10, 16

Телефон: (495) 651-98-86

Факс: (495) 277-22-74

E-mail: inforus@mt.com

Web-сайт: www.mt.com

Изготовитель

Акционерное общество «Меттлер-Толедо Восток»

(АО «Меттлер-Толедо Восток»)

ИНН 7705125499

Юридический адрес: 101000, РФ, г. Москва, б-р Сретенский, д. 6/1, стр. 1, ком. 8, 10, 16

Производственная площадка:

Шанхай ИНЕСА Сайентифик Инструмент Ко, Лтд., Китай

Адрес: No.5 Yuan Da Road, Anting Shanghai, China, 201805

E-mail: info@mt.com

Web-сайт: www.mt.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт 19

Телефон: (812) 251-76-01

Факс: (812) 713-01-14

E-mail: info@vniim.ru

Web-сайт: www.vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.314555