


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 1 ДО 300 МГц (чертеж)**

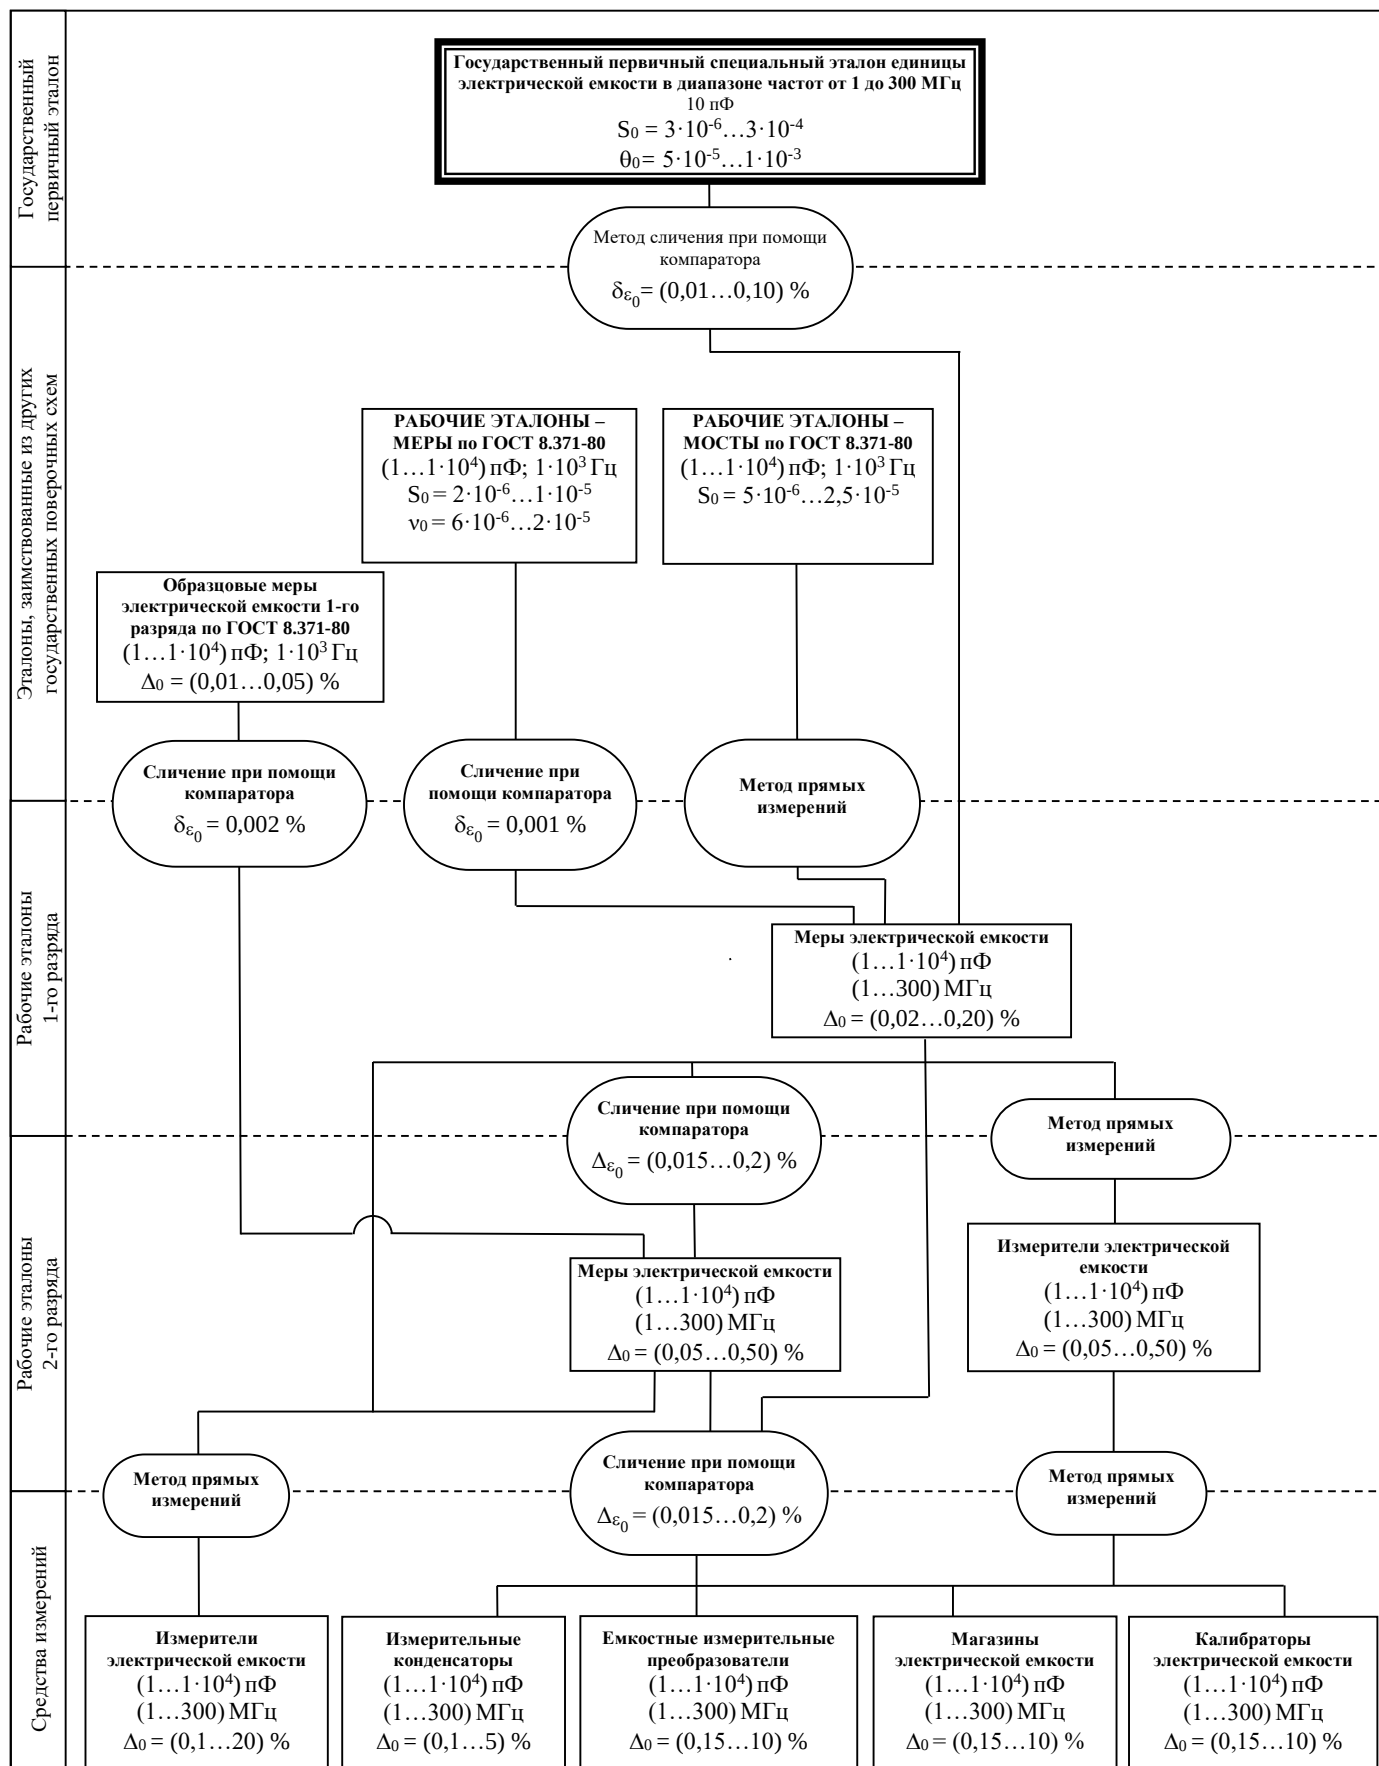

Обозначения на схеме:

S_0 – значение СКО в относительной форме, θ_0 – значение НСПИ в относительной форме, v_0 – пределы допускаемой относительной нестабильности за 1 год, δ_{ϵ_0} – доверительные границы относительной погрешности метода поверки, Δ_{ϵ_0} – пределы допускаемой относительной погрешности метода поверки; Δ_0 – пределы допускаемой относительной погрешности эталонов и СИ