


(обязательное)


Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

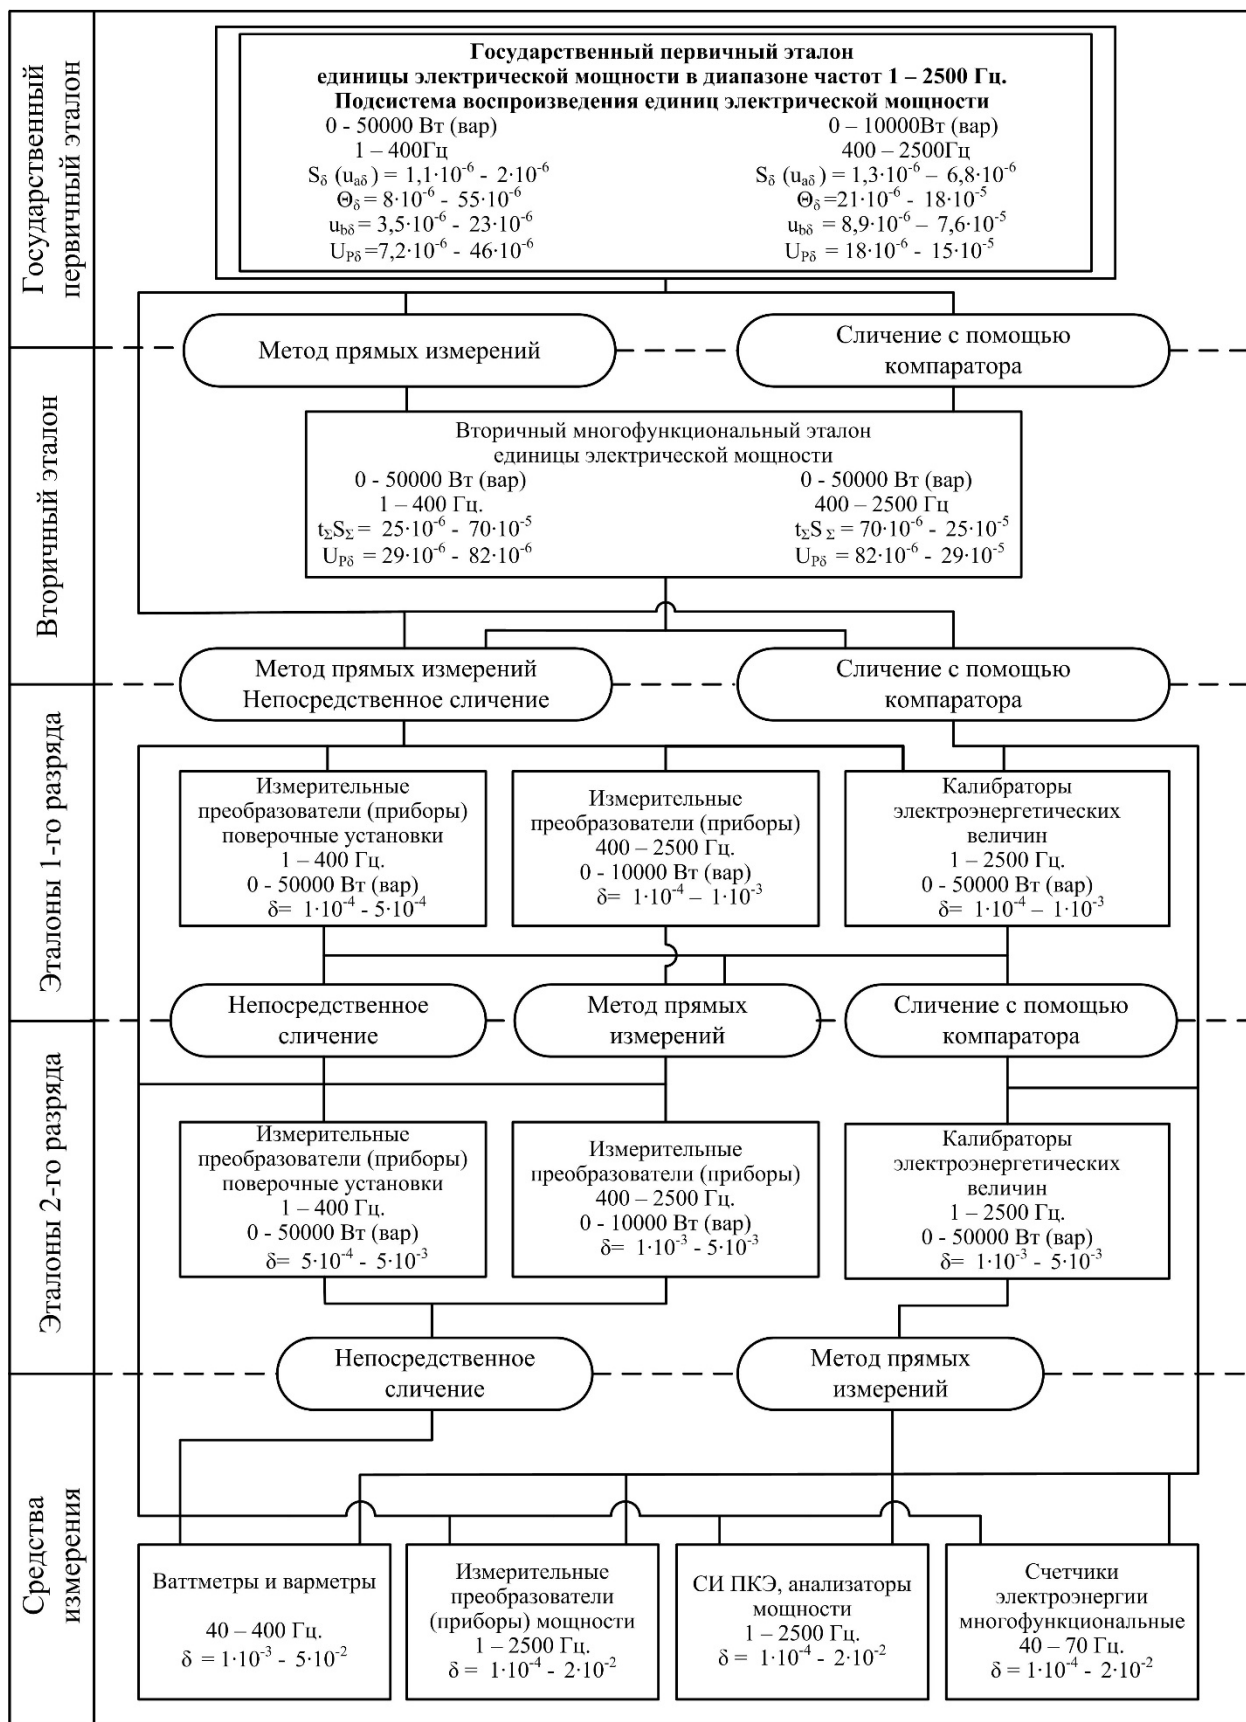

Приложение Б

(обязательное)


Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

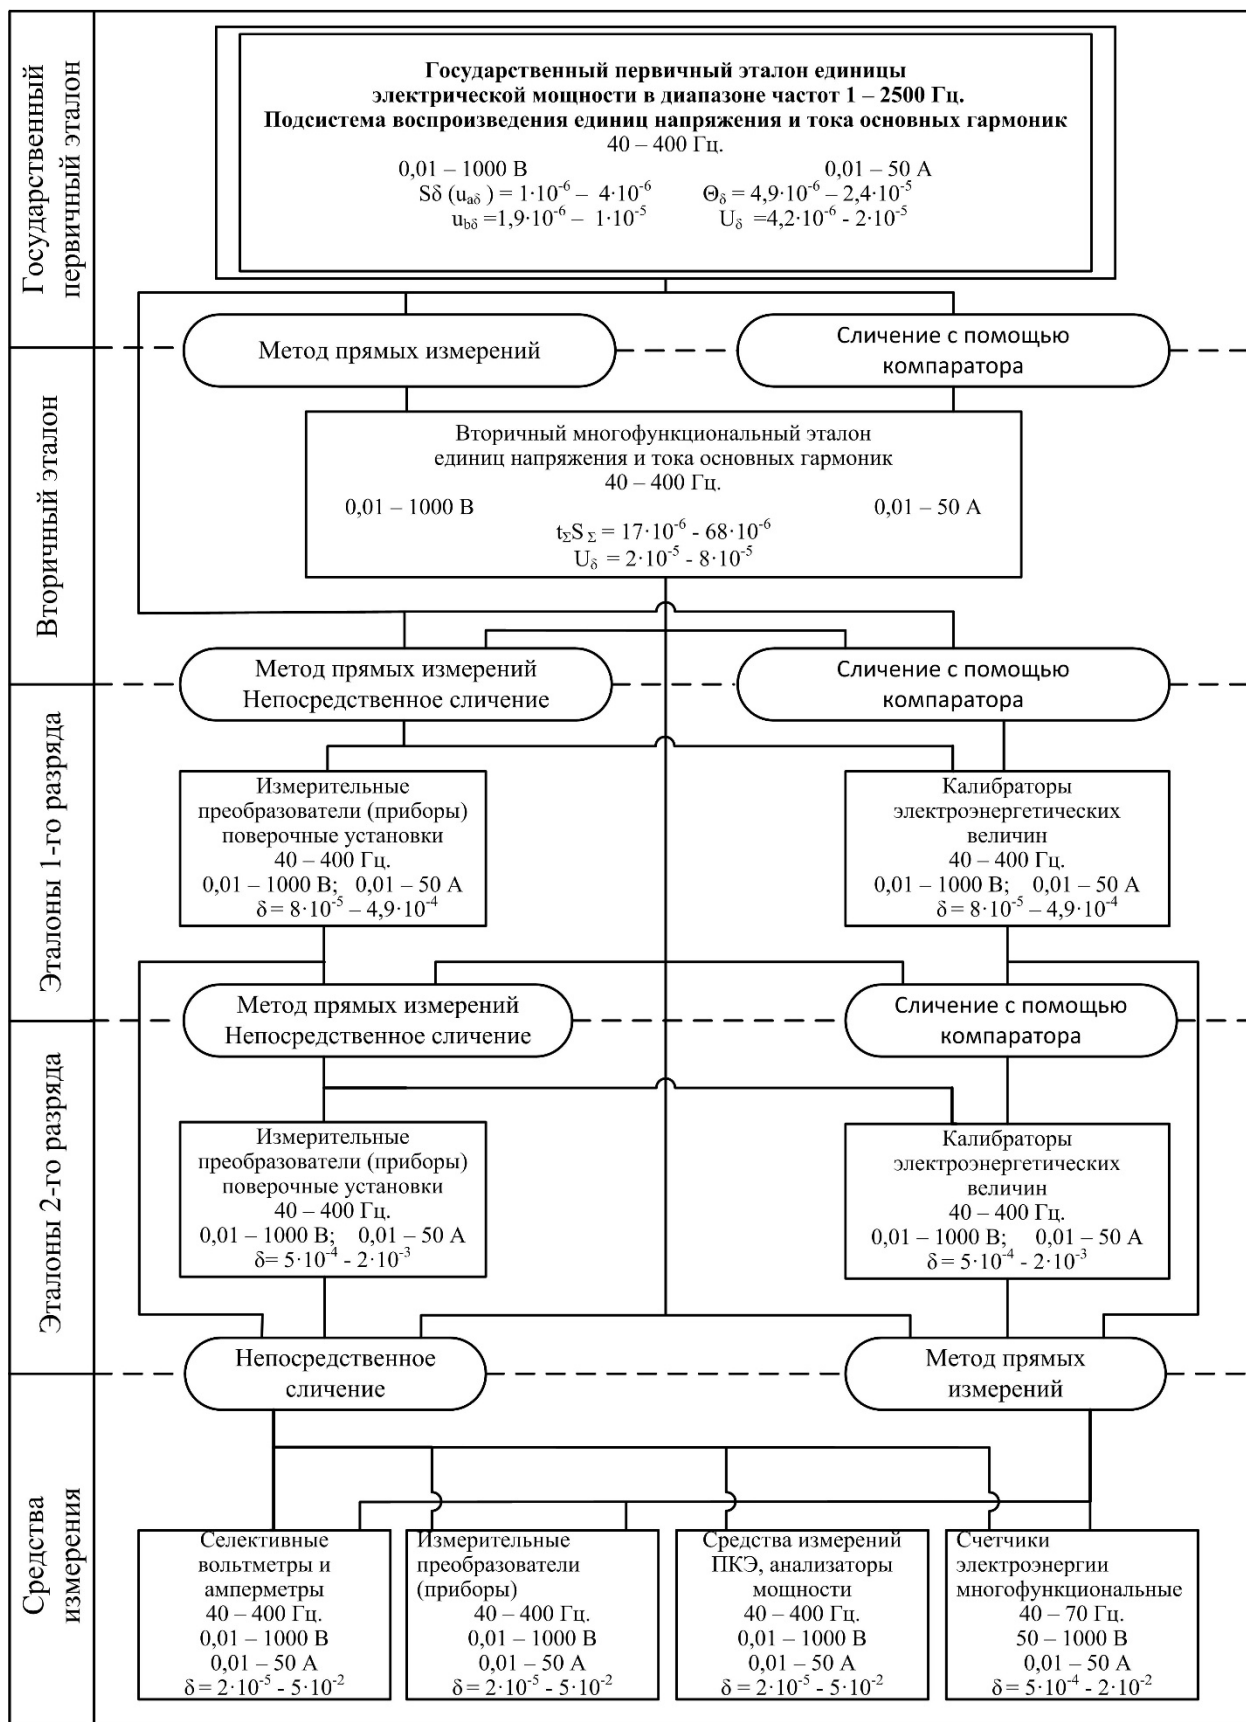

Приложение В

(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

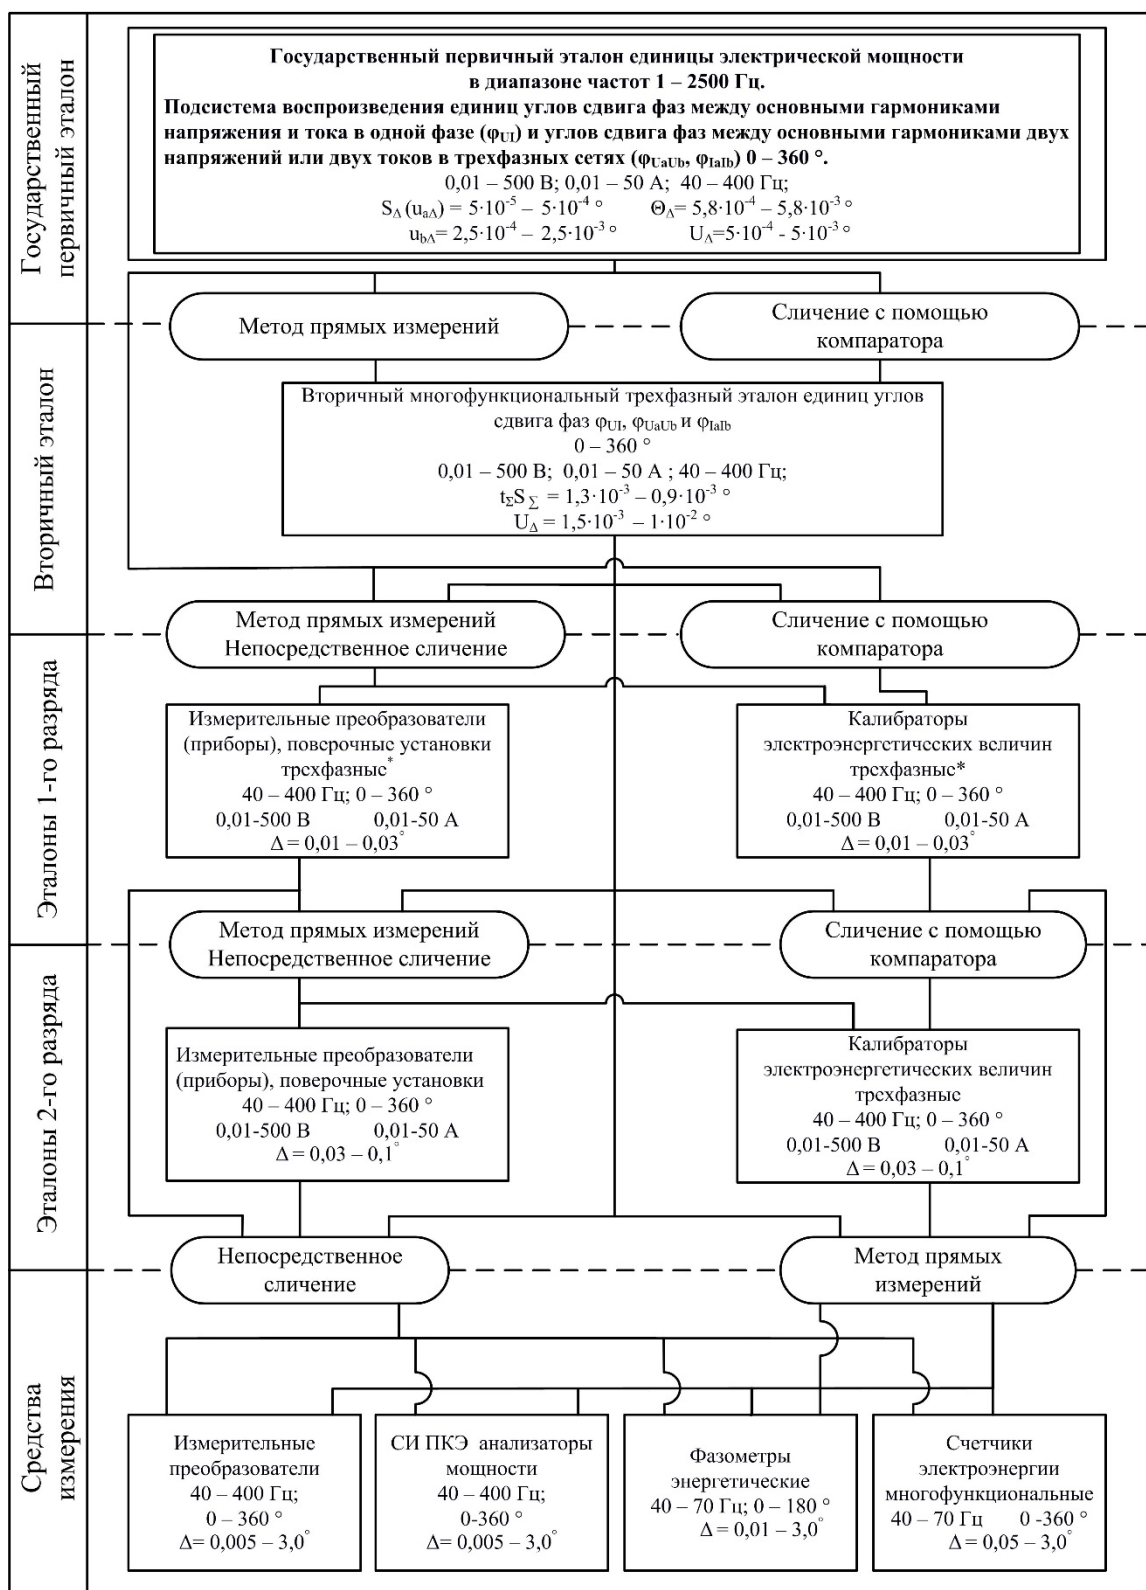


* Для СИ только угла φ_{UI} применяются однофазные или трехфазные (по одной из фаз) рабочие эталоны

Приложение Г

(обязательное)


Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

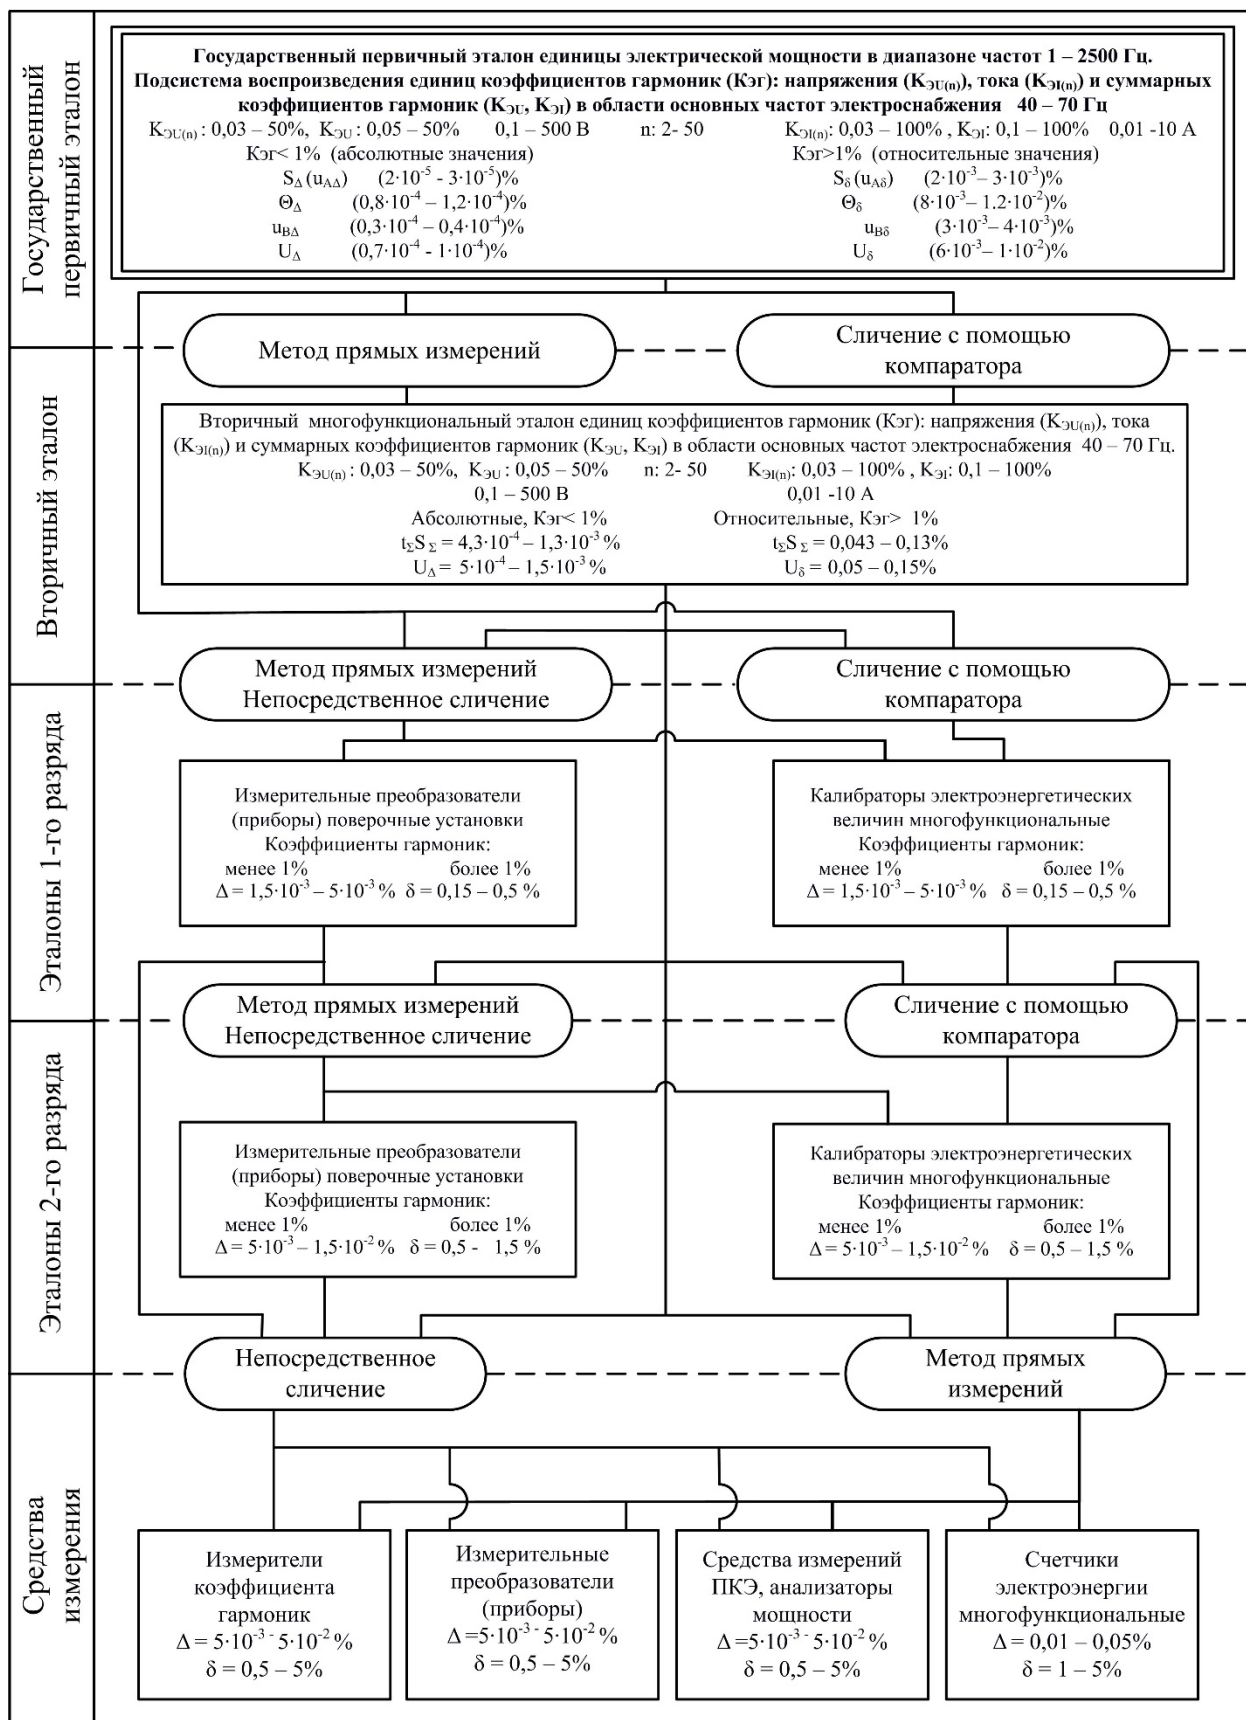

Приложение Д

(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

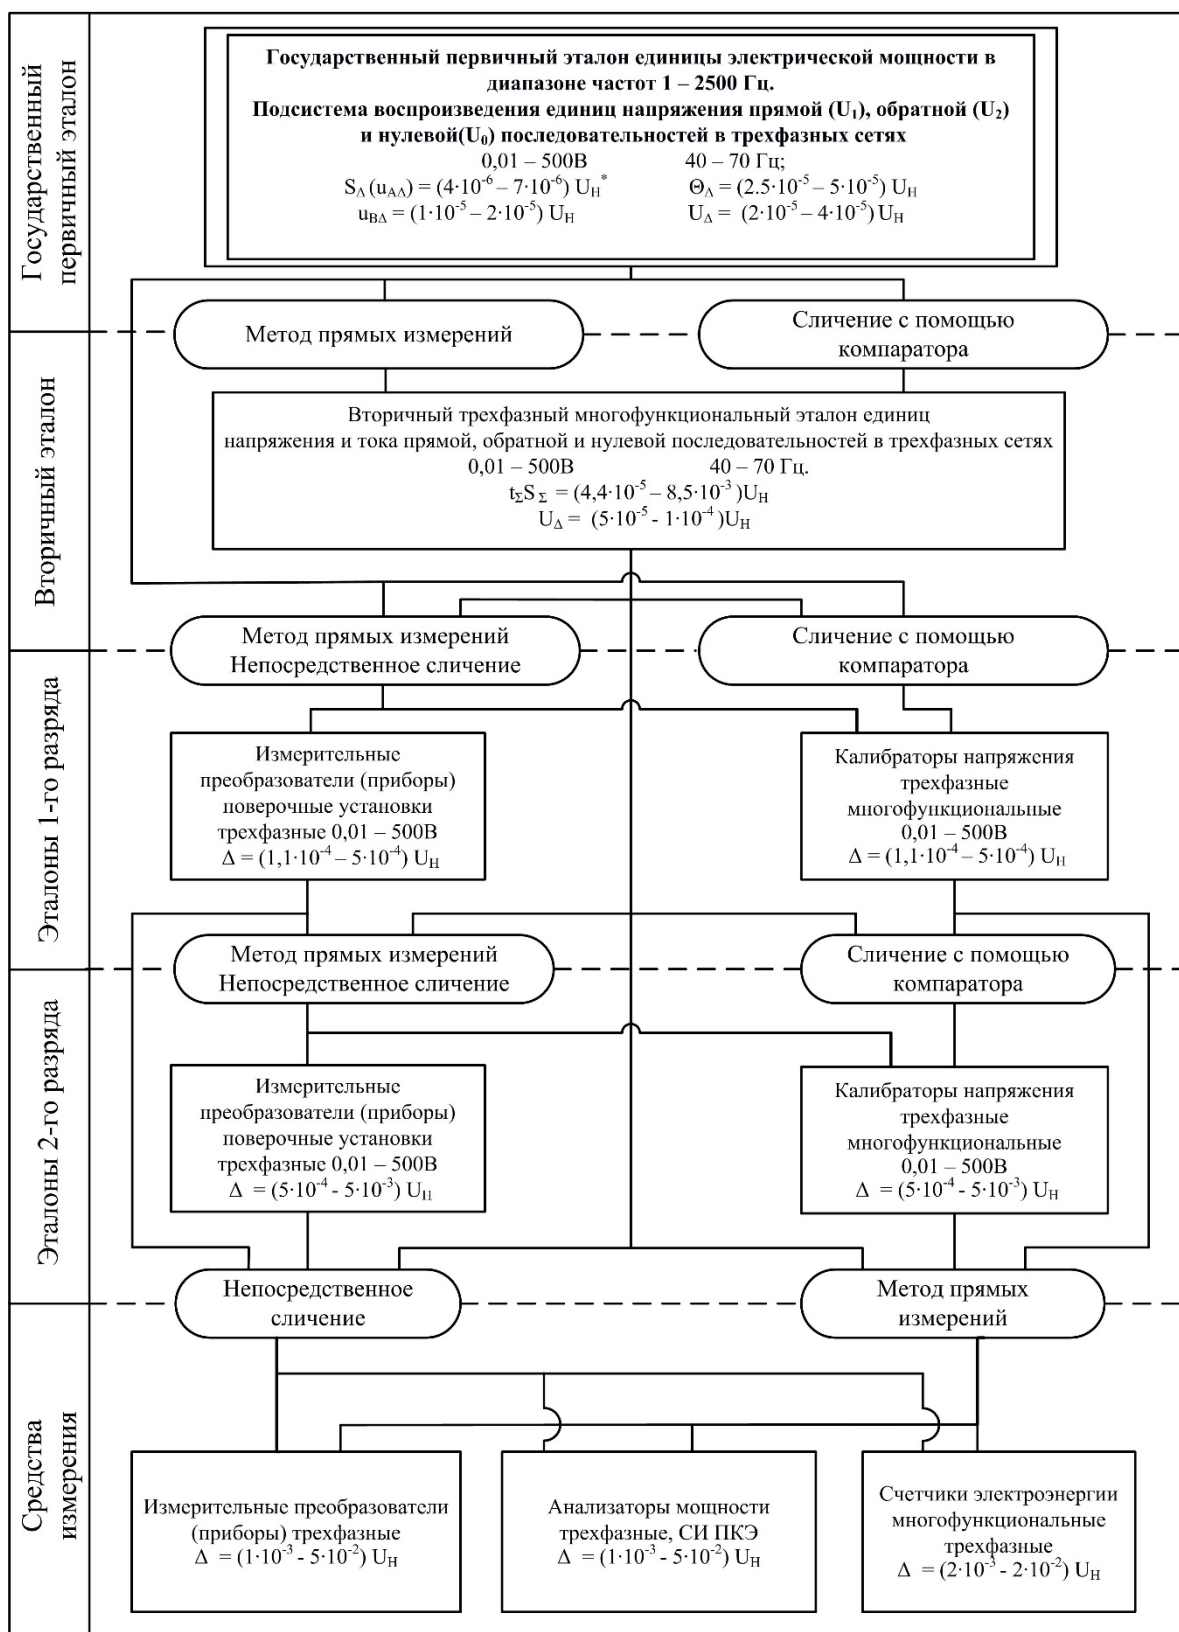

* U_H - номинальное напряжение поддиапазона измерения U_1 , U_2 или U_0 .

Приложение Е

(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц.

