

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа КТМ600 РУС

Назначение средства измерений

Счетчики газа КТМ600 РУС предназначены для измерений и вычислений объёмного расхода, объёма газа при рабочих и стандартных условиях, массового расхода различных неагрессивных и агрессивных газов и пара, в том числе природного, влажного, попутного нефтяного и факельных газов в однофазной области параметров.

Описание средства измерений

Принцип измерения счетчиков газа КТМ600 РУС (далее – счетчики) основан на измерении разности времени прохождения ультразвуковых импульсов. На обеих сторонах трубопровода под определенным углом к потоку устанавливаются приемопередающие блоки. Приемопередающие блоки имеют пьезоэлектрические преобразователи ультразвука, работающие попеременно как приемник и передатчик. Звуковые импульсы посылаются под углом к направлению газового потока. В зависимости от угла и скорости газового потока в результате эффектов вовлечения в движение и торможения наблюдается различное время распространения для определенного направления звуковых импульсов. Разница во времени распространения звуковых импульсов тем значительнее, чем больше скорость газового потока и чем меньше угол к направлению движения потока. Скорость газового потока складывается из разницы двух значений времени распространения независимо от значения скорости ультразвука. Изменения скорости звука в результате колебаний давления или температуры при данном методе измерения не оказывают влияния на рассчитанное значение скорости газового потока.

В зависимости от модели, для более точного определения объема и расхода газа в счетчике может быть установлено до восьми пар ультразвуковых приемопередатчиков, которые передают сигнал без его отражения от внутренней стенки корпуса счетчика. Пары приемопередатчиков стандартно располагаются в одной плоскости параллельно друг другу; в специальных исполнениях – в двух пересекающихся плоскостях.

Конструктивно стандартная модификация счетчика состоит из корпуса, с установленными в нем ультразвуковыми приемопередатчиками (электроакустическими преобразователями), одного блока обработки информации (далее - БОИ), который закреплен с наружной стороны корпуса и модуля выносного. БОИ может разворачиваться вокруг своей оси на угол до 330 градусов и может быть оснащен встроенным вычислителем расхода. В состав БОИ входит жидкокристаллический дисплей, на котором могут отображаться результаты измерений и сообщения системы самодиагностики; результаты вычислений, данные архива, показания внешних датчиков - в модификации со встроенным вычислителем.

Счетчик КТМ600 РУС имеет несколько модификаций:

- модификация КТМ600 РУС Лайт – в один измерительный корпус встроено две пары ультразвуковых приемопередатчиков, и один блок обработки информации Лайт.
- модификация КТМ600 РУС Квадро – в один стандартный измерительный корпус встроено два идентичных независимых счетчика, каждый из которых оснащен четырьмя парами приемопередатчиков и собственным БОИ. Данная система позволяет осуществлять полное дублирование результатов измерений одним прибором.

Модификация счетчика со встроенным в электронный блок вычислителем расхода дополнительно обеспечивает вычисление объемного расхода и объема газа при стандартных условиях, массового расхода и массы газа. Вычисление теплотехнических свойств газовых смесей различного состава, осуществляется по специальным методикам, утвержденным и аттестованным в установленном порядке. В функционале вычислителя реализованы следующие методы расчета физических свойств газов:

- ГСССД МР 113-03
- ГОСТ 30319.2-2015
- ГОСТ 30319.3-2015
- ГСССД МР118-2005
- ГОСТ 30319.2-96 (GERG-91)
- ГОСТ 30319.2-96 (NX19)
- AGA NX 19 1962
- ISO 12213 3 2006 SGERG 88
- ГСССД МР273-2018
- AGA 8 Gross method 1
- AGA 8 Gross method 2
- AGA NX-19 mod
- Гидрокарбон (Hydrocarbon).

Все изменения конфигурируемых параметров или архивов автоматически протоколируются.

Счетчик присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев, выполненных по стандартам ГОСТ, ANSI, DIN или специального исполнения (в зависимости от заказа).

В счетчиках предусмотрена автоматическая самодиагностика и проверка нулевых и контрольных значений измеряемых величин.

В счетчиках предусмотрена возможность измерения расхода газа как в прямом, так и в обратном направлениях (в реверсивном режиме).

В общем случае счетчике предусмотрены следующие входы/выходы:

- аналоговые (токовая петля), активные/пассивные, оптически изолированные, 4-20 мА, с поддержкой HART;
- цифровые выходы, пассивные, оптически изолированные типа открытый коллектор или NAMUR;
- цифровые входы, пассивные;
- RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII;
- Ethernet с поддержкой ModbusTCP/IP.
- для модификаций со встроенным в БОИ вычислителем расхода, предусмотрен ввод в автоматическом режиме значений с датчиков температуры и давления - по протоколу HART; с других датчиков параметров газа (хроматограф, плотномер и т.д.) – по протоколу Modbus.

Пр и м е ч а н и е - В зависимости от исполнения счетчика и требований заказчика предусмотрены различные варианты входов/выходов (приведены в эксплуатационной документации).

Модуль выносной предназначен для удаленного взаимодействия пользователя с блоком обработки информации счетчика.

Модуль выносной, выполняет следующие функции:

- считывание информации от блока обработки информации;
- визуальное представление на дисплее информации о значениях измеряемых параметров, состоянии счетчика;
- передача на верхний уровень системы учета значений измеряемых и вычисляемых счетчиком параметров;
- управление работой счетчика;
- хранение собственной конфигурации;
- самодиагностика состояния внутренних узлов.

Заводской номер счетчика наносится на маркировочную табличку и в паспорт счетчика



Рисунок 1а – Внешний вид счетчика в стандартной модификации.



Рисунок 1б – Внешний вид счетчика в модификации КТМ600 РУС Лайт
(цельноточеный измерительный корпус).

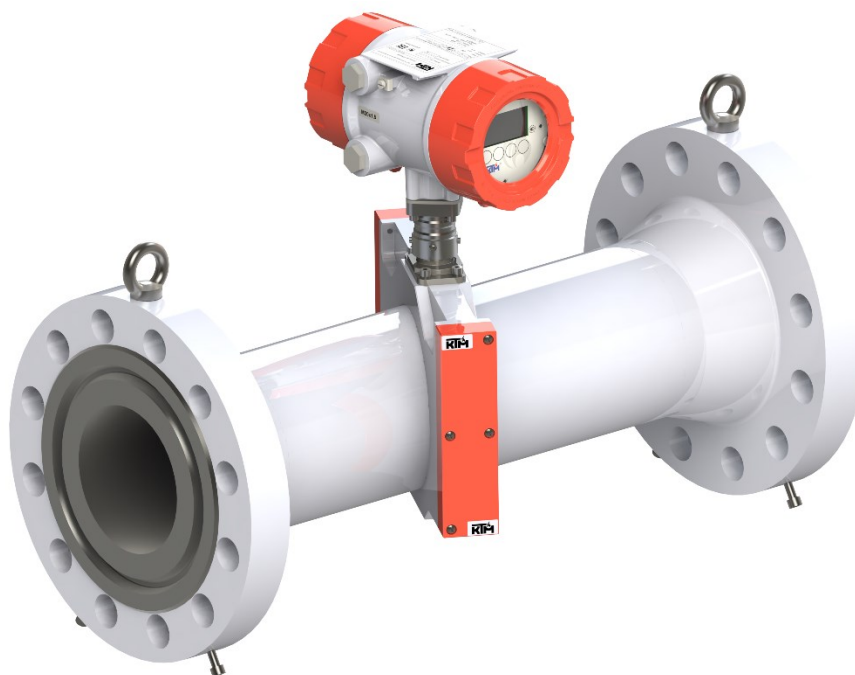


Рисунок 1в – Внешний вид счетчика в модификации КТМ600 РУС Лайт
(сварной измерительный корпус)

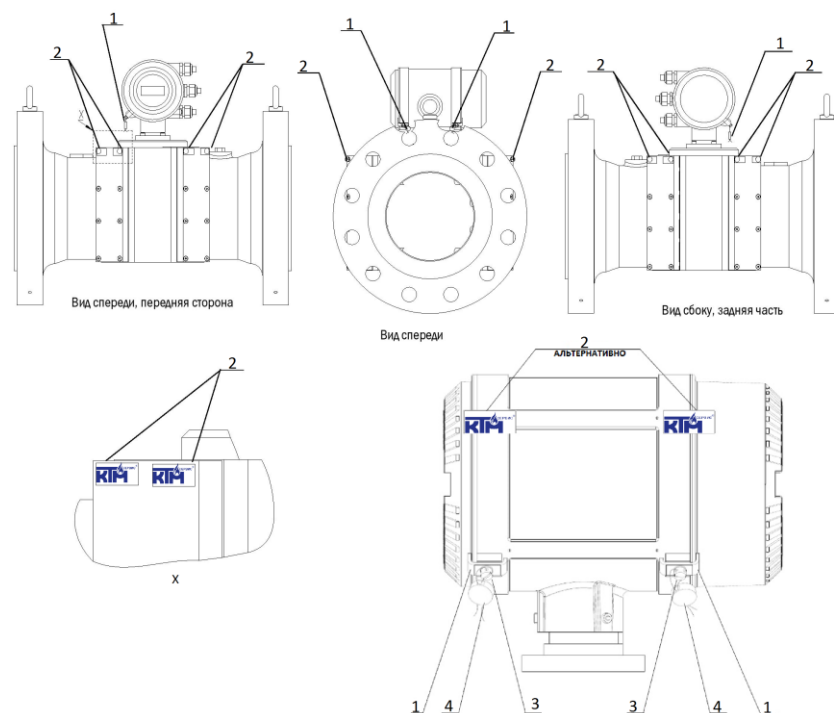


Рисунок 2 – Схема пломбирования (места нанесения знака поверки);
1 – Предохранительный хомут, 2 – Пломбирующая наклейка,
3 – Места для пломб для крышки передней части и задней части,
4 – Винт с крестообразным сверлением головки М4.

Программное обеспечение

Алгоритмы вычислений счетчиков базируются на программном обеспечении БОИ и предназначены для следующих задач:

- приведения измеренного объемного расхода и объема газа в рабочих условиях в объемный расход и объем газа при стандартных условиях, вычисление массового расхода и массы газа;
- вычисления теплофизических свойств газа.
- формирование и хранение энергонезависимых архивов событий, измеренных и вычисленных значений (состав и глубина архивов гибко настраиваемые);
- сигнализацию отказов и превышения установленных пределов измерений подключенных внешних датчиков;
- передачу информации по имеющимся интерфейсам связи, в том числе с выводом на принтер;
- периодическое введение и регистрацию значений условно-постоянных величин;
- защиту от несанкционированного доступа к параметризации и архивам.

Доступ к счетчику может осуществляться с помощью конфигурационного программного обеспечения MEPAFLOW600 CBM или KTM Smart Stream (для модификации KTM600 РУС Лайт), которое состоит из набора программ редактирования. Программное обеспечение предназначено для конфигурирования, параметризации и диагностики счетчика. Содержит процедурные модули, предназначенные для проведения проверки технического состояния счетчика и его поверки, такие как модуль автоматического сбора и обработки диагностических данных счетчика, калькулятор скорости звука в среде и другие модули.

Программное обеспечение защищено многоуровневой системой защиты, которая предоставляет доступ только уполномоченным пользователям и одновременно определяет, какие из данных пользователь может вводить или изменять. При изменении конфигурации счетчика, настройки системы защиты, в том числе уровни доступа пользователей, задают вход по паролю через пользовательские интерфейсы. Метрологические характеристики счетчиков нормированы с учетом влияния встроенного программного обеспечения.

Т а б л и ц а 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	03.4.06
Цифровой идентификатор (CRC16)	0x5EA5 hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	03.5.00
Цифровой идентификатор (CRC16)	0x27E2 hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	03.5.16
Цифровой идентификатор (CRC16)	0x8F86 hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	03.6.08
Цифровой идентификатор (CRC16)	0xCA22 hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	03.6.09
Цифровой идентификатор (CRC16)	0x98DB hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3.6.60
Цифровой идентификатор (CRC16)	0x7D0E hex
Идентификационное наименование ПО	Firmware BOI-2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.0
Цифровой идентификатор (CRC32)	0xB7584FA9

П р и м е ч а н и е – конфигурационные параметры, значения условно-постоянных величин, параметры хранения измеренной информации и другие метрологически значимые параметры определяемые, изменяемые, передаваемые в процессе эксплуатации защищены многоуровневой системой паролей доступа с обязательным протоколированием всех вмешательств. Целостность метрологически значимого ПО, не относящегося к области кода, определяют по журналам событий и состояниям специально выделенных параметров конфигурации, предназначенных для целей проверки целостности ПО в соответствии с руководством по эксплуатации.

Уровень защиты ПО в соответствии с Р 50.2.077-2014 – высокий.

Метрологические и технические характеристики

Т а б л и ц а 2 – Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
Диапазон измерений расхода газа ¹⁾ , м ³ /ч	от 4 до 130000	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема газа при рабочих условиях, для комбинации пар приемопередатчиков расположенных в одной плоскости:	Диапазон расхода	
	$Q_{\min} \leq Q < Q_t^{(2)}$	$Q_t^{(2)} \leq Q < Q_{\max}$
- при 1 паре ультразвуковых приемопередатчиков, %	$\pm 1,0^{(3)}$, $\pm 2,0^{(4, 5)}$, $\pm 3,0^{(6)}$	$\pm 0,7^{(3)}$, $\pm 1,5^{(4, 5)}$, $\pm 2,0^{(6)}$
- при 2 парах ультразвуковых приемопередатчиков, %	$\pm 0,7^{(3)}$, $\pm 1,0^{(4, 5)}$, $\pm 1,5^{(6)}$	$\pm 0,5^{(3)}$, $\pm 0,7^{(4, 5)}$, $\pm 1,0^{(6)}$
- при 4 парах ультразвуковых приемопередатчиков, %	$\pm 0,7^{(4, 5)}$, $\pm 1,0^{(6)}$	$\pm 0,5^{(4, 5)}$, $\pm 0,7^{(6)}$
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при вычислении массового расхода, объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, ⁷⁾ %	±0,01	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени, %	±0,01	

¹⁾ Указан общий диапазон расхода, значения могут отличаться в зависимости от типоразмера счетчика, см. таблицу 3;

²⁾ Q_t - пограничное значение диапазона расхода. Зависит от типоразмера счетчика, см. таблицу 3;

³⁾ При калибровке (поверке) на природном газе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ±0,23%;

⁴⁾ При калибровке (поверке) на воздухе проливным методом на эталонной установке с относительной погрешностью не более ± 0,3%;

⁵⁾ При поверке имитационным методом для DN200 и более, для типоразмеров менее DN200 при периодической поверке при условии первичной поверки проливным методом по пунктам примечания ³⁾ или ⁴⁾;

⁶⁾ При имитационном методе поверки (в том числе и для первичной поверки) для типоразмеров менее DN200;

⁷⁾ Указанная погрешность вычислений не содержит погрешности определения температуры, давления и цифро-аналоговых преобразований. Погрешность вычисления массового расхода объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, определяются в соответствии с действующими нормативными документами на системы измерений на базе ультразвуковых преобразователей расхода (методики измерений).

Т а б л и ц а 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон температур измеряемого газа, °С	от -60 до +280 от -194 до +280 (по заказу)
Диапазон давления измеряемого газа, МПа	от атмосферного до 45
Диапазон скорости потока измеряемого газа, м/с	от 0 до 65
Напряжение питания постоянного тока, В	от 12 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	4
Диапазон температуры окружающей среды, °С	от -40 до +60
Максимальная относительная влажность окружающей среды, %	95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Габаритные размеры (в зависимости от типоразмера и типа марки стали корпуса) длина, мм высота, мм ширина (диаметр фланца), мм	от 150 до 2800 от 335 до 1785 от 150 до 1785
Масса, кг	от 10 до 12100
Средний срок службы, лет, не менее	15
Номинальный диаметр, DN	от 50 до 1400

Т а б л и ц а 4 – Диапазоны расходов газа при измерении объемного расхода газа в рабочих условиях.

Номинальный диаметр	Объемный расход в рабочих условиях м³/ч			Максимальная скорость газа, м/с
DN	Q _{мин}	Q _т	Q _{макс}	V _{макс}
50	4	13	400	65
80	8	32	1000	65
100	13	50	1600	60
150	20	80	3000	50
200	32	130	4500	45
250	50	240	7000	40
300	65	375	8000	33
350	80	375	10000	33
400	120	600	14000	33
450	130	650	17000	33
500	200	975	20000	33
600	320	1500	32000	33
700	400	2000	40000	30
750	400	2000	45000	30
800	400	2400	50000	30
900	650	3750	66000	30
1000	650	5000	80000	30
1050	1300	6000	85000	30
1100	1400	6500	90000	28
1200	1600	7000	100000	27
1300	2000	7300	110000	26
1400	2300	8600	130000	25

Знак утверждения типа

наносят на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики в верхнем левом углу, на боковую панель счетчика в центре методом наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик газа КТМ600 РУС ¹⁾	КТМ600 РУС	1 шт.
Модуль выносной ¹⁾	МВ	1 шт.
Руководство по эксплуатации	РЭ	1 экз.
Паспорт	ПС	1 экз.
Нормативный документ на поверку счётчика:	МП 0302-13-2015 с изм. №2	1 экз.
Программное обеспечение для конфигурирования, параметризации и диагностики счётчика	МЕРАFLOW600 CBM / КТМ Smart Stream	1 шт.
Комплект заводской документации	ЗД	1 экз
Примечание - В зависимости от требований заказчика комплект поставки может быть изменен.		

Сведения о методиках (методах) измерений

Раздел 1.5 «Устройство и работа» Руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа КТМ600 РУС

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2825 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа

ГОСТ 30319.(0-3)-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств

ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ГОСТ Р 8.733-2011 ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования

ГСССД МР 113-03 Определение плотности, фактора сжимаемости, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости влажного нефтяного газа в диапазоне температур 263...500 К при давлениях до 15 МПа

ТУ 4213–002–20642404–2014. Счётчики «КТМ600 РУС». Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» (ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»)

ИНН 6312102369

Адрес: РФ, 443052, Самара, ул. Земеца, д.26Б, оф. 413

Тел./факс: (846) 202-00-65

E-mail: info@ktkprom.com

Web-сайт: www.ktkprom.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии – филиал Федерального Государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19.

Фактический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Телефон: (843) 272-70-62

Факс: (843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Регистрационный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310592