

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «06» декабря 2022 г. № 3059

**Сведения**  
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению  
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>типа                                                    | Обозначение типа                        | Заводской<br>номер                                   | Регистраци-<br>онный<br>номер<br>в ФИФ | Правообла-<br>датель | Отменяемая методика<br>поверки      | Действие<br>методики<br>поверки<br>сохраняется | Устанавлива-<br>емая методика<br>поверки | Добавля-<br>емый<br>изготови-<br>тель | Дата<br>утверж-<br>дения<br>акта<br>испытани-<br>й | Заявитель                                                                                                                                                                   | Юридическое<br>лицо,<br>проводившее<br>испытания |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.           | Комплексы<br>измерительные<br>автоматизиров<br>анного учета<br>алкоголя | 3<br>«БАЗИС<br>2006М»                   | 4<br>0314, 0360                                      | 5<br>58632-14                          | 6<br>-               | 7<br>МП 58632-14 с<br>изменением №1 | 8<br>-                                         | 9<br>МП 208-048-<br>2021                 | 10<br>-                               | 11<br>30.08.<br>2022                               | 12<br>Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Завод аграрных<br>химических<br>продуктов» (ООО<br>«Завод<br>Агрохимпродукт»),<br>п.г.т. Редкино,<br>Тверская обл. | 13<br>ФГБУ<br>«ВНИИМС»,<br>г. Москва             |
| 2.           | Счетчики<br>электрической<br>энергии                                    | типа МИР С-04,<br>МИР С-05,<br>МИР С-07 | 48597020497486,<br>48596920497667,<br>48560420492943 | 61678-15                               | -                    | М15.034.00.000<br>МП                | -                                              | М15.034.00.0<br>01 МП                    | -                                     | 15.11.<br>2021                                     | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Спецэнергопроект»<br>(ООО<br>«Спецэнергопроект»),<br>г. Москва                                                           | ФГБУ<br>«ВНИИМС»,<br>г. Москва                   |

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Счетчики электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07

#### Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07 (далее по тексту – счетчики МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, частоты, среднеквадратических значений напряжений и силы переменного тока в электрических цепях переменного тока, а также для измерения показателей качества электрической энергии. Счетчики предназначены для организации многотарифного учета электрической энергии.

Счетчики МИР С-04 предназначены для непосредственного подключения к трехфазным четырехпроводным или однофазным цепям переменного тока с номинальным напряжением 220 В или 230 В. Счетчики МИР С-04 имеют функцию фазного учета электроэнергии и могут применяться как однофазные счетчики с возможностью одновременного подключения от одного до трех потребителей.

Счетчики МИР С-04 класса точности 0,2/0,2 предназначены для работы в трехфазных четырехпроводных или однофазных цепях переменного тока с номинальным напряжением 220 В или 230 В в автономном режиме.

Счетчики МИР С-05 предназначены для непосредственного подключения к однофазным цепям переменного тока с номинальным напряжением 220 В или 230 В.

Счетчики МИР С-07 предназначены для работы в трехфазных трех и четырехпроводных цепях переменного тока с номинальным напряжением 57,7 В, 230 В или 220 В.

Счетчики МИР С-07 имеют цепи тока трансформаторного включения и цепи напряжения непосредственного или трансформаторного включения.

Счетчики МИР С-04 (за исключением счетчиков МИР С-04 класса точности 0,2/0,2), МИР С-05, МИР С-07 предназначены для эксплуатации:

- в автономном режиме;
- в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии;
- в составе совмещенных автоматизированных системах диспетчерского управления и автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии;
- в составе автоматизированных систем управления наружным освещением.
- в составе систем телемеханики.

### **Описание средства измерений**

Принцип действия счетчиков основан на вычислении действующих значений тока и напряжения, активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности и частоты сети переменного тока по измеренным мгновенным значениям входных сигналов тока и напряжения.

Счетчики имеют в своем составе входные датчики напряжения и тока, микросхему аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллер, устройства хранения и отображения измеряемых и вычисленных величин и набор интерфейсов.


В качестве датчиков напряжения в счетчиках используются резистивные делители напряжения. В качестве датчиков тока используются трансформаторы тока или шунты.

Счетчики (в зависимости от кода) имеют дополнительный датчик для измерения тока в нейтральном проводе сети.

Аналого-цифровой преобразователь производит измерения и вычисление значений входных величин под управлением микроконтроллера. Также микроконтроллер управляет процессом записи измеренных и вычисленных величин в энергонезависимую память, ведением журналов событий и выводом данных в интерфейсы и на индикатор.

Структура условного обозначения.


Структура условного обозначения счетчиков МИР С-04 приведена на рисунке 1.

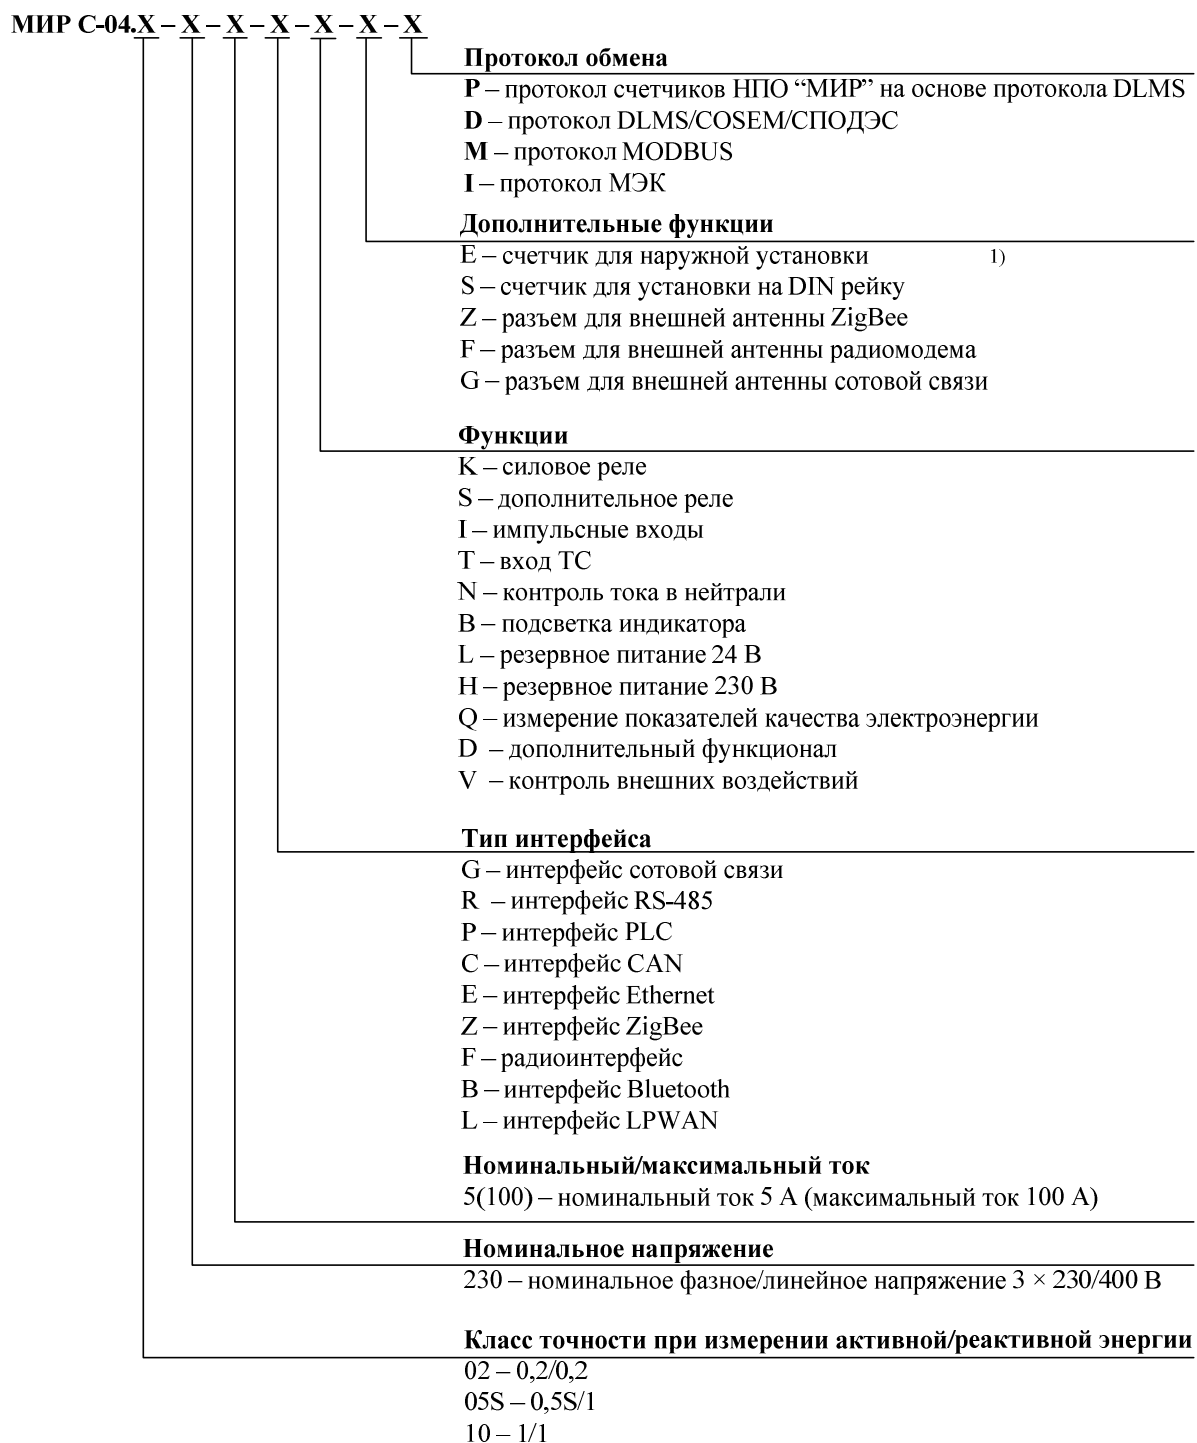

<sup>1)</sup> При отсутствии символа “Е” счетчик предназначен для внутренней установки

Рисунок 1 – Структурное обозначение счетчиков МИР С-04


Структура условного обозначения счетчиков МИР С-05 приведена на рисунке 2.

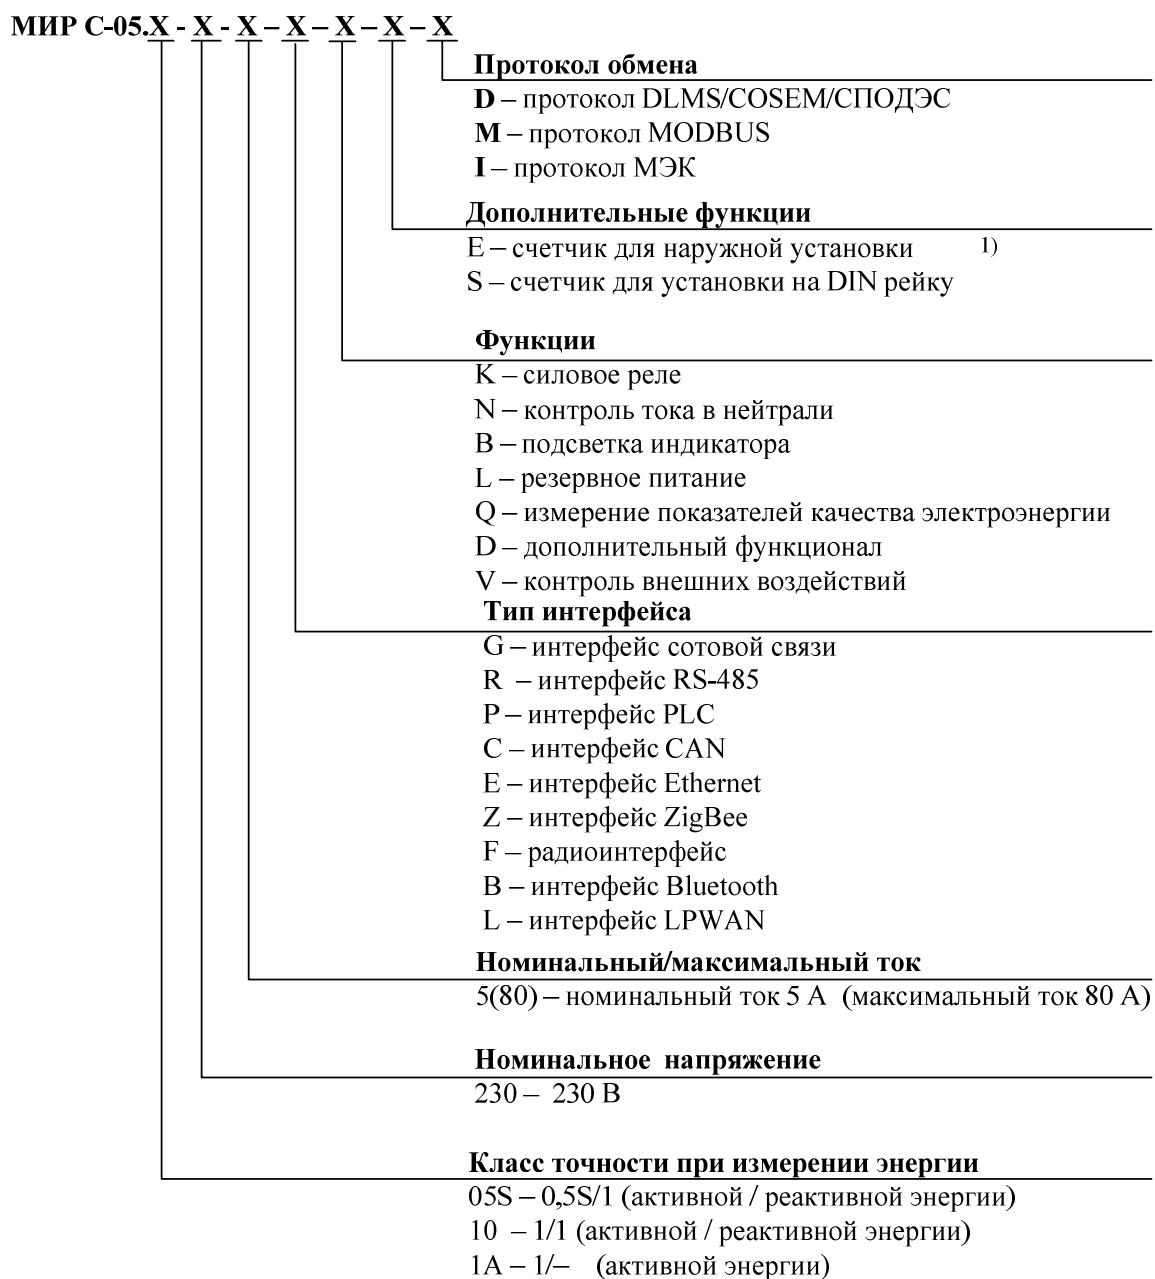

<sup>1)</sup> При отсутствии символа «Е» счетчик предназначен для внутренней установки

Рисунок 2 – Структурное обозначение счетчиков МИР С-05

Структура условного обозначения счетчиков МИР С-07 приведена на рисунке 3.

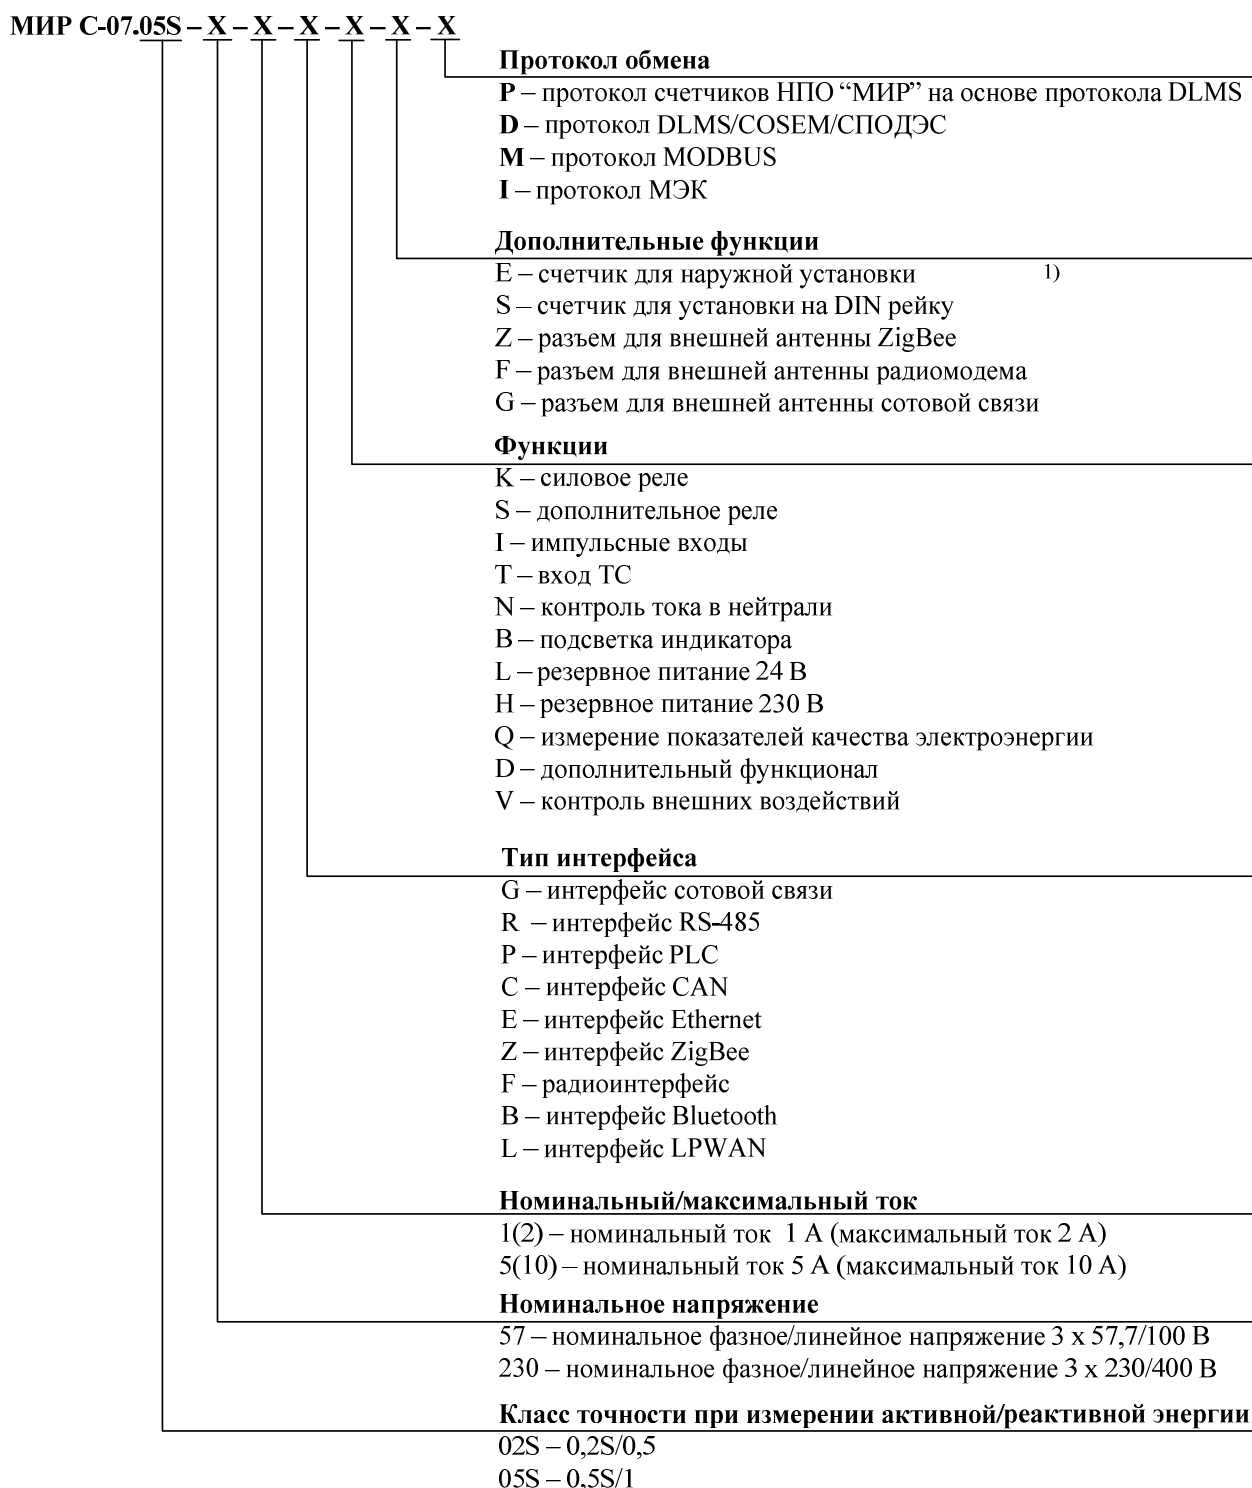

<sup>1)</sup> При отсутствии символа “E” счетчик предназначен для внутренней установки

Рисунок 3 – Структурное обозначение счетчиков МИР С-07

При наличии в счетчике нескольких интерфейсов, функций, дополнительных функций или протоколов обмена их коды записываются последовательно. Цифра после символа, обозначающего тип интерфейса, функцию, дополнительную функцию или протокол обмена, указывает на модификацию соответствующего функционала (не ставятся при отсутствии модификаций).

Пример записи счетчика при заказе:

Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.10-230-5(100)-PZ-K-D.

Счетчики ведут многотарифный учет активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений по четырем тарифам в двенадцати тарифных зонах по четырем типам дней.

Все регистрируемые счетчиками события фиксируются в журналах событий и затем хранятся в соответствующих архивах.

Счетчики (в зависимости от кода счетчика) обеспечивают измерение по классу S согласно ГОСТ Р 30804.4.30-2013 следующих показателей качества электроэнергии:

- положительного и отрицательного отклонения напряжения;
- отклонения частоты;
- провала напряжения;
- перенапряжения.

Счетчики имеют следующие интерфейсы связи: оптический порт, а также в зависимости от кода счетчика интерфейсы RS-485, PLC, CAN, Ethernet, ZigBee, LPWAN, Bluetooth, интерфейс сотовой связи и радиointерфейс.

Все интерфейсы счетчика являются равноприоритетными и независимыми.

Работа со счетчиками через интерфейсы связи возможна как с помощью программного обеспечения «КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА» и «КОНФИГУРАТОР СЧЕТЧИКОВ МИР», так и с использованием программного обеспечения пользователей.

Доступ к конфигурации и данным счетчика защищен паролями (три уровня доступа).

Счетчики, применяемые внутри помещений, имеют в своем составе жидкокристаллический дисплей (далее – дисплей) для отображения измеренных и вычисленных параметров, а также дополнительной информации. Управление выводом информации на дисплей обеспечивается наличием двух (для счетчиков МИР С-05) или трех (для счетчиков МИР С-04 и МИР С-07) кнопок управления, находящихся на лицевой панели счетчика.

Счетчики для наружной установки не имеют встроенного дисплея и кнопок управления. Для считывания данных со счетчиков для наружной установки используется удаленный дисплей потребителя МИР ДП-01 или МИР ДП-01.П.

Дисплей счетчиков, применяемых внутри помещений, имеет подсветку (в зависимости от кода счетчика), которая включается при нажатии любой из кнопок счетчика.

Счетчики (в зависимости от кода) позволяют управлять нагрузкой посредством встроенных силовых реле (с возможностью аппаратной блокировки срабатывания встроенных силовых реле), либо формировать сигналы управления внешними отключающими устройствами с помощью встроенных дополнительных реле по следующим критериям:

- по команде оператора, переданной по одному из интерфейсов счетчика;
- при превышении допустимого лимита потребляемой активной мощности;
- при превышении заданного порога по напряжению;
- при недопустимом перегреве счетчика;
- при превышении допустимого лимита потребляемого тока;
- при воздействии внешнего магнитного поля, превышающего установленные в ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.23-2012 значения, в течение времени, заданного при конфигурировании;
- при превышении допустимого значения дифференциального тока;
- по годовому расписанию;
- и по другим критериям, приведенным в эксплуатационной документации.

Счетчики МИР С-04 и МИР С-05 с установленными силовыми реле автоматически отключают нагрузку при недопустимом перегреве счетчика.

Счетчики МИР С-04, МИР С-07 имеют два испытательных электрических выхода:

- импульсный выход активной энергии прямого и обратного направлений;
- импульсный выход реактивной энергии прямого и обратного направлений.

Счетчики (в зависимости от кода счетчика) имеют входы телесигнализации.

Общий вид счетчиков и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначения мест нанесения знака поверки, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа представлены на рисунках 4-9.

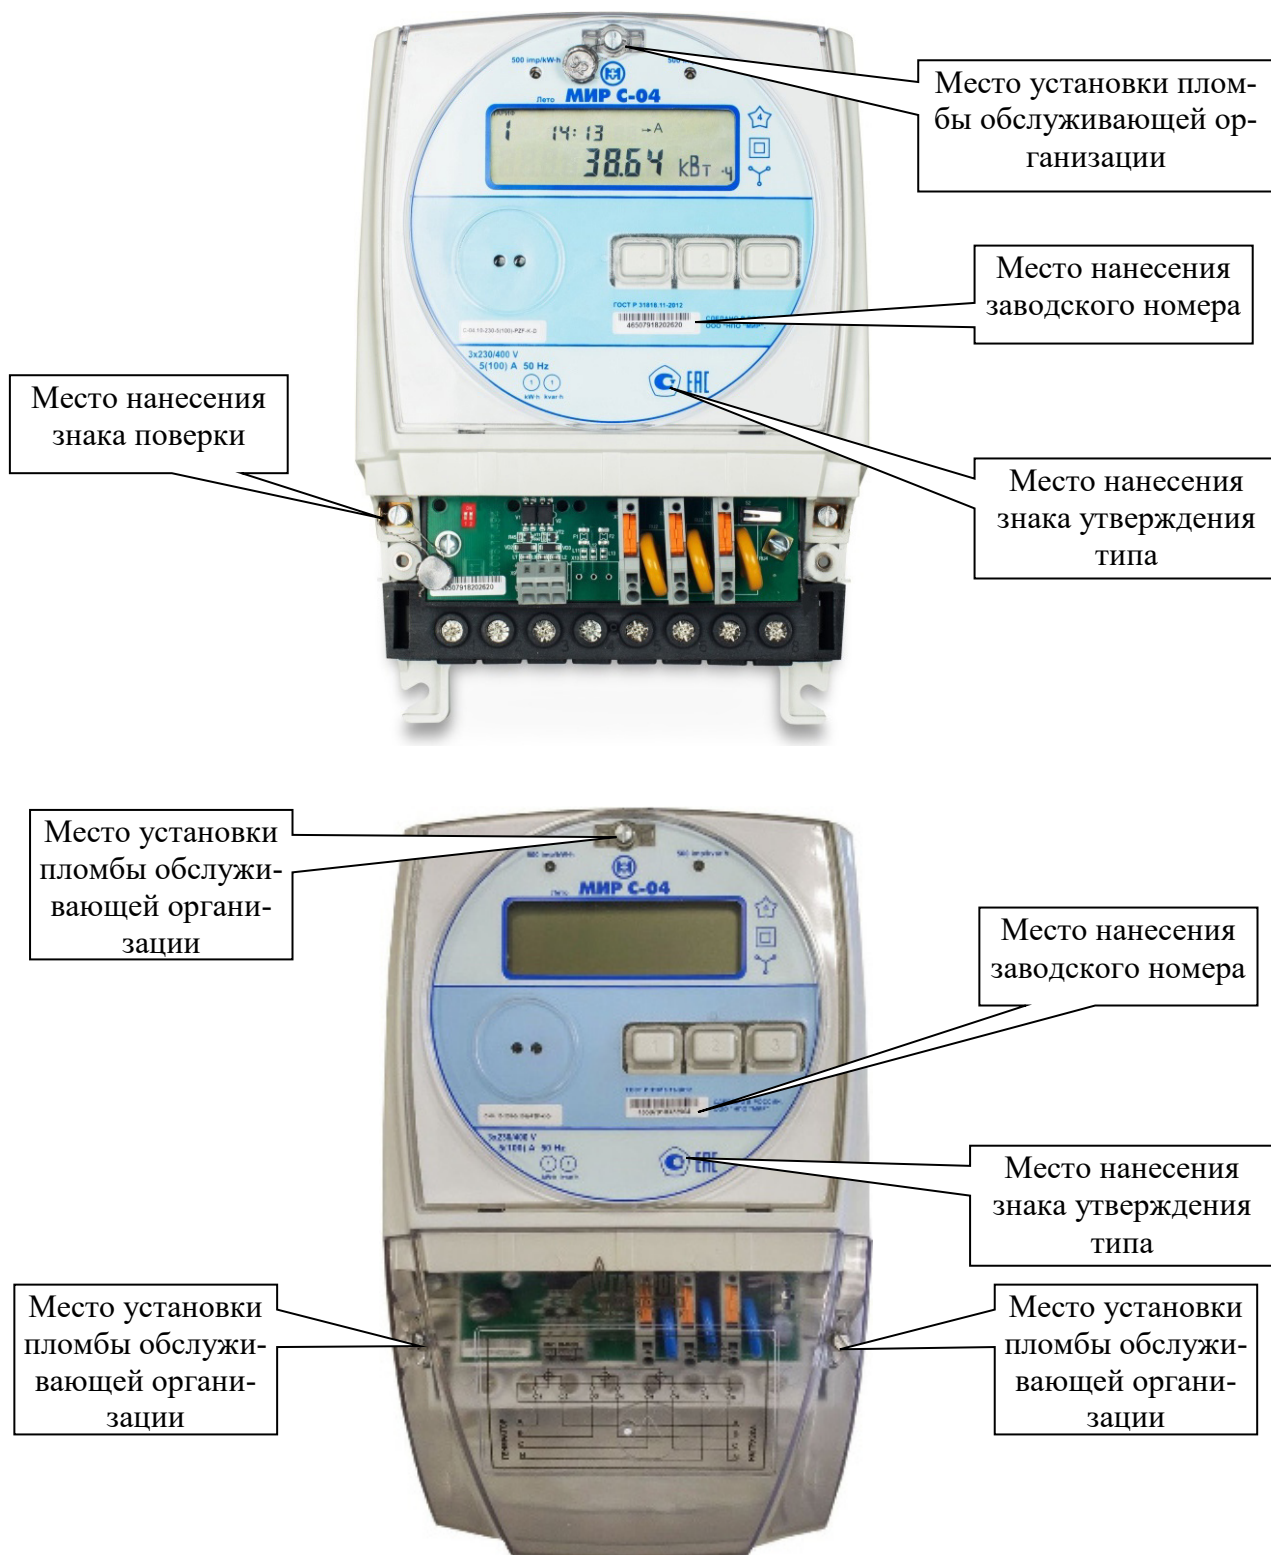


Рисунок 4 – Общий вид счетчиков МИР С-04 применяемых внутри помещений и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

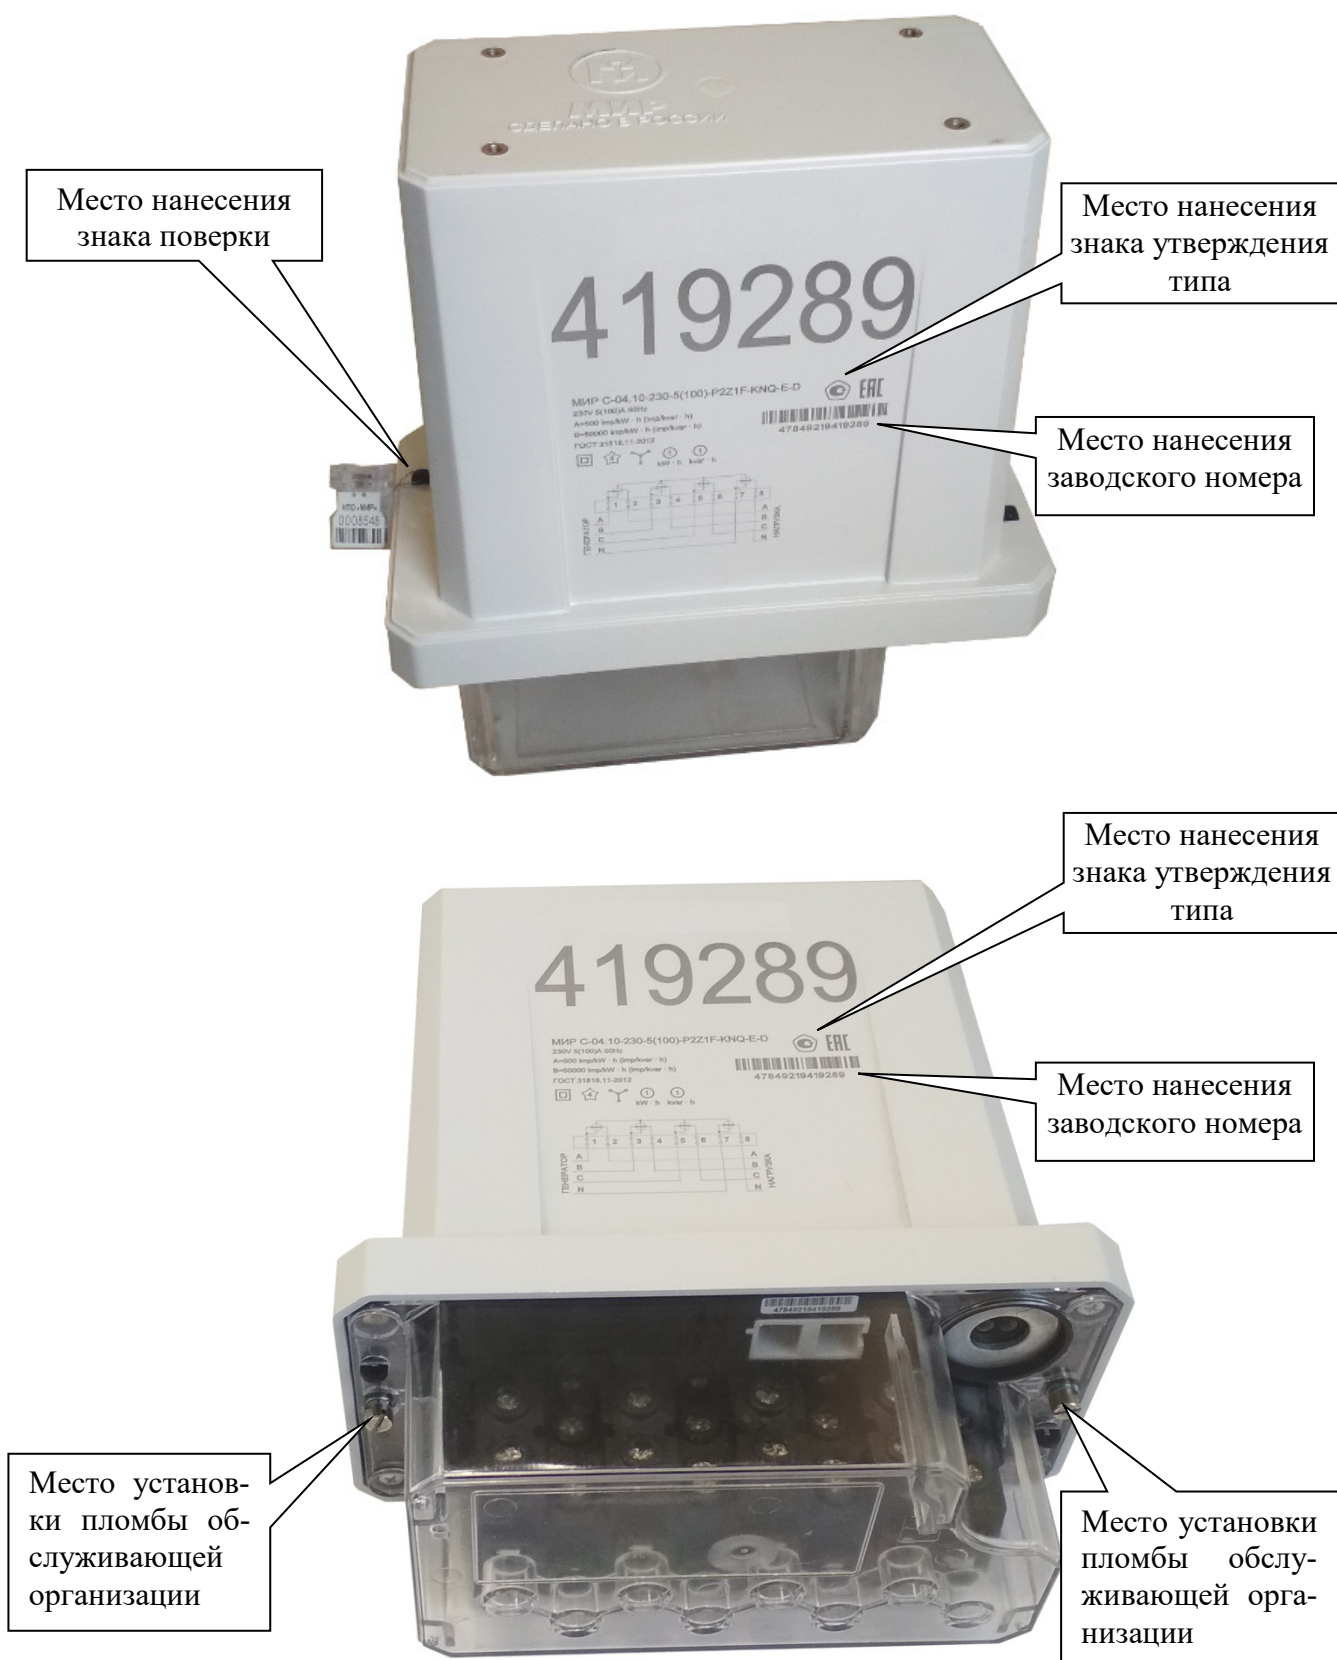


Рисунок 5 – Общий вид счетчиков МИР С-04 для наружной установки и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

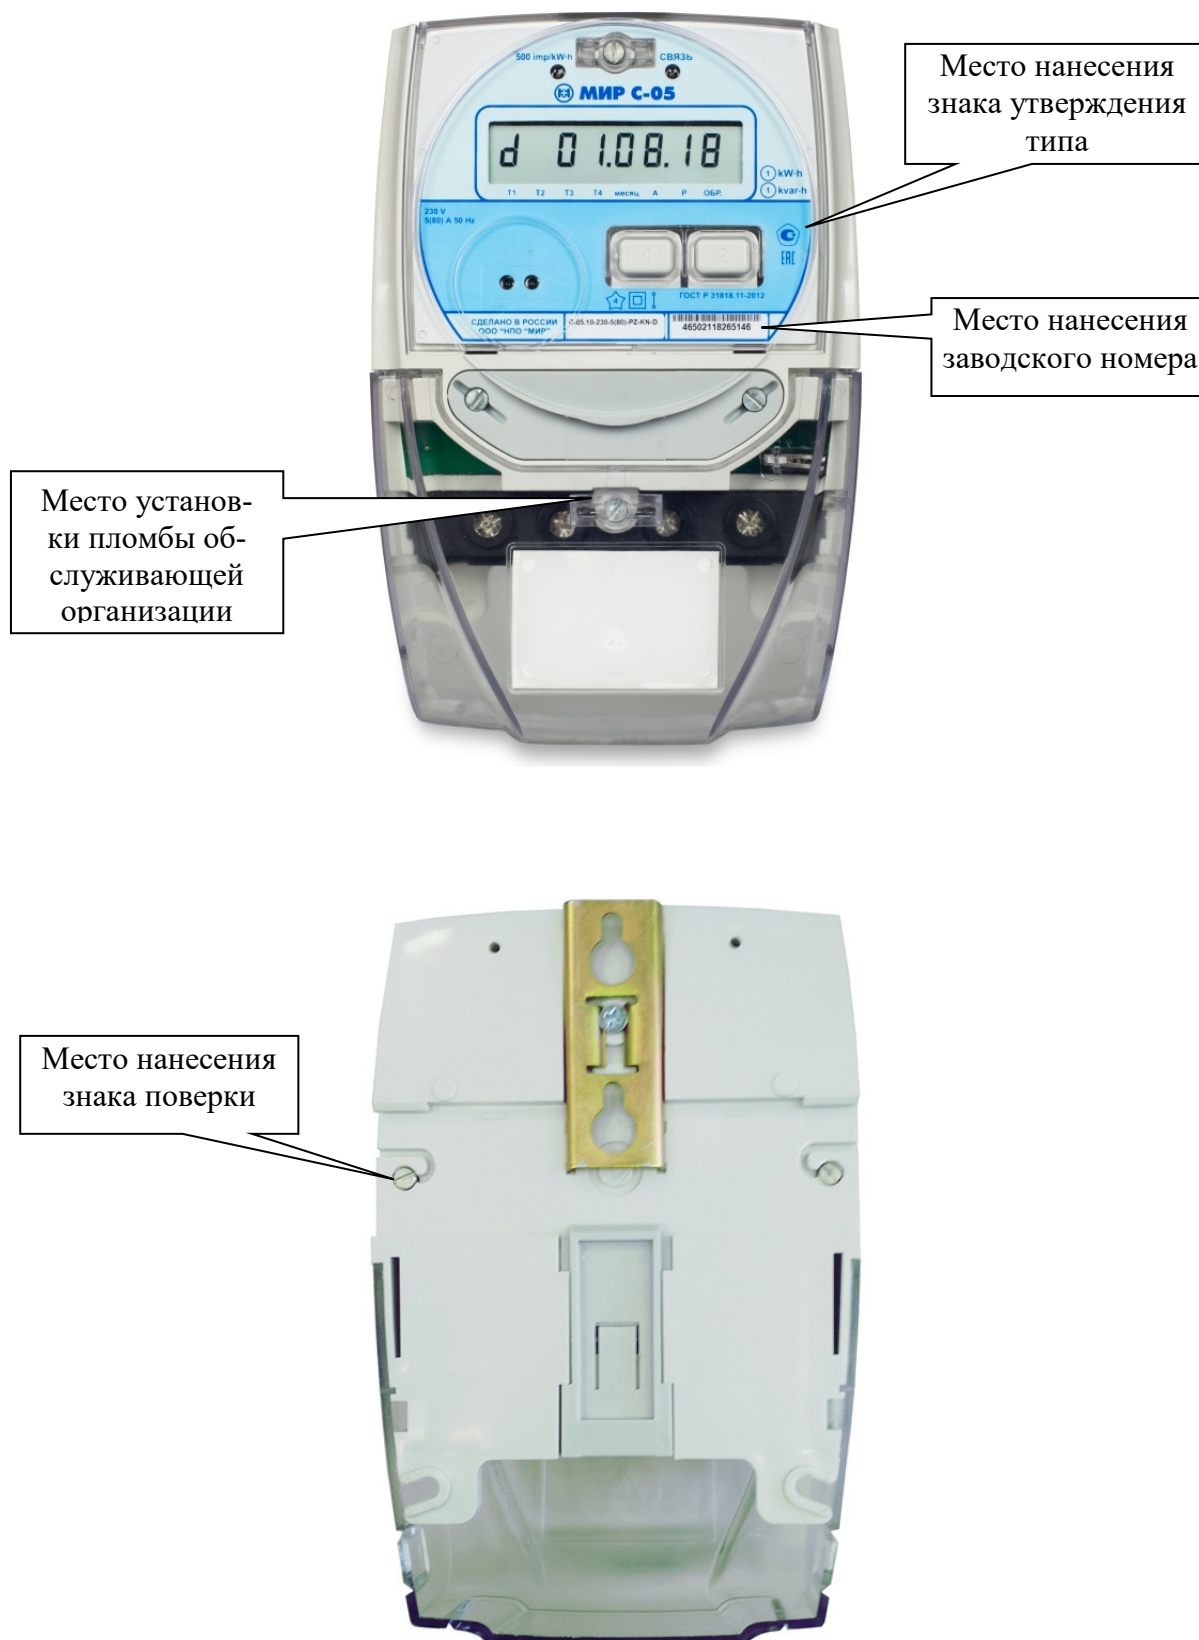


Рисунок 6 – Общий вид счетчиков МИР С-05, применяемых внутри помещений, и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

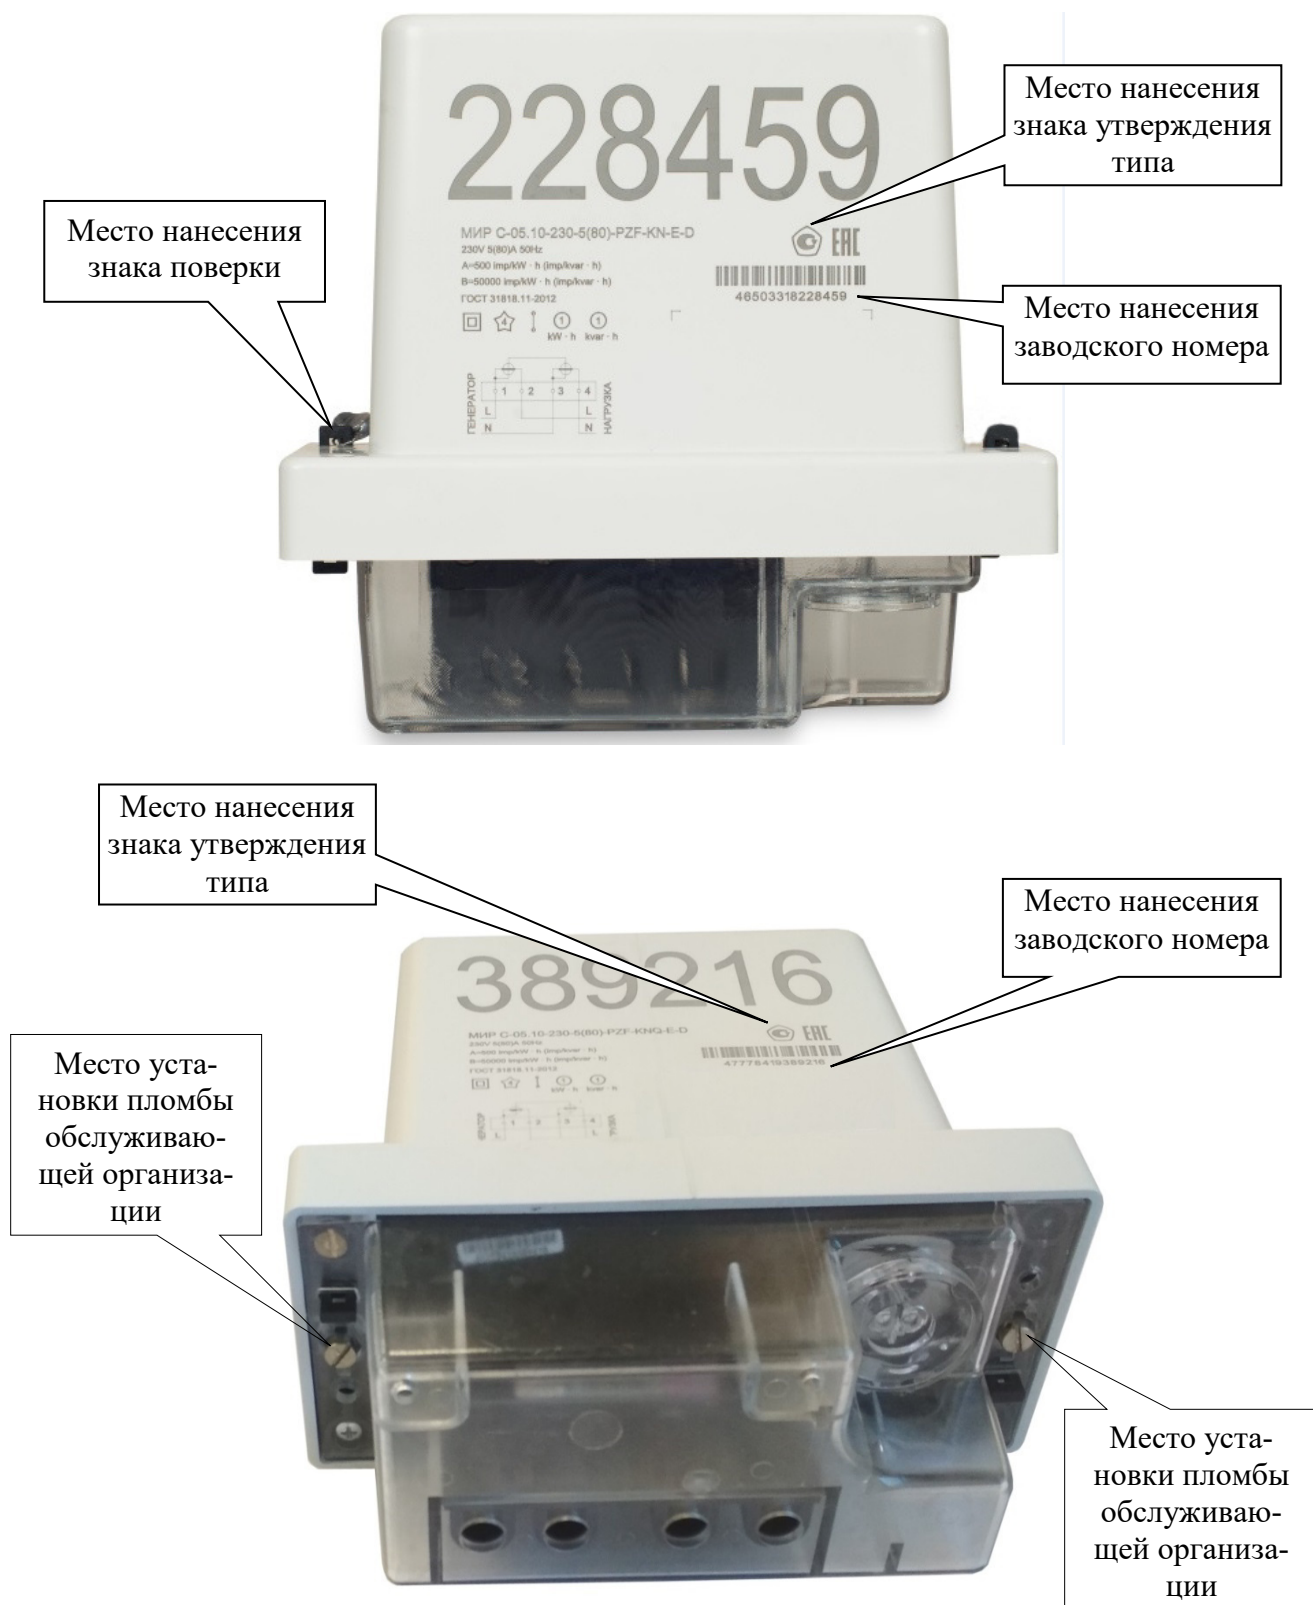


Рисунок 7 – Общий вид счетчиков МИР C-05 для наружной установки, и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

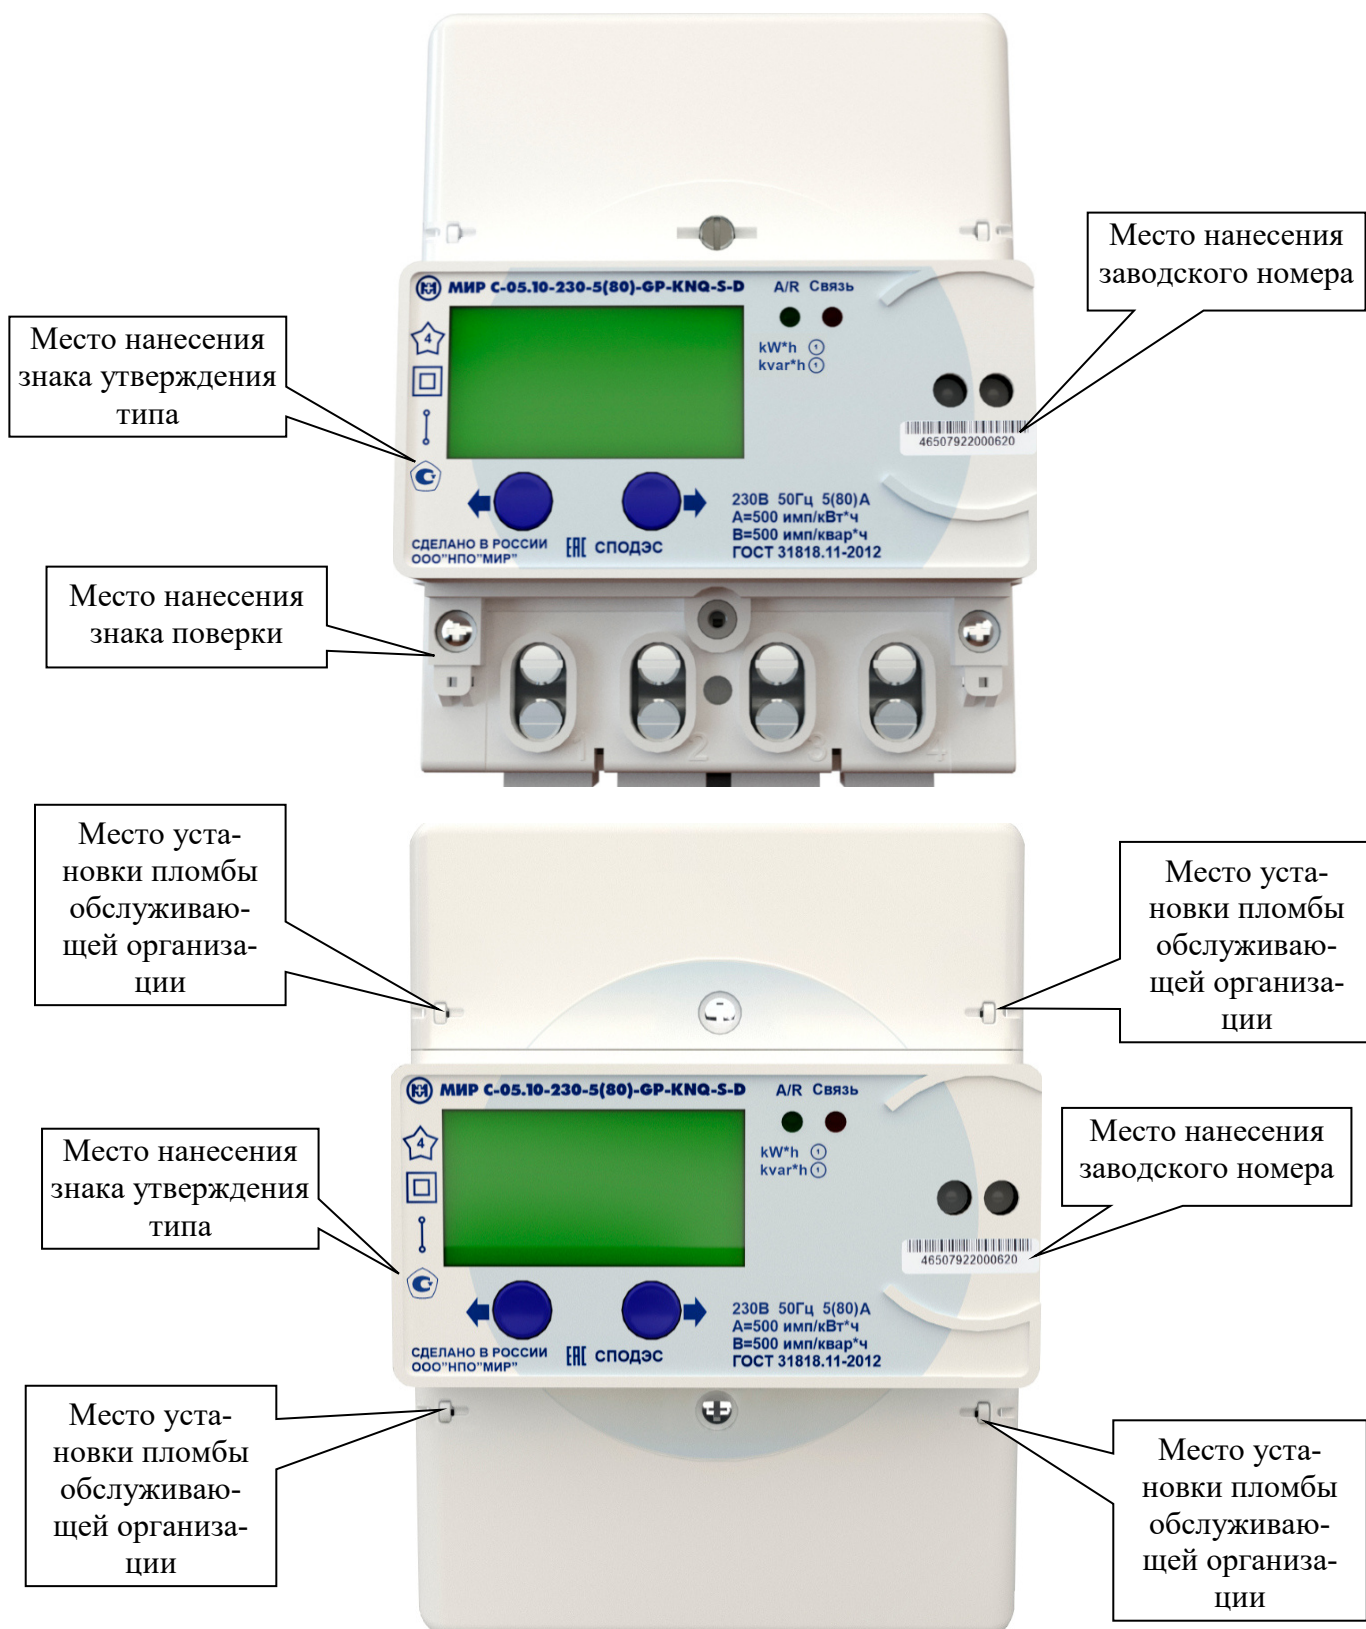


Рисунок 8 – Общий вид счетчиков МИР С-05 для установки на DIN рейку, и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

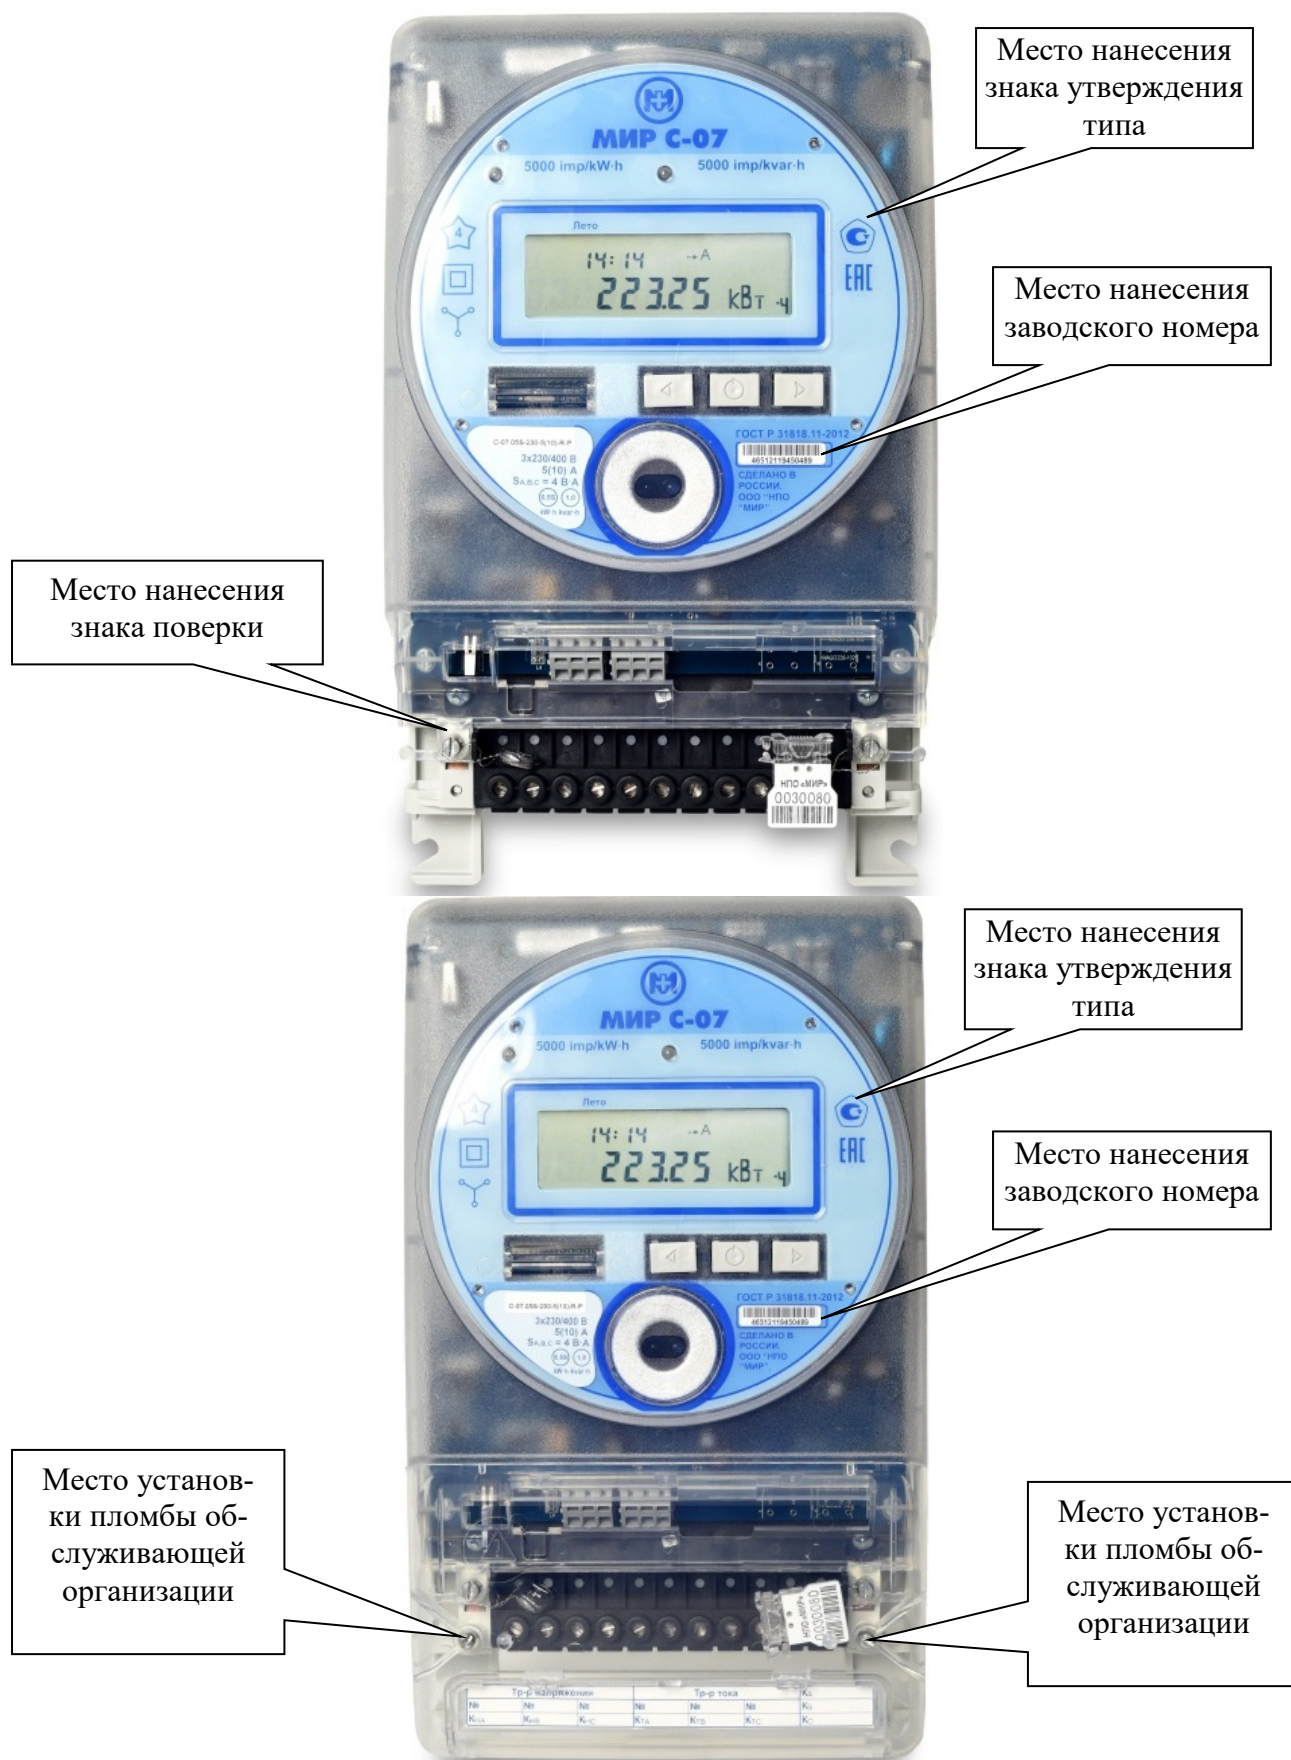


Рисунок 9 – Общий вид счетчиков МИР С-07 и схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения заводского номера, знаков поверки и утверждения типа

Счетчики имеют пломбировку завода-изготовителя и имеют возможность опломбировки организациями, осуществляющими поверку счетчика.

Кроме механических пломб счетчики имеют датчики вскрытия крышки корпуса и крышки клеммной колодки (электронные пломбы). Электронные пломбы работают как при включенном в сеть счетчике, так и при нахождении счетчика в отключенном состоянии. Факты вскрытия крышек и время вскрытия фиксируются в журнале событий.

Счетчики всех модификаций имеют датчик переменного и постоянного магнитного поля. При наличии символа V в коде, счетчики имеют датчик электромагнитного поля высокой частоты. Факты воздействия на счетчик фиксируются в журнале событий.

Счетчики, прошедшие поверку, имеют навесные пломбы предприятия-изготовителя и пломбу с оттиском поверительного клейма. Пломбы расположены на головках пломбировочных винтов, крепящих лицевую крышку к основанию счетчика, применяемого внутри помещения, или крепящих колодку с силовыми зажимами к корпусу счетчика для наружной установки.

Заводской номер в виде цифрового кода и знак утверждения типа наносятся на лицевую сторону счетчика.

### Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение счетчика (в дальнейшем – ПО) реализовано аппаратно (в управляющем микроконтроллере) и не может быть считано. Встроенное ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую (прикладную) части, которые объединены в единый файл.

Идентификационные данные встроенного ПО счетчика приведены в таблице 1.

Номер версии ПО может быть считан со счетчиков по интерфейсам.

Таблица 1

| Идентификационные данные (признаки)                                                                                                               | Значение          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                   | МИР С-04          | МИР С-05          | МИР С-07          |
| Идентификационное наименование ПО                                                                                                                 | s04v1.0.X.XXX.bin | s05v1.0.X.XXX.bin | s07v1.0.X.XXX.bin |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО                                                                                                         | Не ниже 1.0.X.XXX | Не ниже 1.0.X.XXX | Не ниже 1.0.X.XXX |
| Цифровой идентификатор ПО                                                                                                                         | —                 | —                 | —                 |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения                                                                             | —                 | —                 | —                 |
| Примечание – Номер версии метрологически значимой части ПО определяют первые две цифры, остальные – номер версии метрологически незначимой части. |                   |                   |                   |

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «Высокий» в соответствии с документом Р 50.2.077-2014.

Программное обеспечение «КОНФИГУРАТОР СЧЕТЧИКОВ МИР» и «КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА» (внешнее) устанавливается на персональный компьютер и предназначено для конфигурирования счетчиков и считывания показаний.

Метрологические характеристики счетчиков нормированы с учетом ПО.

## Метрологические и технические характеристики

Счетчики МИР С-04, МИР С-05 удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

Счетчики МИР С-07 удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

Счетчики не имеют самохода после приложения напряжения, равного  $1,15 U_{\text{ном}}$ , и при отсутствии тока в цепях тока.

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Значение                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс точности по активной энергии по ГОСТ 31819.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                             |
| Класс точности по активной энергии по ГОСТ 31819.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2S; 0,5S                                                                                    |
| Класс точности по реактивной энергии по ГОСТ 31819.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                             |
| Класс точности по активной энергии по ГОСТ 8.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2                                                                                           |
| Класс точности по реактивной энергии по ГОСТ 8.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,2; 0,5 <sup>1)</sup>                                                                        |
| Базовый (максимальный) ток, А <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5(80); 5(100)                                                                                 |
| Номинальный (максимальный) ток, А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1(2); 5(10)                                                                                   |
| Номинальное фазное напряжение $U_{\text{ном}}$ , В                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57,7; 230                                                                                     |
| Номинальное значение частоты сети, Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                            |
| Постоянная счетчика в режиме телеметрии, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500; 5000                                                                                     |
| Постоянная счетчика в режиме поверки, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50000; 500000                                                                                 |
| Стартовый ток:<br>- при измерении активной энергии<br><br>- при измерении реактивной энергии                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,004 $I_6$ ; 0,001 $I_6$ ;<br>0,001 $I_{\text{ном}}$<br>0,004 $I_6$ ; 0,002 $I_{\text{ном}}$ |
| Пределы основной относительной погрешности измерения напряжения:<br>- кроме счетчиков класса точности 0,2/0,2, %<br>- для счетчиков класса точности 0,2/0,2, %                                                                                                                                                                                            | $\pm 0,50$<br>$\pm 0,15$                                                                      |
| Пределы основной относительной погрешности измерения тока счетчика класса точности 0,2/0,2:<br>- при токе $0,2 I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$ , %<br>- при токе $0,05 I_6 \leq I < 0,2 I_6$ , %                                                                                                                                                         | $\pm 0,15$<br>$\pm 1,50$                                                                      |
| Пределы основной относительной погрешности измерения тока счетчика (кроме счетчика класса точности 0,2/0,2):<br>- при токе $0,2 I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$ , %<br>- при токе $0,05 I_6 \leq I < 0,2 I_6$ , %<br>- при токе $0,2 I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$ , %<br>- при токе $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,2 I_{\text{ном}}$ , % | $\pm 0,5$<br>$\pm 5,0$<br>$\pm 0,5$<br>$\pm 5,0$                                              |
| Пределы основной погрешности измерения активной и реактивной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствуют пределам основной погрешности измерения активной и реактивной энергии           |
| Пределы основной относительной погрешности измерения полной мощности:<br>- для счетчиков МИР С-07 и счетчиков класса точности 0,2/0,2, %<br>- для счетчиков МИР С-04 и МИР С-05 класса точности 0,5S/1, %<br>- для счетчиков МИР С-04 и МИР С-05 класса точности 1/1, %                                                                                   | $\pm 0,5$<br>$\pm 1,0$<br>$\pm 1,5$                                                           |

Продолжение таблицы 2

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основная абсолютная погрешность измерения <sup>4)</sup> :<br>- коэффициента мощности<br>- положительного и отрицательного отклонения напряжения, %<br>- максимального напряжения при перенапряжении, % от $U_{ном}$<br>- глубины провала напряжения, %<br>- длительности провала напряжения и перенапряжения, с<br>- частоты (кроме счетчиков класса точности 0,2/0,2), Гц<br>- частоты (для счетчиков класса точности 0,2/0,2), Гц<br>- отклонения частоты, Гц<br>- хода часов, с/сут | $\pm 0,05$<br>$\pm 0,5$<br>1<br>1<br>$\pm 0,04$<br>$\pm 0,05$<br>$\pm 0,015$<br>$\pm 0,05$<br>$\pm 0,5$ |
| Диапазоны измерения напряжения от $U_{ном}$ :<br>- для счетчиков с $U_{ном}=230$ В<br>- для счетчиков с $U_{ном}=57,7$ В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | от 0,7 до 1,3<br>от 0,7 до 2,25                                                                         |
| Средний температурный коэффициент хода часов в диапазоне рабочих температур, (с/сут)/°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\pm 0,03$                                                                                              |
| Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры до любого значения в диапазоне рабочих температур:<br>- измерения напряжения, %<br>- измерения тока, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\pm 0,5$<br>равны пределам основной погрешности                                                        |
| Установленный рабочий диапазон напряжений при измерении энергии от $U_{ном}$ , %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\pm 30$                                                                                                |
| Установленный рабочий диапазон температуры <sup>5)</sup> , °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | от -50 до +70                                                                                           |
| Средняя наработка на отказ, с учетом технического обслуживания, ч, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290000                                                                                                  |
| Средний срок службы счетчиков, не менее, лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                      |
| Габаритные размеры счетчиков (длина; высота; ширина), мм, не более:<br>- счетчика МИР С-04 применяемых внутри помещений<br>- счетчика МИР С-04 наружной установки<br>- счетчика МИР С-05 применяемых внутри помещений<br>- счетчика МИР С-05 наружной установки<br>- счетчика МИР С-07                                                                                                                                                                                                 | 168;273;97<br>211;225;111<br>132;198;76<br>190;175;103<br>168;285;63                                    |
| Степень защиты по ГОСТ 14254<br>- для счетчиков применяемых внутри помещений<br>- для счетчиков наружной установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP51<br>IP54, IP64                                                                                      |

Продолжение таблицы 2

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Масса счетчиков, кг, не более:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| – счетчика МИР С-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,9      |
| – счетчика МИР С-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0      |
| – счетчика МИР С-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2      |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 1) Пределы погрешностей измерения реактивной энергии для счетчиков класса 0,5 составляют $\frac{1}{2}$ от пределов погрешностей для счетчиков класса 1 по ГОСТ 31819.23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2) Для счетчика МИР С-04 применяемого внутри помещения, имеющего силовые реле отключения нагрузки, максимально допустимое значение тока 100 А при верхнем значении температуры окружающего воздуха +50 °С. Для счетчика МИР С-04 наружной установки, имеющего силовые реле отключения нагрузки, максимально допустимое значение тока 100 А при верхнем значении температуры окружающего воздуха +55 °С. Для счетчика МИР С-05, применяемого внутри помещения, максимально допустимое значение тока 80 А при верхнем значении температуры окружающего воздуха при эксплуатации счетчика +50 °С и максимально допустимое значение тока 50 А при +70 °С. |          |
| Счетчики МИР С-04 класса точности 0,2/0,2 должны эксплуатироваться в нормальных условиях по ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, при температуре плюс $(23 \pm 3)$ °С и относительной влажности от 30 до 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3) По требованию заказчика возможен выпуск счетчиков с постоянной счетчика в режиме телеметрии в диапазоне от 500 до 10000 имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 4) Погрешности нормируются для следующих значений входных сигналах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| - напряжение – от $0,7U_{ном}$ до $2,25 U_{ном}$ при $U_{ном}=57,7$ В, от $0,7U_{ном}$ до $1,3 U_{ном}$ при $U_{ном}=230$ В;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| - ток – $0,05I_{б} \dots I_{макс}$ или $0,01I_{ном} \dots I_{макс}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| - частота от 42,5 до 57,5 Гц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 5) Интерфейсы функционируют в полном объеме при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до +70 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

Таблица 3 – Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков при измерении активной энергии счетчиков класса точности 0,2

| Характер нагрузки                                                                                        | Значение тока                                 | Коэффициент мощности | Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков, % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| При симметричной нагрузке                                                                                | от 0,05 I <sub>б</sub> до 0,10 I <sub>б</sub> | 1,0                  | ± 0,3                                                 |
|                                                                                                          | от 0,10 I <sub>б</sub> до I <sub>макс</sub>   |                      | ± 0,2                                                 |
|                                                                                                          | от 0,10 I <sub>б</sub> до 0,20 I <sub>б</sub> | 0,5L и 0,8C          | ± 0,4                                                 |
|                                                                                                          | от 0,20 I <sub>б</sub> до I <sub>макс</sub>   |                      | ± 0,3                                                 |
| При однофазной нагрузке и симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения               | от 0,05 I <sub>б</sub> до 0,10 I <sub>б</sub> | 1,0                  | ± 0,3                                                 |
|                                                                                                          | от 0,10 I <sub>б</sub> до I <sub>макс</sub>   |                      | ± 0,2                                                 |
|                                                                                                          | от 0,10 I <sub>б</sub> до 0,20 I <sub>б</sub> | 0,5L и 0,8C          | ± 0,4                                                 |
|                                                                                                          | от 0,20 I <sub>б</sub> до I <sub>макс</sub>   |                      | ± 0,3                                                 |
| Примечание – Здесь и далее по тексту знаком «L» обозначена индуктивная нагрузка, знаком «C» – емкостная. |                                               |                      |                                                       |

Таблица 4 – Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков при измерении реактивной энергии счетчиков класса точности 0,2

| Характер нагрузки                                                                          | Значение тока                      | Коэффициент мощности | Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| При симметричной нагрузке                                                                  | от 0,05 $I_6$ до 0,10 $I_6$        | 1,0L или 1,0C        | $\pm 0,3$                                             |
|                                                                                            | от 0,10 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ |                      | $\pm 0,2$                                             |
|                                                                                            | от 0,10 $I_6$ до 0,20 $I_6$        | 0,5L или 0,5C        | $\pm 0,4$                                             |
|                                                                                            | от 0,20 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ |                      | $\pm 0,3$                                             |
|                                                                                            | от 0,20 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ | 0,25L или 0,25C      | $\pm 0,4$                                             |
| При однофазной нагрузке и симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения | от 0,05 $I_6$ до 0,10 $I_6$        | 1,0L или 1,0C        | $\pm 0,3$                                             |
|                                                                                            | от 0,10 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ |                      | $\pm 0,2$                                             |
|                                                                                            | от 0,10 $I_6$ до 0,20 $I_6$        | 0,5L или 0,5C        | $\pm 0,4$                                             |
|                                                                                            | от 0,20 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ |                      | $\pm 0,3$                                             |
|                                                                                            | от 0,20 $I_6$ до $I_{\text{макс}}$ | 0,25L или 0,25C      | $\pm 0,4$                                             |

Таблица 5 – Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков при измерении реактивной энергии счетчиков класса точности 0,5

| Характер нагрузки                                                                          | Значение тока                                     | Коэффициент мощности | Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| При симметричной нагрузке                                                                  | от 0,02 $I_{\text{ном}}$ до 0,05 $I_{\text{ном}}$ | 1,0                  | $\pm 0,75$                                            |
|                                                                                            | от 0,05 $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$     |                      | $\pm 0,5$                                             |
|                                                                                            | от 0,05 $I_{\text{ном}}$ до 0,10 $I_{\text{ном}}$ | 0,5L или 0,5C        | $\pm 0,75$                                            |
|                                                                                            | от 0,10 $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$     |                      | $\pm 0,5$                                             |
|                                                                                            | от 0,10 $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$     | 0,25L или 0,25C      | $\pm 0,75$                                            |
| При однофазной нагрузке и симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения | от 0,05 $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$     | 1,0                  | $\pm 0,75$                                            |
|                                                                                            | от 0,10 $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$     | 0,5L и 0,5C          | $\pm 0,75$                                            |

Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков МИР С-04 при измерении активной и реактивной энергии при однофазной нагрузке и симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения, не превышают пределов допускаемой основной погрешности счетчиков при симметричной нагрузке.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности счетчиков МИР С-04 и МИР С-05 класса точности 0,5S при измерении активной энергии прямого и обратного направлений, вызванной воздействием постоянной составляющей, четными и нечетными гармониками в цепи переменного тока не превышают  $\pm 2\%$ .

Средний температурный коэффициент и дополнительные погрешности измерения активной энергии не превышают пределов, установленных в ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 для соответствующего класса точности.

Средний температурный коэффициент и дополнительные погрешности измерения реактивной энергии, счетчиков класса точности 1, не превышают пределов, установленных в ГОСТ 31819.23-2012 для класса точности 1.

Средний температурный коэффициент и дополнительные погрешности измерения реактивной энергии, счетчиков класса точности 0,5, не превышают  $\frac{1}{2}$  от пределов, установленных в ГОСТ 31819.23-2012 для класса точности 1.

Счетчики для наружной установки по условиям эксплуатации соответствуют группе исполнения 4 по ГОСТ 22261-94. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70 °С.

Счетчики, применяемые внутри помещений (кроме МИР С-04 класса точности 0,2/0,2), по условиям эксплуатации соответствуют группе исполнения 2 по ГОСТ 22261-94. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70 °С.

Таблица 6 – Мощность потребляемая счетчиками

| Счетчик                                |                                                                      | Значение полной мощности для каждой цепи не более, В·А, при номинальном напряжении |           | Значение активной мощности для каждой цепи, Вт |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|                                        |                                                                      | 57,7/100 В                                                                         | 230/400 В |                                                |
| МИР С-04 классов точности 1/1 и 0,5S/1 | цепи напряжения                                                      | —                                                                                  | 10,0      | 2,0                                            |
|                                        | цепи тока                                                            | —                                                                                  | 0,2       | —                                              |
| МИР С-04 класса точности 0,2/0,2       | цепи напряжения                                                      | —                                                                                  | 0,5       | —                                              |
|                                        | цепи тока                                                            | —                                                                                  | 0,2       | —                                              |
|                                        | цепь питания                                                         | —                                                                                  | 10,0      | —                                              |
| МИР С-05                               | цепь напряжения                                                      | —                                                                                  | 10,0      | 2,0                                            |
|                                        | цепь тока                                                            | —                                                                                  | 0,2       | —                                              |
| МИР С-07                               | цепи напряжения                                                      | 10,0                                                                               | 10,0      | 2,0                                            |
|                                        | цепи тока                                                            | 0,05                                                                               | 0,05      | —                                              |
|                                        | цепь резервного питания постоянного тока напряжением от 10 до 48 В   | —                                                                                  | —         | 6                                              |
|                                        | цепь резервного питания переменного тока напряжением от 120 до 276 В | 10                                                                                 |           | 8                                              |

### Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель счетчиков в виде рельефного изображения при изготовлении и в формуляр типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность счетчика МИР С-04 класса точности 0,2/0,2

| Обозначение                                                                                                                       | Наименование                                                                               | Количество |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| М15.034.00.000-50                                                                                                                 | Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D                              | 1 шт.      |
| М15.034.00.000-50 РЭ                                                                                                              | Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |
| М12.00327-02                                                                                                                      | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА                                                      | 1 шт.      |
| Примечание – Допускается поставка методики поверки и программного обеспечения в один адрес на 8 счетчиков на одном компакт-диске. |                                                                                            |            |

Таблица 8 – Комплектность счетчика МИР С-04 классов точности 1/1 и 0,5S/1

| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование                                                                                | Количество       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M15.034.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Счетчик электрической энергии типа МИР С-04                                                 | 1 шт.            |
| M15.034.90.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Упаковка (транспортная тара)                                                                | 1 шт.            |
| M15.034.00.000 ФО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Счетчик электрической энергии типа МИР С-04. Формуляр                                       | 1 шт.            |
| M15.034.00.000 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Счетчик электрической энергии типа МИР С-04. Руководство по эксплуатации                    | см. примечание 2 |
| M15.034.00.000 ИМ <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Счетчики электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05. Инструкция по монтажу и подключению |                  |
| M12.00327-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА                                                       |                  |
| M12.00327-02 31 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА. Описание применения                                  |                  |
| M12.060.00.000 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дисплей потребителя МИР ДП-01                                                               | 1 шт.            |
| M15.034.08.000 <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Комплект монтажных частей                                                                   | 1 шт.            |
| <sup>1)</sup> Для счетчика наружной установки.<br><sup>2)</sup> Документация и программное обеспечение размещены в сети Интернет на сайте <a href="http://www.mir-omsk.ru">http://www.mir-omsk.ru</a> и поставляются на одном компакт-диске в один адрес на партию счетчиков.<br><sup>3)</sup> Для счетчика наружной установки возможна поставка без дисплея потребителя МИР ДП-01. Для счетчика применяемого внутри помещения дисплей потребителя МИР ДП-01 поставляется по отдельному заказу. Модификация поставляемого дисплея выбирается при заказе. Модификация МИР ДП-01.П поставляется с элементами питания.<br><sup>4)</sup> Поставляется по отдельному заказу. |                                                                                             |                  |

Таблица 9 – Комплектность счетчика МИР С-05

| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование                                                                                | Количество       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M15.035.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Счетчик электрической энергии типа МИР С-05                                                 | 1 шт.            |
| M15.035.00.000 ФО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Счетчик электрической энергии типа МИР С-05. Формуляр                                       | 1 шт.            |
| M15.035.00.000 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Счетчик электрической энергии типа МИР С-05. Руководство по эксплуатации                    | см. примечание 2 |
| M15.034.00.000 ИМ <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Счетчики электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05. Инструкция по монтажу и подключению |                  |
| M12.00327-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА                                                       |                  |
| M12.00327-02 31 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА. Описание применения                                  |                  |
| M12.060.00.000 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дисплей потребителя МИР ДП-01                                                               | 1 шт.            |
| M12.021.09.000-01 <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Комплект монтажных частей                                                                   | 1 шт.            |
| <sup>1)</sup> Для счетчика наружной установки.<br><sup>2)</sup> Документация и программное обеспечение размещены в сети Интернет на сайте <a href="http://www.mir-omsk.ru">http://www.mir-omsk.ru</a> и поставляются на одном компакт-диске в один адрес на партию счетчиков.<br><sup>3)</sup> Для счетчика наружной установки возможна поставка без дисплея потребителя МИР ДП-01. Для счетчика применяемого внутри помещения дисплей потребителя МИР ДП-01 поставляется по отдельному заказу. Модификация поставляемого дисплея выбирается при заказе. Модификация МИР ДП-01.П поставляется с элементами питания.<br><sup>4)</sup> Поставляется по отдельному заказу. |                                                                                             |                  |

Таблица 10 – Комплектность счетчика МИР С-07

| Обозначение                      | Наименование                                                             | Количество       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M15.037.00.000                   | Счетчик электрической энергии типа МИР С-07                              | 1 шт.            |
| M15.037.90.000                   | Упаковка (транспортная тара)                                             | 1 шт.            |
| M15.037.00.000 ФО                | Счетчик электрической энергии типа МИР С-07. Формуляр                    | 1 шт.            |
| M15.037.00.000 РЭ                | Счетчик электрической энергии типа МИР С-07. Руководство по эксплуатации | см. примечание 2 |
| M12.00327-02 <sup>1)</sup>       | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА                                    |                  |
| M12.00327-02 31 01 <sup>1)</sup> | Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА. Описание применения               |                  |
| M07.00190-02 <sup>3)</sup>       | Программа КОНФИГУРАТОР СЧЕТЧИКОВ МИР                                     |                  |

Продолжение таблицы 10

| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование                                                 | Количество |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| M07.00190-02 31 01 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Программа КОНФИГУРАТОР СЧЕТЧИКОВ<br>МИР. Описание применения |            |
| <sup>1)</sup> При наличии символов «D» и «M» в части «Протокол обмена» кода счетчика.<br><sup>2)</sup> Документация и программное обеспечение размещены в сети Интернет на сайте <a href="http://www.mir-omsk.ru">http://www.mir-omsk.ru</a> и поставляются на одном компакт-диске в один адрес на партию счетчиков.<br><sup>3)</sup> При наличии символа «P» в части «Протокол обмена» кода счетчика. |                                                              |            |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации:

- M15.034.00.000 РЭ для счетчиков МИР С-04 класса точности 1/1 и 0,5S/1;
- M15.034.00.000-50 РЭ для счетчиков МИР С-04 класса точности 0,2/0,2;
- M15.035.00.000 РЭ для счетчиков МИР С-05;
- M15.037.00.000 РЭ для счетчиков МИР С-07.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электричества энергии в системах электроснабжения общего назначения;

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;

ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии;

ГОСТ 28906-91 Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель;

ГОСТ IEC 61107-2011 Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными;

ТУ 4228-005-51648151-2015 Счетчики электрической энергии типа МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07. Технические условия.

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»)

ИНН 5528012370

Адрес: 644105, г. Омск, ул. Успешная, д. 51

Телефоны: +7 (3812) 35-47-00, +7 (3812) 35-47-07

Факс: +7 (3812) 35-47-00

Web-сайт: [www.mir-omsk.ru](http://www.mir-omsk.ru)

E-mail: [help@mir-omsk.ru](mailto:help@mir-omsk.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

ИНН 9729315781

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

**УТВЕРЖДЕНО**  
**приказом Федерального агентства**  
**по техническому регулированию**  
**и метрологии**  
**от «06» декабря 2022 г. № 3059**

Регистрационный № 58632-14

Лист № 1  
Всего листов 10

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя**  
**"БАЗИС 2006М"**

**Назначение средства измерений**

Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя "БАЗИС 2006М" (в дальнейшем – БАЗИС 2006М) предназначены для измерений и учета объема спирта, в т.ч. этилового, водно-спиртовых растворов, фармацевтических субстанций спирта этилового, спиртосодержащих жидкостей, в т.ч. коньячных спиртов, виноматериалов, соков спиртованных и др., алкогольной продукции, в т.ч. коньяков, бренди, вин, пива, сидра, пуаре, слабоалкогольные напитки и др., в дальнейшем – измеряемая среда, объемной концентрации, в дальнейшем – крепость, объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды и штучного учета продукции.

**Описание средства измерений**

Принцип действия комплексов основан на измерении объема, температуры и плотности жидких продуктов с использованием массового или электромагнитного расходомеров с последующей обработкой и передачей результатов измерений на устройство отображения.

БАЗИС 2006М может включать в себя:

- до 15 расходомеров массовых Promass и (или) ЭМИС-МАСС 260 и (или) OPTIMASS и (или) один или несколько расходомеров электромагнитных Promag и (или) ЭМИС-МАГ 270 и (или) OPTIFLUX;
- запорную арматуру (клапана, дисковые затворы с электро- и пневмоприводами);
- устройства сбора, обработки и передачи информации (УСПД), выполненное в виде настенного шкафа и имеющее в своем составе:
  - вычислительное устройство на базе процессора семейства x86 с комплектом программного обеспечения и локальным архивом, обеспечивающим хранение более 5 лет;
  - встроенную или вынесенную операторскую панель для управления работой комплекса, а также для отображения измеренных и вычисленных параметров;
  - модем приборной сети (HART-модем);
  - источник бесперебойного питания (ИБП), в т.ч. выполненный в виде выносного модуля;
  - систему вторичного питания для измерительных преобразователей;
  - термометр сопротивления Pt100 с диапазоном измерений от -50 до +150 °C (при применении Promag, ЭМИС-МАГ 270, OPTIFLUX);
  - один или несколько счетчиков бутылок типа УСБ и/или СПМ (при необходимости).

В зависимости от комплектации возможны следующие исполнения комплексов:

1 – в состав комплекса входят расходомеры Promass и (или) ЭМИС-МАСС 260 и (или) OPTIMASS – применяется для измерений и учета объема спирта, в т.ч. этилового, водно-спиртовых растворов, спиртосодержащей, в т.ч. коньячных спиртов, виноматериалов, соков спиртованных и др., алкогольной продукции, в т.ч. коньяков, бренди и др., крепости, объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде и температуры измеряемой среды;

2 – в состав комплекса входят расходомеры Promag и (или) ЭМИС-МАГ 270 и (или) OPTIFLUX и датчики температуры – применяется для измерений и учета объема виноматериалов, соков спиртованных и др., алкогольной продукции, вин, пива и др. и температуры измеряемой среды;

3 – в состав комплекса входят расходомеры Promass и (или) ЭМИС-МАСС 260 и (или) OPTIMASS и (или) расходомеры Promag и (или) ЭМИС-МАГ 270 и (или) OPTIFLUX и датчики температуры – для измерений и учета объема спирта, в т.ч. этилового, водно-спиртовых растворов, спиртосодержащей, в т.ч. коньячных спиртов, виноматериалов, соков спиртованных и др., алкогольной продукции, в т.ч. коньяков, бренди, вин, пиво и др., крепости, объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде и температуры измеряемой среды.

БАЗИС 2006М выполняет следующие функции:

- сбор первичных данных от расходомеров по приборной шине;
- определение общей массы и (или) объёма измеряемой среды;
- при работе с алкогольной и спиртосодержащей продукцией фиксацию с заданным интервалом параметров измеряемой среды в собственном локальном архиве, в том числе:
  - измеренный объем продукта, приведенный к температуре плюс 20 °С;
  - измеренный объем продукта при текущей температуре;
  - крепость измеряемой среды (при применении Promass, ЭМИС-МАСС 260, OPTIMASS);
  - объем безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 °С;
  - учёт готовой продукции в штуках (при использовании счётчика бутылок);
  - температура измеряемой среды;
  - время измерения параметров.
- местную индикацию вышеуказанных параметров на операторской панели и (или) планшетном компьютере;
- сохранение ранее измеренных значений при отключении питания БАЗИС 2006М с отметкой в памяти с момента отключения;
- передачу данных из локального архива по запросу внешних клиентов;
- регистрацию показаний расходомеров;
- регистрацию событий с фиксацией времени;
- передачу данных локального архива по независимому и защищенному (от воздействия со стороны контролируемого предприятия) каналу связи;
- индикацию сбоев в работе и готовности к работе;
- блокировку линий учета клапанами в случаях отключения электропитания комплекса "БАЗИС 2006М" и в режиме "Останов".

Локальный архив комплекса расположен в энергонезависимой памяти, он является первичным источником данных для ЕГАИС, обеспечивая безусловную сохранность своего содержимого безотносительно от текущего состояния комплекса.

Время хранения данных в локальном архиве комплекса составляет не менее 5 лет.

Продолжительность автономной работы УСПД в случае аварийных сбоев в его электропитании, без подключения внешней нагрузки, составляет не менее 20 минут после окончания подачи электропитания при полной зарядке аккумулятора ИБП.

Объём измеряемой среды определяется соотношением значений прошедшей через расходомер измеренной массы измеряемой среды, его плотности и температуры (в случае применения расходомера Promass, ЭМИС-МАСС 260, OPTIMASS, Promag) или прямым измерением объёма (в случае применения расходомера Promag, ЭМИС-МАГ 270, OPTIFLUX).

Плотность измеряемой среды измеряется резонансным методом: определённая частота резонирующих измерительных трубок расходомера соответствует определённой плотности продукта (в случае применения расходомера Promass, ЭМИС-МАСС 260, OPTIMASS).

Температура измеряемой среды измеряется термосопротивлением, встроенным в расходомер (в случае применения расходомера Promass, ЭМИС-МАСС 260, OPTIMASS) или термометром сопротивления типа Pt100 установленным на трубопроводе.

Крепость спирта в процентах по объёму и объём безводного спирта определяются в УСПД комплекса с применением алгоритмов пересчёта, согласно данным зависимости концентрации от температуры и плотности (по ГОСТ 3639-79), измеренных расходомером (при применении Promass, ЭМИС-МАСС 260, OPTIMASS) массы, плотности и температуры измеряемой среды. Для каждой измеряемой среды содержащую спирт и выпускаемой в соответствии с техническими условиями на данную продукцию, применяется алгоритм пересчёта, полученный экспериментальным методом с применением жидкостей с заранее известными характеристиками.

Измеренные и рассчитанные параметры измеряемой среды отображаются на экране операторской панели УСПД, архивируются в локальном архиве УСПД.

Места пломбирования

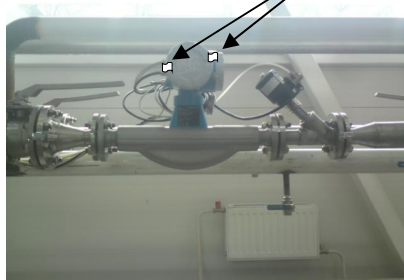


Фото 1  
Расходомер Promass

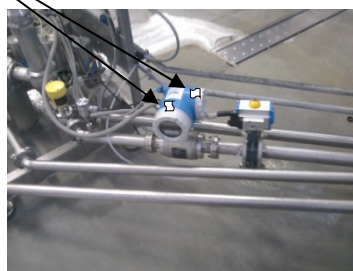


Фото 2.  
Расходомер Promag



Фото 3.  
Расходомер электромагнитный  
ЭМИС-МАГ 270



Фото 4.  
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260



Фото 5.  
Расходомер электромагнитный  
OPTIFLUX



Фото 6.  
Расходомер-счетчик массовый OPTIMASS



Фото 7. Шкаф УСПД  
Место пломбирования

После установки и пуска комплекса в эксплуатацию, пломбируются следующие места и соединения:

- дверца шкафа УСПД;
- крышки корпусов расходомеров;
- крышки корпусов датчиков температуры.

Маркировка наносится на лицевую панель УСПД комплекса методом трафаретной печати.

Нумерация – цифровая.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ООО "Завод Агрохимпродукт"</b>                                             |           |
| Тел.:                                                                         |           |
| Email:                                                                        |           |
| Комплекс измерительный<br>автоматизированного учета<br>алкоголя "БАЗИС 2006М" |           |
| Номер изделия по системе<br>нумерации предприятия<br>изготовителя №           |           |
| Год выпуска 20____                                                            |           |
| 300 Вт                                                                        | 220В~50Гц |

Рисунок 1- Маркировка комплексов измерительных  
автоматизированного учета алкоголя "БАЗИС 2006М"

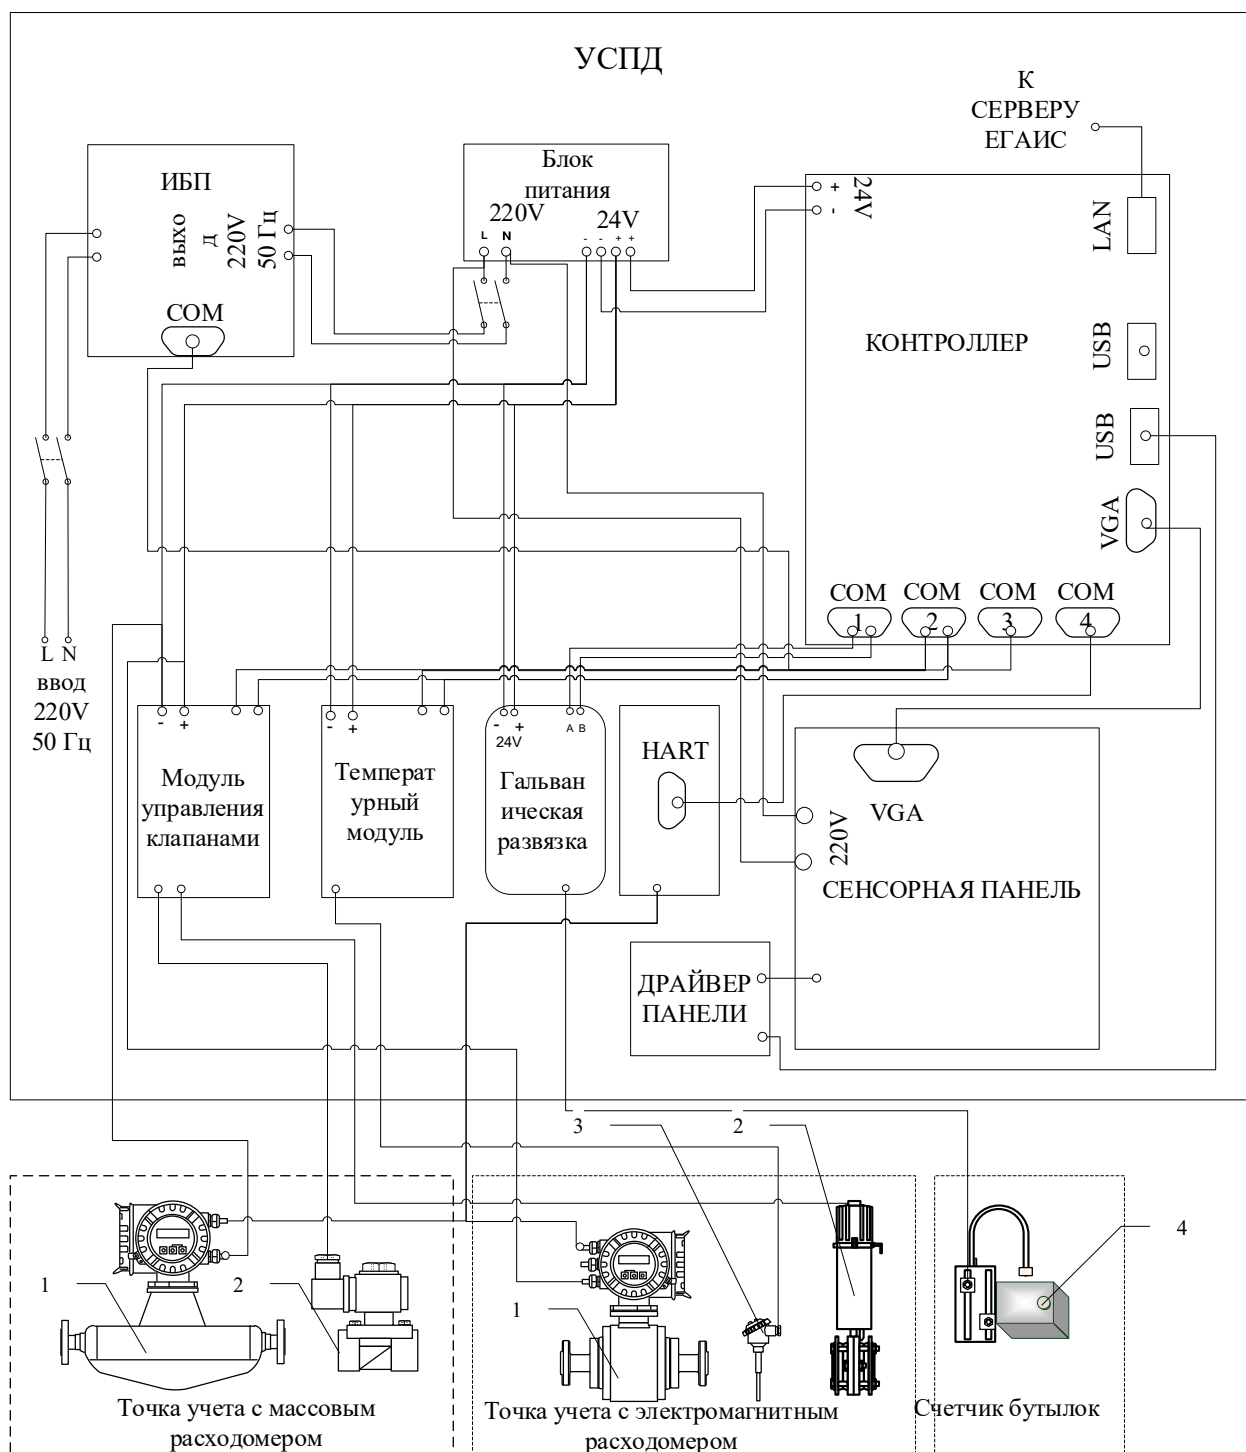


Рисунок 2 – Структурная схема комплекса  
1- расходомер; 2- запорный клапан; 3- термосопротивление; 4- счетчик бутылок

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) комплекса "БАЗИС 2006М" проводит опрос первичных датчиков. На основании полученных данных, ПО проводит фиксацию, архивирование, необходимые расчёты и формирует отчётный файл.

С помощью ПО возможно:

- удаленное управление комплексом с операторской панели, позволяющее производить смену режимов и продуктов;
- дистанционный контроль основных технологических показателей в режиме реального времени: основное окно программы отображает перечень УСПД, приборов измерения, основные технологические параметры выбранного прибора с отображением на временном графике крепости продукта (%) и расхода (кг/ч);
- корректировать справочник продукции и загрузку его в УСПД;
- загрузить в УСПД таблицы плотностей продуктов, необходимых для проведения расчета процентных показателей, приведения показателей крепости к температуре плюс 20 °С;
- представление результатов измерений, накопленных в УСПД, в формате, определенном системой ЕГАИС;
- автоматическая выгрузка данных ЕГАИС;
- программа автоматически ведет технологический отчет, где фиксируются основные действия оператора.

Измеренные и рассчитанные параметры измеряемой среды индицируются на экране операторской панели УСПД, архивируются в локальном архиве УСПД и передаются в ЕГАИС.

ПО защищено от несанкционированного доступа к настройкам при помощи HASP-ключа.

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Идентификационные параметры программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Идентификационные данные (признаки)                                   | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Идентификационное наименование ПО                                     | UspdUser |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО                             | 3.11.1   |
| Цифровой идентификатор ПО                                             | AD165C5B |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения | CRC 32   |

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 - "высокий".

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Технические характеристики

| Тип измерительного канала и преобразователя объема (расхода) | Ду, мм       | Диапазон расходов, м³/ч | Диапазон температур, °С | Рабочее давление, МПа | Госреестр №                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Расходомер массовый Promass                                  | от 8 до 100  | от 0,1 до 320           | от -50 до +60           | 4                     | 15201-05<br>15201-11<br>57484-14<br>68358-17 |
| Счетчик-расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260                    | от 10 до 100 | от 0,005 до 1200        | от -40 до +120          | 4                     | 42953-15                                     |
| Расходомер-счетчик OPTIMASS                                  | от 8 до 100  | от 0,005 до 262,5       | от -40 до +120          | 4                     | 53804-13<br>77658-20<br>78635-20             |
| Расходомер электромагнитный Promag                           | от 8 до 100  | от 0,2 до 250           | от -20 до +60           | 4                     | 14589-09<br>14589-14<br>61467-15<br>67922-17 |
| Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270                     | от 15 до 100 | от 0,06 до 283          | от -20 до +65           | 4                     | 54036-13                                     |
| Расходомер электромагнитный OPTIFLUX                         | от 6 до 100  | от 0,0002 до 339,2      | от -20 до +120          | 4                     | 40075-13<br>70495-18                         |

Таблица 3 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                           | Значение   |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| Исполнения комплекса                                                                                                                                  | 1          | 2    | 3          |
| Диапазон измерений концентрации измеряемой среды, % спирта                                                                                            | от 4 до 99 | -    | от 4 до 99 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта в измеряемой среде в диапазонах с концентрацией этилового спирта, %: |            |      |            |
| - не менее 38 %                                                                                                                                       | ±0,8       | -    | ±0,8       |
| - от 20 до 38 %                                                                                                                                       | ±1,5       | -    | ±1,5       |
| - от 9 до 20 %                                                                                                                                        | ±3,0       | -    | ±3,0       |
| - от 4 до 9 %                                                                                                                                         | ±4,0       | -    | ±4,0       |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности измеряемой среды, кг/дм³                                                               | ±0,001     | -    | ±0,001     |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений концентрации измеряемой среды, %                                                                 | ±0,2       | -    | ±0,2       |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры измеряемой среды, °С                                                                 | ±0,5       | ±0,5 | ±0,5       |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, %                                                                                     | ±0,5       | ±0,5 | ±0,5       |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры измеряемой среды, °С                                                                 | ±0,5       | ±0,5 | ±0,5       |

Таблица 4 – Технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                           | Значение                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Длина соединительных кабелей между УСПД и расходомерами, без применения специализированного оборудования, м, не более | 1200                               |
| Параметры электрического питания:<br>– напряжение переменного тока, В<br>– частота переменного тока, Гц               | 220±22<br>50±1                     |
| Потребляемая мощность в зависимости от исполнения, Вт, не более:<br>от 1 до 8 каналов<br>от 9 до 15 каналов           | 300<br>600                         |
| Температура окружающей среды, °С                                                                                      | от +10 до +35                      |
| Для термометра сопротивления Pt100                                                                                    | По технической документации на них |
| Для запорной арматуры                                                                                                 | По технической документации на них |
| Относительная влажность воздуха, % не более                                                                           | 80                                 |
| Средний срок службы, лет, не менее                                                                                    | 12                                 |

### Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель УСПД комплекса методом трафаретной печати и на титульный лист паспорта - типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 5

| Наименование                                                         | Обозначение                                                      | Количество | Примечание               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя в составе: | “БАЗИС 2006М”                                                    | 1 шт.      | в соответствии с заказом |
| Расходомер                                                           | Promass; ЭМИС-МАСС 260; OPTIMASS; Promag; ЭМИС-МАГ 270; OPTIFLUX | до 15 шт.  | в соответствии с заказом |
| Термометр сопротивления Pt100                                        | ТС                                                               | до 15 шт.  | при применении Promag    |
| Шкаф управления                                                      | УСПД                                                             | 1 шт.      |                          |
| Запорная арматура                                                    | ЗА                                                               | до 15 шт.  | в соответствии с заказом |
| Счетчик бутылок УСБ и/или СПМ                                        | УСБ/СПМ                                                          | до 15 шт.  | в соответствии с заказом |
| Комплект ПО                                                          | UspdUser                                                         | 1 экз.     |                          |
| Руководство по эксплуатации                                          | РЭ                                                               | 1 экз.     |                          |
| Паспорт                                                              | ПС                                                               | 1 экз.     |                          |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п.5 паспорта на комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя “БАЗИС 2006М”.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2466 "О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";

ГОСТ Р 52931-2008 – "Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия";

ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";

ГОСТ 22782.0-81 "Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний";

ТУ 28.93.14-414-93408461-2014 с изменением №2 (ТУ5131-414-93408461-2014) "Комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя "БАЗИС 2006М". Технические условия".

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью "Завод аграрных химических продуктов" (ООО "Завод Агрохимпродукт")

ИНН 6911024127

Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д.1

Тел. +7(495)783-7157;

E-mail: 7837157@mail.ru

**Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГБУ "ВНИИМС")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.