ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-1000	Е	87510-22	24	Акционерное общество "Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" (АО "СЗ КВОиТ"), г. Самара	Акционерное общество "Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" (АО "СЗ КВОиТ"), г. Самара	ОС	ГОСТ 8.570-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "МонтажТехСтрой" (ООО "МонтажТехСтрой"), г. Краснодар	ООО "Метрологический центр", г. Ангарск	28.03.2022
2.	Ключи моментные предельные	CMTN	С	87511-22	CMTN-10 зав. № 6092020021050624, CMTN-200 зав. № 6092060021050764, CMTN-1000 зав. № 6092110021070204, CMTN-2000A зав. № 6092140121050550	Фирма "Aviation Industry Corporation of China, Ltd", Китай	Фирма "Aviation Industry Corporation of China, Ltd", Китай	ОС	МП 1600-28-22	1 год	Общество с ограниченной ответственностью "Силовые Моментные технологии" (ООО "СМТ"), г. Санкт-Петербург	ФБУ "Нижегородский ЦСМ", г. Нижний Новгород	20.06.2022
3.	Глубиномеры микрометрические	Обозначение отсут-	С	87512-22	AX129270; AX129193; AX127401;	GUILIN MEASURING AND CUT-	GUILIN MEASURING AND CUT-	ОС	МП 203-38-2022	1 год	Общество с ограниченной ответственно-	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	16.08.2022

		ствует			AX127431; AX127436; AX1127523	TING TOOL CO., LTD, КНР	TING TOOL CO., LTD, КНР				стью "ЗИТОМ" (ООО "ЗИ-ТОМ"), г. Москва		
4.	Датчики воздушного зазора	AGT-530 3G	C	87513-22	преобразователи зав. № F00543 и № F00544; демодуляторы зав. № F00309 и № F00371 и осцилляторы с кабелем зав. № F00504 и № F00505	MC-monitoring SA, Швейцария	MC-monitoring SA, Швейцария	ОС	МП 204/3-12-2022	2 года	Gostnorm AG, Германия	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	24.06.2022
5.	Трансформаторы напряжения	SVS 123	E	87514-22	3038602, 3038603, 3038604, 3038605, 3038606, 3038607	"Trench Germany GmbH", Германия	"Trench Germany GmbH", Германия	ОС	ГОСТ 8.216-2011	8 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегаз и Энергетика" (ООО "Нефтегаз и Энергетика"), г. Москва	ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва	17.06.2022
6.	Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические	РГС-60	E	87515-22	14, 15, 16, 17	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"), г. Ростов-на-Дону	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"), г. Ростов-на-Дону	ОС	ГОСТ 8.346-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"), г. Ростов-на-Дону	ООО "Метро-КонТ", г. Казань	11.10.2022
7.	Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические	РГС-140	E	87516-22	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"),	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"),	ОС	ГОСТ 8.346-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ростов" (ООО "ЮгБункер-Сервис-Ростов"),	ООО "Метро-КонТ", г. Казань	11.10.2022

						г. Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону				г. Ростов-на-Дону		
8.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	РВС-2000	Е	87517-22	26, 27	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	ОС	ГОСТ 8.570-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	ООО "МетроКонТ", г. Казань	17.10.2022
9.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	РВС-5000	Е	87518-22	1, 3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	ОС	ГОСТ 8.570-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Терминал" (ООО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск	ООО "МетроКонТ", г. Казань	17.10.2022
10.	Трансформаторы напряжения	НКФ-220-58	Е	87519-22	мод. НКФ-220-58 зав. № 956069, 956075, 956100; мод. НКФ-220-58У1 зав. № 1055310, 1068093, 1064987	Московское научно-производственное объединение "Электрозавод" (МНПО "Электрозавод"), г. Москва (изготовлены в 1969 - 1976 гг.)	Московское научно-производственное объединение "Электрозавод" (МНПО "Электрозавод"), г. Москва	ОС	ГОСТ 8.216-2011	4 года	Чебоксарская ТЭЦ-2 Филиала "Марий Эл и Чувашии" Публичного акционерного общества "Т Плюс" (Чебоксарская ТЭЦ-2 Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО Т Плюс"), Московская обл., г.о. Красногорск, территория автодо-	ФБУ "Марийский ЦСМ", г. Йошкар-Ола	16.09.2022

											рога Балтия, км 26-й		
11.	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	Е	87520-22	4	Общество с ограниченной ответственностью "Арктикнефтеспецстрой" (ООО "Арктикнефтеспецстрой"), Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар	Общество с ограниченной ответственностью "Арктикнефтеспецстрой" (ООО "Арктикнефтеспецстрой"), Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар	ОС	РМГ 105-2010	5 лет	Акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добычи нефти и газа "ННК-Печоранефть" (АО "ННК-Печоранефть"), Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар	АО "Нефтеавтоматика", г. Казань	15.06.2022
12.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО "РЖД"	Обозначение отсутствует	Е	87521-22	01-ОКТ-2022	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	ОС	РТ-МП-1086-500-2022	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнерТест" (ООО "ЭнерТест"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	25.10.2022
13.	Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические	РГС	Е	87522-22	мод. РГСН-5: зав. №№ 15, 88; мод. РГСН-10: зав. №№ 74, 139, 140; мод. РГСП-10: зав. №№ 125, 126; мод. РГСН-25: зав. №№	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод резервуарного оборудования"	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод резервуарного оборудования"	ОС	ГОСТ 8.346-2000	5 лет	Федеральное государственное казённое учреждение "Пограничное управление Федеральной	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	12.10.2022

					16, 17; мод. РГСН-50: зав. №№ 72, 73, 78, 232	(ООО "МЗРО"), г. Москва	(ООО "МЗРО"), г. Москва				службы безопасности Российской Федерации по восточному арктическому району" (ПУ ФСБ России по восточному арктическому району), г. Петропавловск-Камчатский		
14.	Источники питания постоянного тока программируемые	IT6000	C	87523-22	80404301177684000 3 (модификация IT6018-800-75 исполнение D), 80404602176764000 5 (модификация IT6018-2250-25 исполнение D), 80444901177694001 7 (модификация IT6015-80-450 исполнение D), 80446102177684000 3 (модификация IT6012-300-150 исполнение D)	ITECH ELECTRONIC CO., LTD, Китай	ITECH ELECTRONIC CO., LTD, Китай	ОС	МП-НИЦЭ-103-22	2 года	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Диполь" (АО "НПФ "Диполь"), г. Санкт-Петербург	ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва	22.09.2022
15.	Источники питания постоянного тока программируемые	IT6500	C	87524-22	80067201177690005 (модификация IT6532 исполнение D), 80064601177691000 4 (модификация IT6517 исполнение D)	ITECH ELECTRONIC CO., LTD, Китай	ITECH ELECTRONIC CO., LTD, Китай	ОС	МП-НИЦЭ-104-22	2 года	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Диполь" (АО "НПФ "Диполь"), г. Санкт-Петербург	ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва	22.09.2022

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87518-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-2000

Назначение средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-2000 (далее – резервуары) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Тип резервуаров – стальные вертикальные цилиндрические, номинальной вместимостью 2000 м^3.

Принцип действия резервуаров основан на заполнении их нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуары представляют собой наземные вертикально расположенные стальные сосуды, состоящие из цилиндрической стенки, днища и крыши.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки, расположенные в нижней части резервуара.

Заводские номера резервуаров в виде цифрового обозначения, состоящие из арабских цифр, нанесены аэрографическим способом на цилиндрическую стенку резервуара.

Резервуары РВС-2000 с заводскими номерами 26, 27 расположены по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вагонная, д. 14, Красноуфимская нефтебаза ООО «Газпромнефть-Терминал».

Общий вид резервуаров РВС-2000 с указанием мест нанесения заводских номеров приведены на рисунках 1, 2.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Место нанесения заводского номера

Рисунок 1 – Общий вид резервуара РВС-2000 №26 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 2 – Общий вид резервуара РВС-2000 №27 с указанием места нанесения заводского номера

Пломбирование резервуаров РВС-2000 не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, $м^3$	2000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (геометрический метод), %	±0,20

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ºС	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3- Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 8 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал» (ООО «Газпромнефть-Терминал»)
ИНН 5406807595
Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, помещ. 13
Телефон: +7 (812) 679-56-00
Web-сайт: www.gazprom-neft.ru
E-mail: terminal@gazprom-neft.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал» (ООО «Газпромнефть-Терминал»)
ИНН 5406807595
Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, помещ. 13
Телефон: +7 (812) 679-56-00
Web-сайт: www.gazprom-neft.ru
E-mail: terminal@gazprom-neft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ» (ООО «МетроКонТ»)
Адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, офис 51
Телефон: +7 9372834420
Факс +7 (843) 515-00-21
E-mail: trifonovua@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312640.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87519-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения НКФ-220-58

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения НКФ-220-58 (далее по тексту – трансформаторы напряжения) предназначены для применения в электрических цепях переменного тока промышленной частоты с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.

Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов напряжения НКФ-220-58 (далее – трансформаторы напряжения) основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока.

Трансформаторы напряжения выполнены в виде двух блоков: верхнего и нижнего, установленных друг на друга и электрически связанных. Каждый блок состоит из активной части, помещенной в изоляционную покрышку, залитую трансформаторным маслом и установленную на основание.

Активная часть представляет собой магнитопровод выполненный из электротехнической стали, с насаженными на его стержни обмотками. Обмотки трансформаторов напряжения подразделяются на обмотку ВН (первичную), обмотки НН (вторичные: основную и дополнительную), обмотки выравнивающие и связующие. Выравнивающие и связующие обмотки служат для снижения магнитного рассеяния и осуществления электромагнитной связи между магнитопроводами верхнего и нижнего блоков трансформаторов напряжения. Линейный ввод А первичной обмотки находится в верхней части трансформаторов напряжения, а заземляемый ввод Х, и вводы вторичных обмоток а; х; $а_д$; $х_д$ расположены на основании трансформаторов напряжения.

К трансформаторам напряжения данного типа относятся трансформаторы напряжения модификации НКФ-220-58 зав. № 956069, 956075, 956100 и модификация НКФ-220-58У1 зав. № 1055310, 1068093, 1064987.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, нанесен на маркировочной табличке в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, ударным способом.

Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки, места нанесения заводского номера приведен на рисунке 1.

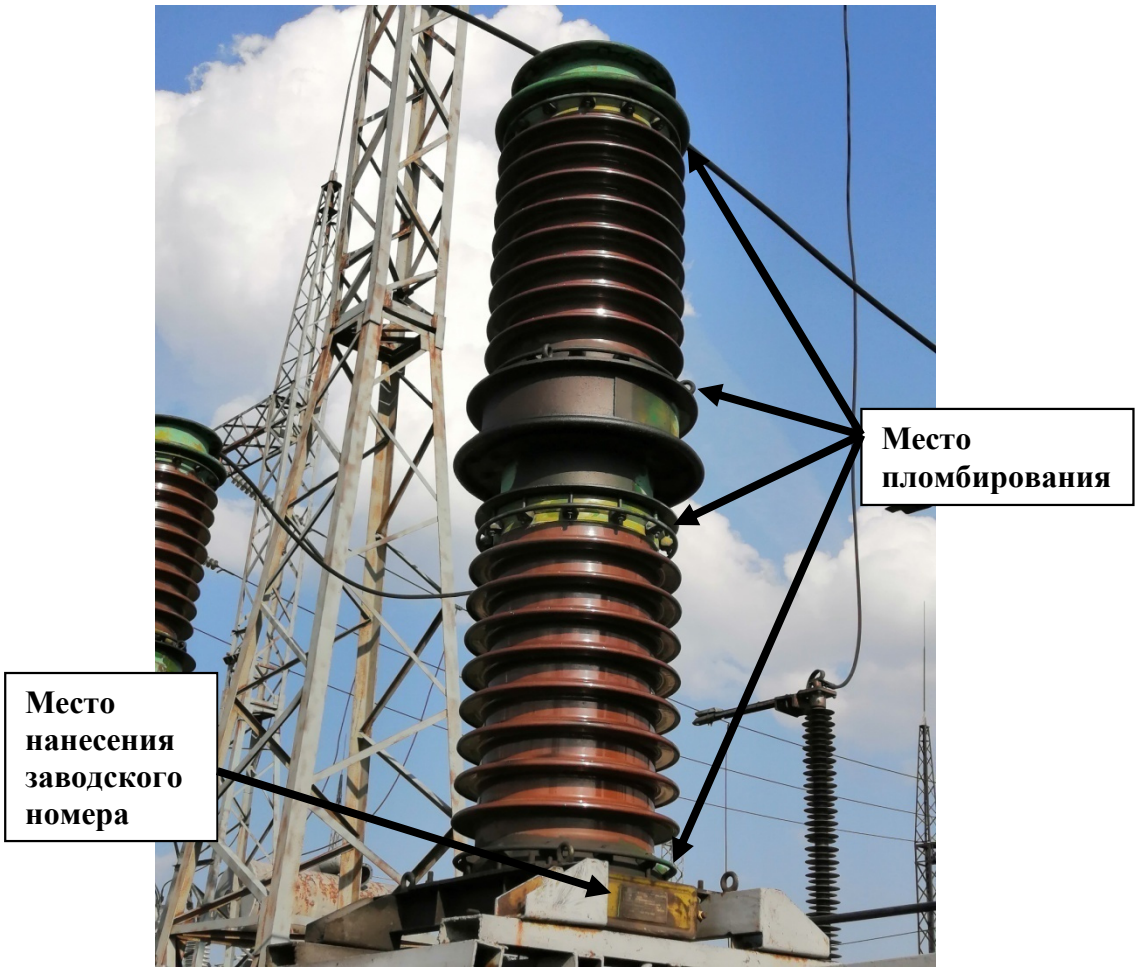

Рисунок 1. Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки, места нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное напряжение первичной обмотки $U_{1ном}$, кВ	220/√3
Номинальное напряжение вторичной обмотки $U_{2ном}$, В	100/√3
Номинальная частота $f_{ном}$, Гц	50
Класс точности основной вторичной обмотки по ГОСТ 1983	0,5
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А	400

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С	от -45 до +40

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта трансформатора напряжения типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на трансформаторы напряжения не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	6 шт.
Паспорт	НКФ-220-58	6 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе «Общие сведения» паспорта трансформатора напряжения.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3453 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/√3 до 750/√3 кВ и средств измерений электрической емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ».

Правообладатель

Московское научно-производственное объединение «Электрозавод»
(МНПО «Электрозавод»)
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Изготовитель

Московское научно-производственное объединение «Электрозавод»
(МНПО «Электрозавод») (изготовлены в 1969 – 1976 гг.)
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл» (ФБУ «Марийский ЦСМ»)
Адрес: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3
Телефон (факс): (8362) 41-20-18, (41-16-94)
Web-сайт: www.maricsm.ru
E-mail: metr@maricsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30118-11.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87520-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-2000

Назначение средства измерений

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-2000 (далее - резервуар) предназначен для измерений объема нефти, а также для ее приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Принцип действия резервуара основан на заполнении его нефтью до определенного уровня, соответствующего объему продукта согласно градуировочной таблице резервуара.

Тип резервуара - стальной вертикальный цилиндрический теплоизолированный, с номинальной вместимостью 2000 м^3.

Резервуар представляет собой металлический сосуд в форме вертикального цилиндра с теплоизоляцией крыши и стенки, с плоским днищем и стационарной кровлей, оборудованный приемо-раздаточными устройствами и люками.

Заполнение и выдача нефти осуществляется через приемно-раздаточные устройства, расположенные в нижней части резервуара.

Резервуар имеет заводской номер 4. Заводской номер типографическим методом нанесен на информационную табличку, расположенную на периметральном ограждении резервуара и типографским способом в паспорт.

Резервуар расположен на территории УПН «Средняя Харьяга» АО «ННК-Печоранефть».

Общий вид резервуара представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид резервуара

Рисунок 2 –Замерной люк резервуара

Пломбирование резервуара не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на резервуар не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке резервуара и в градуировочной таблице на листах в местах подписи поверителя.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, $м^3$	2000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости, %	±0,25

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более - высота стенки - внутренний диаметр	 12000 15200
Рабочая среда	нефть по ГОСТ Р 51858-2002
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С	 от -50 до +40

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование и условные обозначения	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-2000, зав. № 4	-	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 5 «Методика измерений» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Арктикнефтеспецстрой» (ООО «Арктикнефтеспецстрой»)
ИНН 8300005276
Адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 41-А
Телефон: +7 (82144) 235-43
E-mail: severcom@mail.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Арктикнефтеспецстрой» (ООО «Арктикнефтеспецстрой»)
ИНН 8300005276
Адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 41-А
Телефон: +7 (82144) 235-43
E-mail: severcom@mail.ru

Испытательный центр

Акционерное общество «Нефтеавтоматика» (АО «Нефтеавтоматика»)
Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 2а
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311366.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87521-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU-327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов между основным сервером ИВК и ССВ-1Г осуществляется посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ±1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация NTP-сервера осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ±1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК, в том числе посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ±2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-ОКТ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК						Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК
		Вид СИ	Тип, модификация СИ		Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД основной (тип, рег. №) УСПД резервный (тип, рег. №)	УССВ основной (тип, рег. №) УССВ резервный (тип, рег. №)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	ЭЧЭ-1 Останкино, Ввод-1-110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТН	B	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТН	C	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТТ	A	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		
		ТТ	B	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		
		ТТ	C	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		
2	ЭЧЭ-1 Останкино, Ввод-2-110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТН	B	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТН	C	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13		
		ТТ	A	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		
		ТТ	B	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		
		ТТ	C	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	ЭЧЭ-1 Останкино, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
4	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
5	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
6	ЭЧЭ-1 Останкино, ф.1 ТП пост ЭЦ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ-1	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01		
8	ЭЧЭ-1 Останкино, ф. ПП	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
9	ЭЧЭ-1 Останкино, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
10	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	800/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
11	ЭЧЭ-1 Останкино, ф.2 ТП пост ЭЦ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
12	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
13	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-01		
14	ЭЧЭ-1 Останкино, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	B	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	C	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5	15173-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
15	ЭЧЭ-1 Останкино, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	B	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	C	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
16	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -241 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
17	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -243 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
18	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -316 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
19	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
20	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-3	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
21	ЭЧЭ-15 Крюково, ф.ТСЗ-2500-10/6	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
22	ЭЧЭ-15 Крюково, ПЭ-1	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
23	ЭЧЭ-15 Крюково, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-60	0,5S	1000/5	28139-12		
		ТТ	B	ТТИ-60	0,5S	1000/5	28139-12		
		ТТ	C	ТТИ-60	0,5S	1000/5	28139-12		
24	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
25	ЭЧЭ-15 Крюково, ф. ШУЭС	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
26	ЭЧЭ-15 Крюково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-60	0,5	1000/5	28139-12		
		ТТ	B	ТТИ-60	0,5	1000/5	28139-12		
		ТТ	C	ТТИ-60	0,5	1000/5	28139-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
27	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082γ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
28	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082δ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
29	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082β	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
30	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082α	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
31	ЭЧЭ-16 Ховрино, ТСН-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
32	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат № 1 (ПВА-1)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
33	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат №3 (ПВА-3-1)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
34	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 7 ст. Ховрино АСОКУПЭ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
35	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 5 "ТП 5"	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
36	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 1 ТМ-1000 10/6 кВ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
37	ЭЧЭ-16 Ховрино, ПЭ-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
38	ЭЧЭ-16 Ховрино, ТСН-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
39	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат № 2 (ПВА-2)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
40	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат № 3 (ПВА-3-2)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-11		
41	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 4 "ТП 4"	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
42	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 3 ст. Химки АСОКУПЭ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
43	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 6 "ТП 5"	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
44	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 2 резерв	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
45	ЭЧЭ-16 Ховрино, ПЭ-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
46	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. АБ № 1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	B	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	C	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
47	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. АБ № 2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	47583-11		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		
48	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-4 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
49	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-8 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
50	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-11 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
51	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-18 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
52	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-22 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
53	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-25 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
54	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПВА-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
55	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	32139-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	32139-11		
56	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ПП	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
57	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПВА-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
58	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
59	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	22656-02		
60	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ст.Подсолнечная (нечётная сторона)	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШ-0,66	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТШ-0,66	0,5S	600/5	22657-02		
61	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Аптека	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	B	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	C	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		
62	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Солнечногорская управляющая компания	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	B	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	C	ТТИ-40	0,5	300/5	28139-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
63	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ООО Станция	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-30	0,5	100/5	28139-04		
		ТТ	B	ТТИ-30	0,5	100/5	28139-04		
		ТТ	C	ТТИ-30	0,5	100/5	28139-04		
64	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШ-0,66 У3	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	B	ТШ-0,66 У3	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	C	ТШ-0,66 У3	0,5S	600/5	22657-02		
65	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Турникеты	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	22656-02		
66	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
67	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. к.сеть	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
68	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. СЦБ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26820-04		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26820-04		
69	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. СЦБ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04		
70	ЭЧЭ-4 Клин, ВВОД-15 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		
		ТТ	B	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
71	ЭЧЭ-4 Клин, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
72	ЭЧЭ-4 Клин, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
73	ЭЧЭ-4 Клин, ф. 3 Станция	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
74	ЭЧЭ-4 Клин, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
75	ЭЧЭ-4 Клин, ВВОД-17 6 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		
		ТТ	B	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02		
76	ЭЧЭ-4 Клин, ПВА-2	Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
77	ЭЧЭ-4 Клин, ПЭ-2	Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
78	ЭЧЭ-4 Клин, ф. 4 Станция	Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
79	ЭЧЭ-4 Клин, ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
80	ЭЧЭ-4 Клин, ф. ТК Клинский	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-08		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-08		
81	ЭЧЭ-4 Клин, ф. СЦБ-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	200/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	200/5	26820-05		
82	ЭЧЭ-4 Клин, ф. СЦБ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	400/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	400/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
83	ЭЧЭ-4 Клин, ф. Казарма	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5	75/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5	75/5	26820-05		
84	ЭЧЭ-4 Клин, ф. Гаражи	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	100/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	100/5	26820-05		
85	ЭЧЭ-4 Клин, ф. Склад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5	200/5	28649-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТТИ-А УХЛ3	0,5	200/5	28139-07		
86	ЭЧЭ-4 Клин, ф. Дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5	75/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5	75/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
87	ЭЧЭ-4 Клин, ф. Перекачка	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	75/5	26820-05		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	75/5	26820-05		
88	ЭЧЭ-7 Решетниково, Ввод Решетниково-Алфёрово-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
89	ЭЧЭ-7 Решетниково, Ввод Решетниково-Алфёрово-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
90	ЭЧЭ-7 Решетниково, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
91	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ	B	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ	C	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
92	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. Станция	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
93	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
94	ЭЧЭ-7 Решетниково, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
95	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ	B	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ	C	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
96	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. ОПМС-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
97	ЭЧЭ-7 Решетниково, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШ-0,66 У3	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
98	ЭЧЭ-7 Решетниково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
99	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
100	ЭЧЭ-9 Мичурино, ВЛ-1-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	B	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	C	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТТ	A	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	B	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	C	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
101	ЭЧЭ-9 Мичурино, ВЛ-2-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	B	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	C	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТТ	A	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	B	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	C	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
102	ЭЧЭ-9 Мичурино, Т-1-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
103	ЭЧЭ-9 Мичурино, ТСН-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
104	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
105	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-3-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
106	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-1 (на Ховрино)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
107	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-3 (на Ховрино)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
108	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 1 РУ-6	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
109	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 3 Резерв	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
110	ЭЧЭ-9 Мичурино, Т-2-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
111	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
112	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-3-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	51679-12		
113	ЭЧЭ-9 Мичурино, ТСН-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	51679-12		
114	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-2 (на Крюково)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
115	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 2 РУ-6	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
116	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф.4 Резерв	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
117	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ВВ-1-10	ТТ	A	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
118	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ВВ-2-10	ТТ	A	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
119	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
120	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-3	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
121	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
122	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
123	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.3-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
124	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.5-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
125	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
126	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
127	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.2-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
128	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.4-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
129	ЭЧЭ-1 Сортировочная, АБ-1-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
130	ЭЧЭ-1 Сортировочная, АБ-3	ТТ	А	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19		
		ТТ	В	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19		
		ТТ	С	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
131	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
132	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
133	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
134	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
135	ЭЧЭ-2 Поповка, Ввод-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
136	ЭЧЭ-2 Поповка, Ввод-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
137	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
138	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
139	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 3-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
140	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 4-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
141	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 5-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
142	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 6-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
143	ЭЧЭ-2 Поповка, ф. 9-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
144	ЭЧЭ-2 Поповка, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
145	ЭЧЭ-2 Поповка, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
146	ЭЧЭ-2 Поповка, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
147	ЭЧЭ-2 Поповка, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
148	ЭЧЭ-2 Поповка, ПЭ-3	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
149	ЭЧЭ-2 Поповка, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
150	ЭЧЭ-2 Поповка, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
151	ЭЧЭ-2 Поповка, АБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
152	ЭЧЭ-35 Металлострой, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
153	ЭЧЭ-35 Металлострой, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
154	ЭЧЭ-35 Металлострой, ПВА-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
155	ЭЧЭ-35 Металлострой, ПВА-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
156	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.1ПЭ	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
157	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.2ПЭ	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
158	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
159	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
160	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.3	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
161	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.4	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
162	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.5	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
163	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.6	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
164	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.7	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RALXQ-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
165	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.9-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALX-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
166	ЭЧЭ-35 Металлострой, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
167	ЭЧЭ-35 Металлострой, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
168	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф. АБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
169	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 101\102 (ВВ 511/1511)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
170	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 105\106 (ВВ 503/1503)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
171	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 121\122\147 (ВВ 414/1414)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
172	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
173	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
174	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-3	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
175	ЭЧЭ-501 Ланская, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
176	ЭЧЭ-501 Ланская, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
177	ЭЧЭ-501 Ланская, ПЧ-14	ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
178	ЭЧЭ-501 Ланская, ВМА	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
179	ЭЧЭ-501 Ланская, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	200/5	1407-60	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
180	ЭЧЭ-502 Дюны, ВВОД-1-35	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
181	ЭЧЭ-502 Дюны, ВВОД-2-35	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
182	ЭЧЭ-502 Дюны, ПВА-1	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
183	ЭЧЭ-502 Дюны, ПВА-2	ТТ	A	ТРО 7		0,2S	300/5	25431-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	ТРО 7		0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	C	ТРО 7		0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик	EA05RL-B-4			0,5S	1	16666-97		
184	ЭЧЭ-502 Дюны, РТ-1-35	ТТ	A	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	B	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	C	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик	EA05RL-B-4			0,5S	1	16666-97		
185	ЭЧЭ-502 Дюны, РТ-2-35	ТТ	A	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	B	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	C	ТРО 7		0,2S	20/5	25431-03		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик	EA05RL-B-4			0,5S	1	16666-97		
186	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-1	ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10 У2		0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	B	-						
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10 У2		0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-10 У2		0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	B	ЗНОЛП-10 У2		0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	C	ЗНОЛП-10 У2		0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
187	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
188	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-3	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
189	ЭЧЭ-502 Дюны, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
190	ЭЧЭ-502 Дюны, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
191	ЭЧЭ-502 Дюны, СЦБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
192	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-1-35	ТТ	А	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
193	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-2-35	ТТ	А	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
194	ЭЧЭ-505 Ушково, ПВА-1	ТТ	А	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
195	ЭЧЭ-505 Ушково, ПВА-2	ТТ	А	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
196	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-1-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
197	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
198	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10 У2	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У2	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
199	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
200	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-3	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	30/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	30/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
201	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.2 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	150/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	150/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
202	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.4 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
203	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.6 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	300/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	300/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
204	ЭЧЭ-505 Ушково, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
205	ЭЧЭ-505 Ушково, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
206	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.Дом	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	22656-02		
				-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
207	ЭЧЭ-505 Ушково, АБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
208	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.водокачка	ТТ	А	ТК-20	0,5	50/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	50/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	50/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
209	ЭЧЭ-507 Лисий нос, Отп. Л-Приморская-3	ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
210	ЭЧЭ-507 Лисий нос, ПВА	ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
211	ЭЧЭ-507 Лисий нос, ТСН	ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
212	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
213	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
214	ЭЧЭ-515 Парголово, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
215	ЭЧЭ-515 Парголово, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
216	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-1	ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
217	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
218	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-3	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
219	ЭЧЭ-515 Парголово, ф.7	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
220	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
221	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
222	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.103-10 Профсервис	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
223	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.102-10 ООО П1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
224	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.203-10 Профсервис	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
225	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.202-10 ООО П1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
226	ЭЧЭ-515 Парголово, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
227	ЭЧЭ-515 Парголово, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
228	ЭЧЭ-515 Парголово, СЦБ	ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
229	ЭЧЭ-515 Парголово, Т-2-220	ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
230	ЭЧЭ-515 Парголово, Л-220	ТТ	А	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
231	ЭЧЭ-515 Парголово, Л-221	ТТ	А	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ-220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
232	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, Ввод 18-03/27	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
233	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, Ф. ШУЭС	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-GS-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
234	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
235	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, Ф. Инвест-Капитал	ТТ	А	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14		
		ТТ	С	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
236	ЭЧЭ-2 Лигово, ПВ1-35	ТТ	А	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТТ	В	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТТ	С	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
237	ЭЧЭ-2 Лигово, ПВ2-35	ТТ	А	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТТ	В	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТТ	С	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
238	ЭЧЭ-2 Лигово, СЦБ-1,2	ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
239	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, ВЛ Ломоносовская-1 (ВВ-1-35)	ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
240	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, Ф.1ПЭ	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
241	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, ТСН-1	ТТ	А	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	В	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	С	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
242	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, Ф. Станция	ТТ	А	О-49	0,5	50/5	617-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	О-49	0,5	50/5	617-50		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
243	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ПВ1	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	A	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	B	-					
		ТН	C	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
244	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ПВ2	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	A	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	B	-					
		ТН	C	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
245	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф1 ПЭ-10	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
246	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ТСН-1	ТТ	A	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
247	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф 20-112	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	-					
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
248	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф 20-12-6	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	-					
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
249	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Т1-110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
250	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТР-2	ТТ	А	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
251	ЭЧЭ-8 Шоссейная, СВ-6	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
252	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. Компрессорная	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
253	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. ЖК Триумф	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
254	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. с/х-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
255	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ПЭ-1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
256	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Ф Спортмастер-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
257	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
258	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
259	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Малахит ТР-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
260	ЭЧЭ-11 Паровозный музей, ТСН	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
261	ЭЧЭ-20 Броневая, Ввод Т2 110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,5S	100/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,5S	100/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,5S	100/5	61432-15		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
262	ЭЧЭ-20 Броневая, ПВА1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
263	ЭЧЭ-20 Броневая, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
264	ЭЧЭ-20 Броневая, ПЭ-3	ТТ	А	TPU 40.21	0,5S	75/5	45424-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	TPU 40.21	0,5S	75/5	45424-10		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
265	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ПВА-1	ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
266	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ПВА-2	ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
267	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ВВ1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
268	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ВВ2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
269	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Ф1 ПЭ Ручьи	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
270	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Ф3 ПЭ Кушелевка	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
271	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Ф2 ПЭ Полюстрово	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
272	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
273	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
274	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
275	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Л. Девяткинская-2	ТТ	А	ТОЛ-35 III	0,2S	600/5	34016-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-35 III	0,2S	600/5	34016-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35 III	0,2S	600/5	34016-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
276	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Т-1	ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	В	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
277	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Т-2	ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	В	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
278	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ф.1-10кВ Банк-ф1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
279	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ф.3-10кВ Луябетон	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	50/5	15128-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	50/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	50/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
280	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ф.2-10кВ Банк-ф2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
281	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ф.4-10кВ резерв	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
282	ЭЧЭ-508 Васкелово, ТСН	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
283	ЭЧЭ-9 Понтонная, ВВ1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
284	ЭЧЭ-9 Понтонная, ВВ2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
285	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф-ФК-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
286	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф1ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
287	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		ЕА05L-В-3	0,5S	1	16666-97		
288	ЭЧЭ-9 Понтонная, ПВА -1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		ЕА05L-В-3	0,5S	1	16666-97		
289	ЭЧЭ-9 Понтонная, ПВА -2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		ЕА05L-В-3	0,5S	1	16666-97		
290	ЭЧЭ-9 Понтонная, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
291	ЭЧЭ-9 Понтонная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
292	ЭЧЭ-9 Понтонная, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99		
293	ЭЧЭ-9 Понтонная, Т-1-110	ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
294	ЭЧЭ-9 Понтонная, Т-2-110	ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
295	ЭЧЭ-22 Колтуши, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
296	ЭЧЭ-22 Колтуши, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
297	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПВ-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
298	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПВ-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
299	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
300	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
301	ЭЧЭ-22 Колтуши, АБ	ТТ	А	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	В	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	С	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
302	ЭЧЭ-22 Колтуши, ТСН-1	ТТ	А	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	В	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	С	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLXQ-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5	6	7	8	9
303	ЭЧЭ-22 Колтуши, ТСН-2	ТТ	A	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	C	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
304	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Т1 110 кВ	ТТ	A	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
305	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Т2 110 кВ	ТТ	A	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
306	ЭЧЭ-23 Заневский пост, СВ 110 кВ	ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
307	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Рем. пер. 110	ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
308	ЭЧЭ-23 Заневский пост, АБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
309	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
310	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
311	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ВВ-3-10 (старое наз. ВВ-1-10)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
312	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ВВ-4-10 (старое наз. ВВ-2-10)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
313	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ввод-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
314	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ввод-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
315	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
316	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
317	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
318	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
319	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-3	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
320	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-4	ТТ	A	TPU 40.41	0,5S	30/5	17085-98	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	TPU 40.41	0,5S	30/5	17085-98		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
321	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.9-10	ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
322	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.6-10	ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
323	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.7-10	ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
324	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.8-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
325	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф. ДПРКС-10	ТТ	А	TPU 40.41	0,5S	30/5	17085-98		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	TPU 40.41	0,5S	30/5	17085-98		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
326	ЭЧЭ-23 Заневский пост, яч.21(резерв)	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
327	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-1-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
328	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-2-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
329	ЭЧЭ-25 Ульяновка, Т-1-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
330	ЭЧЭ-25 Ульяновка, Т-2-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
331	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
332	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
333	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
334	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
335	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-3-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
336	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-3-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
337	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ТСН-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
338	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ТСН-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
339	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф. 1-10 ЛОЭСК (яч.5)	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
340	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.2-10 ЛОЭСК (яч.14)	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
341	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.1 ЛЭП АБ-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
342	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.2 ЛЭП АБ-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
343	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПЭ-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
344	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПЭ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
345	ЭЧЭ-34 Новолисино, КВЛ 110 кВ Гатчина-тяговая - Новолисино-тяговая (быв. Форносовская-6)	ТТ	А	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
346	ЭЧЭ-34 Новолисино, КВЛ 110 кВ Форносовская-7	ТТ	А	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
347	ЭЧЭ-34 Новолисино, Т-1-110	ТТ	А	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
348	ЭЧЭ-34 Новолисино, Т-2-110	ТТ	A	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
349	ЭЧЭ-34 Новолисино, В-1-10	ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
350	ЭЧЭ-34 Новолисино, В-2-10	ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
351	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПВА-1	ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТН	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
352	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
353	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
354	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
355	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-3	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
356	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-4	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
357	ЭЧЭ-34 Новолисино, ТСН-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
358	ЭЧЭ-34 Новолисино, ТСН-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
359	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
360	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
361	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.3-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
362	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.4-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
363	ЭЧЭ-3 Тосно, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
364	ЭЧЭ-3 Тосно, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
365	ЭЧЭ-3 Тосно, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
366	ЭЧЭ-3 Тосно, ТСН-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
367	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф-483-02 (Ф.1)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
368	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф-483-03 (Ф.3)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
369	ЭЧЭ-3 Тосно, ф. АБ 1,2	ТТ	А	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
370	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф. АБ 3	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
371	ЭЧЭ-3 Тосно, ф. ЭЧК	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
372	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД ГРК-3-35	ТТ	А	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
373	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД ГРК-4-35	ТТ	А	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	400/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
374	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПВА-1	ТТ	А	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
375	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПВА-2	ТТ	А	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-II УХЛ1	0,5S	300/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
376	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД-1- 10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
377	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
378	ЭЧЭ-512 Каннельярви, Ф.ПОСЕЛОК	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
379	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПЭ-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
380	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
381	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
382	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
383	ЭЧЭ-512 Каннельярви, СЦБ	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
384	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, л.Рощино-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
385	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, л.Рощино-4	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
386	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
387	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
388	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ВВОД-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
389	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ВВОД-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
390	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, Ф.404-02	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
391	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, Ф.404-03	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
392	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
393	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
394	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, СЦБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
395	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ф.насосная	ТТ	А	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07		
		ТТ	В	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07		
		ТТ	С	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
396	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ВВ-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RLXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
397	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ВВ-2-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	В	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	С	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		Счетчик	A1802RLXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
398	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ф ГВР-4 35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	В	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	С	4MU4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		Счетчик	A1802RLXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
399	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ф лГК 35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
400	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
401	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
402	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
403	ЭЧЭ-513 Лейпясуо, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
404	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
405	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
406	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
407	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.3	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
408	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.5	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
409	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.8	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
410	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.417-01	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
411	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.417-04	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
412	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.416-06	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
413	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
414	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
415	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
416	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
417	ЭЧЭ-521 Лужайка, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
418	ЭЧЭ-521 Лужайка, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
419	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-1-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
420	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
421	ЭЧЭ-521 Лужайка, СЦБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
422	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.ЭЧК-11	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
423	ЭЧЭ-7 Вырица, ЛВЦ-3-35	ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
424	ЭЧЭ-7 Вырица, Ввод-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
425	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф1-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
426	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф2-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
427	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф8-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
428	ЭЧЭ-7 Вырица, ТСН-2	ТТ	А	ТК-40	0,5	600/5	1407-60	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
429	ЭЧЭ-9 Верево, Ф3-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
430	ЭЧЭ-9 Верево, Ф7-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
431	ЭЧЭ-9 Верево, Ф11-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
432	ЭЧЭ-9 Верево, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
433	ЭЧЭ-9 Верево, СВ2-3-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
434	ЭЧЭ-9 Верево, РРП-110	ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
435	ЭЧЭ-9 Верево, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
436	ЭЧЭ-9 Верево, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
437	ЭЧЭ-10 Суйда, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
438	ЭЧЭ-10 Суйда, Ф1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
439	ЭЧЭ-10 Суйда, Ф2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
440	ЭЧЭ-10 Суйда, ПВ2-10	ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
441	ЭЧЭ-10 Суйда, ЩТН	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
442	ЭЧЭ-10 Суйда, ВЛ Гатчинская 8	ТТ	А	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
443	ЭЧЭ-10 Суйда, Рабочая перемычка 110 кВ (СВ-110)	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
444	ЭЧЭ-12 Строганово, ВВ-10	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
445	ЭЧЭ-12 Строганово, ф.с.х. 5	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
446	ЭЧЭ-12 Строганово, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
447	ЭЧЭ-13 Низовская, линия Лужская-6 к ПС-262 «Красный маяк	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
448	ЭЧЭ-13 Низовская, линия Низовская-1 к ПС-48 «Луга»	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	600/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
449	ЭЧЭ-13 Низовская, Ввод-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
450	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.ПЭ1	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
451	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.3	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
452	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.4	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
453	ЭЧЭ-13 Низовская, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
454	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-1	ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	В	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	А	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	В	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
455	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-2	ТТ	A	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	C	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
456	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-3	ТТ	A	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	B	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	C	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	A	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	B	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
457	ЭЧЭ-503 Пери, ПВА-1	ТТ	A	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	A	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	B	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
458	ЭЧЭ-503 Пери, ПВА-2	ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
459	ЭЧЭ-503 Пери, ТР-35	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
460	ЭЧЭ-503 Пери, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
461	ЭЧЭ-503 Пери, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
462	ЭЧЭ-503 Пери, ТСН-1	ТТ	А	ТФН-35	0,5	15/5	664-51		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	15/5	664-51		
		ТН	А	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	В	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
463	ЭЧЭ-503 Пери, ТСН-2	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	15/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	15/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
464	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Орехово-2	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
465	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Саперная-2	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
466	ЭЧЭ-504 Орехово, ф. Лесное-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
467	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-1	ТТ	А	ТФН-35	0,5	15/5	664-51	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	15/5	664-51		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
468	ЭЧЭ-504 Орехово, ТР-1	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
469	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Орехово-1	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
470	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-2	ТТ	А	ТОЛ-35-III	0,5	15/5	21256-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35-III	0,5	15/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
471	ЭЧЭ-504 Орехово, ТР-2	ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
472	ЭЧЭ-504 Орехово, ф. Лесное-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
473	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.1	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
474	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.2	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
475	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.3	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
476	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.4	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
477	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.5	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
478	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.6	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
479	ЭЧЭ-504 Орехово, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
480	ЭЧЭ-504 Орехово, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛМ-10-I У3	0,2S	100/5	48923-12		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-I У3	0,2S	100/5	48923-12		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
481	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.Дом	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
482	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-1-10	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	40473-14		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	40473-14		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
483	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, Ладожская-6	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
484	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, Озерная-1	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
485	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПВА-1	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
486	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПВА-2	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
487	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ВВ 10	ТТ	А	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5S	50/5	15128-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5S	50/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
488	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
489	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
490	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ф.Дом	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
491	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ф.Насосная	ТТ	А	ТК-20	0,5	20/5	1407-60	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТК-40	0,5	20/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
492	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
493	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
494	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
495	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, л. Лад-3	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
496	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, л. Лад-4	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
497	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПВА-1	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
498	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПВА-2	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
499	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, Ввод 10 кВ	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
500	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
501	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПЭ-3	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
502	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
503	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ТСН-2	ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
504	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ЭЧК	ТТ	A	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
505	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ВВ-1-110	ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
506	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ВВ-2-110	ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
507	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ОКП-110	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
508	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ввод-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
509	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ввод-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
510	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПВА-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
511	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПВА-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
512	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.5	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
513	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ф-7 Профил.	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
514	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.3 РПС	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
515	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.4	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
516	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ф -6 Профил.	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
517	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
518	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
519	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-3	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
520	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.1-10 яч.4 ЦМТО	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
521	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.2-10 яч.17	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
522	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
523	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
524	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
525	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
526	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
527	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 РТП-1	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
528	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 РТП-1	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
529	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 3 ДОЛБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
530	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 4 ДОЛБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
531	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 ПЭ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
532	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 ПЭ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
533	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 3 ПЭ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
534	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 4 ПЭ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
535	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 КУ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
536	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 КУ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
537	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 ЛЭП АБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
538	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 ЛЭП АБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
539	ЭЧЭ-514 Выборг, ф.3 ЛЭП АБ	ТТ	А	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
540	ЭЧЭ-514 Выборг, ф.4 ЛЭП АБ	ТТ	А	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
541	ЭЧЭ-514 Выборг, ВВ-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
542	ЭЧЭ-514 Выборг, ВВ-2-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
543	ЭЧЭ-514 Выборг, Т-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	200/5	35056-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
544	ЭЧЭ-514 Выборг, Т-2-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
545	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
546	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-3-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
547	ЭЧЭ-514 Выборг, ТСН-1-35	ТТ	A	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	C	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТН	A	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
548	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-2-35	ТТ	A	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	B	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	C	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	A	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
549	ЭЧЭ-514 Выборг, ТСН-2-35	ТТ	A	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	B	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	C	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТН	A	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
550	ЭЧЭ-516 Токсово, ПВА	ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
551	ЭЧЭ-516 Токсово, ТСН	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	75/5	26198-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	75/5	26198-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S	1	16666-97		
552	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВЛ 110 кВ Ромашки - Петяярви с отпайкой на ПС Мичуринская (быв. Громовская-3)	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
553	ЭЧЭ-517 Петяярви, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
554	ЭЧЭ-517 Петяярви, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
555	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВЛ 110 кВ Громовская-4	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
556	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВВОД 1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
557	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВВОД 2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
558	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПВА-1	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
559	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПВА-2	ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
560	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-06	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
561	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-01	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
562	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-02	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
563	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-03	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
564	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-05	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
565	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
566	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
567	ЭЧЭ-517 Петяярви, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
568	ЭЧЭ-517 Петяярви, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
569	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.СЦБ	ТТ	А	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
570	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 кВ Громово-Ромашки I цепь	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	9	10
571	ЭЧЭ-518 Громово, Л. Отрадненская 1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
572	ЭЧЭ-518 Громово, Т-1-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
573	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 кВ Громово-Ромашки II цепь	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
574	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 Отрадненская-3	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
575	ЭЧЭ-518 Громово, Т-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
576	ЭЧЭ-518 Громово, ОВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
577	ЭЧЭ-518 Громово, ф.Саперная-1	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
578	ЭЧЭ-518 Громово, ф. Красноармейская-1	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
579	ЭЧЭ-518 Громово, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
580	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-02	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
581	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-04	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
582	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-06	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
583	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-08	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
584	ЭЧЭ-518 Громово, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
585	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-03	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
586	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-05	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
587	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-07	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
588	ЭЧЭ-518 Громово, ПВА-1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
589	ЭЧЭ-518 Громово, ПВА-2	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
590	ЭЧЭ-518 Громово, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
591	ЭЧЭ-518 Громово, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
592	ЭЧЭ-518 Громово, СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
593	ЭЧЭ-518 Громово, Ввод 1 10 кВ	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
594	ЭЧЭ-518 Громово, Ввод 2 10 кВ	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
595	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
596	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
597	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, л. Отр 3	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
598	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, л. Отр 2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
599	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
600	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
601	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.414-01	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
602	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.414-03	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
603	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.414-05	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
604	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.ПЭ-2	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
605	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.ПЭ-1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
606	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.414-02	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
607	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ф.414-06	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	59870-15		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	59870-15		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
608	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ПВА-2	ТТ	А	ТЛМ-10 У3	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10 У3	0,5	800/5	2473-69		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
609	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ПВА-1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
610	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-07		
611	ЭЧЭ-519 Мюллюпельто, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
612	ЭЧЭ-520 152-й км, ВЛ 110 кВ Приозерская-1	ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
613	ЭЧЭ-520 152-й км, ВЛ 110 кВ Приозерская-2	ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
614	ЭЧЭ-520 152-й км, ВВ1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
615	ЭЧЭ-520 152-й км, ВВ2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S	1	16666-97		
616	ЭЧЭ-520 152-й км, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S	1	16666-97		
617	ЭЧЭ-520 152-й км, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
618	ЭЧЭ-520 152-й км, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
619	ЭЧЭ-520 152-й км, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
620	ЭЧЭ-520 152-й км, ф. 415-03	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
621	ЭЧЭ-520 152-й км, ф. 415-04	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
622	ЭЧЭ-520 152-й км, ТСН-1	ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
			A	-					
			B	-					
			C	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
623	ЭЧЭ-520 152-й км, ТСН-2	ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
			A	-					
			B	-					
			C	-					
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
624	ЭЧЭ-520 152-й км, СЦБ	ТТ	A	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
			A	-					
			B	-					
			C	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
625	ЭЧЭ-11 75 км, Т-1-110	ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
626	ЭЧЭ-11 75 км, Т-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
627	ЭЧЭ-11 75 км, ПЛ-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
628	ЭЧЭ-11 75 км, ПЛ-1-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
629	ЭЧЭ-11 75 км, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
630	ЭЧЭ-11 75 км, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
631	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
632	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
633	ЭЧЭ-11 75 км, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
634	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-3-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
635	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-3-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
636	ЭЧЭ-11 75 км, ф.497-15	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
637	ЭЧЭ-11 75 км, ф.497-08	ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
638	ЭЧЭ-11 75 км, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
639	ЭЧЭ-11 75 км, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
640	ЭЧЭ-11 75 км, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
641	ЭЧЭ-11 75 км, Отопление	ТТ	А	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
642	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
643	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
644	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
645	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
646	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ф. 498-08 Горгальская (ПЭ-1)	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
647	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
648	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ф. 498-03 Мехлеспункт	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
649	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-3-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
650	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-3-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		A1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
651	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
652	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
653	ЭЧЭ-12 Новый Быт, Ввод-1 110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
654	ЭЧЭ-12 Новый Быт, Ввод-2 110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
655	ЭЧЭ-15 Жарок, ВЛ-110 Жарковская-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
656	ЭЧЭ-15 Жарок, ВЛ-110 Малуксинская-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
657	ЭЧЭ-15 Жарок, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
658	ЭЧЭ-15 Жарок, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
659	ЭЧЭ-15 Жарок, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
660	ЭЧЭ-15 Жарок, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
661	ЭЧЭ-15 Жарок, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
662	ЭЧЭ-15 Жарок, ПВА-2	ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
663	ЭЧЭ-15 Жарок, ПЭ-2	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
664	ЭЧЭ-15 Жарок, ПЭ-1	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
665	ЭЧЭ-16 Кириши, ВВ-1-10	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
666	ЭЧЭ-16 Кириши, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
667	ЭЧЭ-16 Кириши, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
668	ЭЧЭ-16 Кириши, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
669	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-1-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
670	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-2-10	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
671	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-5-10	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
672	ЭЧЭ-16 Кириши, ф. К-1	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
673	ЭЧЭ-16 Кириши, ф. К-2	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
674	ЭЧЭ-16 Кириши, ф.3-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,5	20/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	20/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	20/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
675	ЭЧЭ-16 Кириши, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
676	ЭЧЭ-16 Кириши, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
677	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
678	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
679	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ВВ-1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
680	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ВВ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
681	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПЭ-1-10	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
682	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПЭ-2-10	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
683	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПВА-1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
684	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПВА-2	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
685	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-01(Белая)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
686	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-17(Тарное)	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
687	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-18Горчаково	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
688	ЭЧЭ-17 Пчевжа, Т-1-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
689	ЭЧЭ-17 Пчевжа, Т-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
690	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
691	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
692	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
693	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
694	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф1 ПЭ (ф.1ПЭ-10)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59		
695	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф1-10 (ф.1-10)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТПФ-10	0,5	100/5	517-50		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФ-10	0,5	100/5	517-50		
696	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф3-10 (ф.3-10)	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
697	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф5-10 (ф.5-10)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	B	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	C	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	A	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
698	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
699	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
700	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф2 ПЭ (ф.2ПЭ-10)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
701	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф2-10 (ф.2-10)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
702	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф4-10 (ф.4-10)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
703	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Т-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
704	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Т-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
705	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ЛВ-2 (Л.Волховская 2-110)	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
706	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ЛВ-6 (Л.Волховская 6-110)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
707	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
708	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, ВПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
709	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, ВПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
710	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
711	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
712	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворота, АБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
713	ЭЧЭ-3 Колчаново, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	B	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
714	ЭЧЭ-3 Колчаново, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	B	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
715	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
716	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
717	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
718	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
719	ЭЧЭ-3 Колчаново, ф.4-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
720	ЭЧЭ-3 Колчаново, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
721	ЭЧЭ-3 Колчаново, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
722	ЭЧЭ-4 Юги, Ввод-Т-1 220 кВ (ВЛ ОЛ 201-432)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
723	ЭЧЭ-4 Юги, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
724	ЭЧЭ-4 Юги, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
725	ЭЧЭ-4 Юги, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
726	ЭЧЭ-4 Юги, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
727	ЭЧЭ-4 Юги, ф.1-ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
728	ЭЧЭ-4 Юги, ф.2-ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
729	ЭЧЭ-4 Юги, АБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
730	ЭЧЭ-4 Юги, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
731	ЭЧЭ-4 Юги, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
732	ЭЧЭ-5 Паша, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	B	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
733	ЭЧЭ-5 Паша, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	B	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
734	ЭЧЭ-5 Паша, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1000/5	2473-69		
735	ЭЧЭ-5 Паша, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1000/5	2473-69		
736	ЭЧЭ-5 Паша, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	100/5	2473-69		
737	ЭЧЭ-5 Паша, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
738	ЭЧЭ-5 Паша, ф. ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	200/5	2473-69		
739	ЭЧЭ-5 Паша, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
740	ЭЧЭ-5 Паша, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5	6	7	9	10
741	ЭЧЭ-6 Заостровье, Ввод-Т-1 220 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	IMB 245	0,2S	50/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 245	0,2S	50/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 245	0,2S	50/5	32002-06		
742	ЭЧЭ-6 Заостровье, ВЛ-220 кВ «Л-212» (ВВ-1 220 кВ)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
743	ЭЧЭ-6 Заостровье, ВЛ-220 кВ «Л-201» (ВВ-2 220 кВ)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
744	ЭЧЭ-6 Заостровье, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
745	ЭЧЭ-6 Заостровье, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
746	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
747	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
748	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
749	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
750	ЭЧЭ-6 Заостровье, АБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
751	ЭЧЭ-6 Заостровье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
752	ЭЧЭ-6 Заостровье, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
753	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	B	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
754	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	B	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
755	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
756	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
757	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, Ф.1ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
758	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, Ф.2ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
759	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
760	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
761	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВВ-1-10	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
762	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВВ-2-10	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
763	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
764	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
765	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
766	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
767	ЭЧЭ-8 Яндеба, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
768	ЭЧЭ-8 Яндеба, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
769	ЭЧЭ-8 Яндеба, СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
770	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВВ-1-10	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
771	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
772	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
773	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПВ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
774	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		
775	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
776	ЭЧЭ-10 Мыслино, ф. ДПКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	30/5	9143-01		
777	ЭЧЭ-10 Мыслино, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
778	ЭЧЭ-10 Мыслино, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
779	ЭЧЭ-10 Мыслино, АБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	40473-14		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	40473-14		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	40473-14		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
780	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
781	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	IMB 123	0,2	50/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 123	0,2	50/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 123	0,2	50/5	32002-06		
782	ЭЧЭ-11 Валя, ВЛ-110 Мыслинская-3	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
783	ЭЧЭ-11 Валя, ВЛ-110 Мыслинская-4	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
784	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
785	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
786	ЭЧЭ-11 Валя, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
787	ЭЧЭ-11 Валя, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
788	ЭЧЭ-11 Валя, СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
789	ЭЧЭ-11 Валя, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
790	ЭЧЭ-11 Валя, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
791	ЭЧЭ-12 Цвылево, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
792	ЭЧЭ-12 Цвылево, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
793	ЭЧЭ-12 Цвылево, СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	B	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	C	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
794	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
795	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-P3B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
796	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВПВ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
797	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВПВ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
798	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВФ1ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
799	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВФ2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
800	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВВ-1-110 в ОТ Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
801	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВВ-2-110 в ОТ Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
802	ЭЧЭ-13 Тихвин, Ввод-1-10	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
803	ЭЧЭ-13 Тихвин, Ввод-2-10	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
804	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
805	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ1-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
806	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ2-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
807	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ3-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
808	ЭЧЭ-13 Тихвин, СЦБ в ОТ АБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
809	ЭЧЭ-13 Тихвин, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
810	ЭЧЭ-13 Тихвин, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
811	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-1-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
812	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-2-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
813	ЭЧЭ-14 Большой Двор, Линия БД-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
814	ЭЧЭ-14 Большой Двор, Линия БД-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
815	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
816	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
817	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
818	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
819	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
820	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
821	ЭЧЭ-14 Большой Двор, СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
822	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВВ-1-110 в ОТ Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
823	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВВ-2-110 в ОТ Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
824	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, Ввод-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
825	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, Ввод-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
826	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ-1-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
827	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ1-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
828	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ2-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
829	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, СЦБ в ОТ АБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
830	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
831	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
832	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
833	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
834	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
835	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
836	ЭЧЭ-16 Ефимовская, Л.1 Вологодская-4	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
837	ЭЧЭ-16 Ефимовская, Л.2 Ефимовская-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
838	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ПЭ-1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83		
839	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ПЭ-2	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
840	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ф.ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06		
841	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
842	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	600/5	6891-85		
843	ЭЧЭ-16 Ефимовская, СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	B	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	C	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
844	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
845	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	200/5	9143-01		
846	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ 1 ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
847	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ 2 ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
848	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ-ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
849	ЭЧЭ-17 Заборье, В-Ф-2-РП-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
850	ЭЧЭ-17 Заборье, В-Ф-1-РП-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
851	ЭЧЭ-17 Заборье, К-СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
852	ЭЧЭ-17 Заборье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
853	ЭЧЭ-17 Заборье, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
854	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
855	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
856	РТП-18 Заборье, ф. 18-01	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
857	РТП-18 Заборье, ф. 18-02	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
858	РТП-18 Заборье, ф. 18-06	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
859	ЭЧЭ-18 Тешемля, ВВ1-10	Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
860	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
861	ЭЧЭ-18 Тешемля, ВВ2-10	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
862	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
863	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
864	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
865	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ввод 1 Подборовье -Тешемля	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
866	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТТу-110 Т1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
867	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ввод 2 Бабаево-Тешемля	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
868	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТТу-110 Т2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
869	ЭЧЭ-18 Тешемля, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	B	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	C	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
870	ЭЧЭ-20 Уйта, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
871	ЭЧЭ-20 Уйта, Ф1-ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
872	ЭЧЭ-20 Уйта, Ф1-10 (ВФ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
873	ЭЧЭ-20 Уйта, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
874	ЭЧЭ-20 Уйта, Ф2-ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
875	ЭЧЭ-20 Уйта, Ф2-10 (ВФ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
876	ЭЧЭ-20 Уйта, ВВ-1-27,5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
877	ЭЧЭ-20 Уйта, ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5	47124-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5	47124-11		
		ТТ	C	-					
878	ЭЧЭ-20 Уйта, ВВ-2-27,5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
879	ЭЧЭ-20 Уйта, ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5	47124-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5	47124-11		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
880	ЭЧЭ-20 Уйта, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	B	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	C	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
881	ЭЧЭ-20 Уйта, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	B	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	C	ТТИ-40	0,5S	600/5	28139-12		
882	ЭЧЭ-20 Уйта, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	B	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	C	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
883	ЭЧЭ-20 Уйта, Л.Уйта1	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	B	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	C	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
884	ЭЧЭ-20 Уйта, ТТу-110 Т1	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
885	ЭЧЭ-20 Уйта, Л.Уйта2	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	B	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	C	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
886	ЭЧЭ-20 Уйта, ТТу-110 Т2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
887	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-1-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
888	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ1-10 (ВФ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	75/5	9143-01		
889	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ3-10 (ВФ-3)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,2S	50/5	32139-06		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,2S	50/5	32139-06		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,2S	50/5	32139-06		
890	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ-1-ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
891	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВПВ-1 (ПВА-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
892	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
893	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ5-10 (ВФ-5)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06		
894	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ4-10 (ВФ-4)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
895	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ-2-ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
896	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВПВ-2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
897	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ2-10 (ВФ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	75/5	9143-01		
898	ЭЧЭ-19 Бабаево, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		
899	ЭЧЭ-19 Бабаево, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
900	ЭЧЭ-19 Бабаево, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
901	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-27,5	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
902	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-3-27,5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
903	ЭЧЭ-19 Бабаево, ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	100/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	100/5	19720-06		
		ТТ	C	ТВ-35	0,5	100/5	19720-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
904	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-1-110 Л.Бабаевская-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
905	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-1-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
906	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-110 Л.Уйтинская-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
907	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-3-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
908	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-2-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
909	ЭЧЭ-6 Чудово, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
910	ЭЧЭ-6 Чудово, ПВ1 (ПВА-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
911	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
912	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф3ПЭ (ПЭ-3)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
913	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф1-10 (ф.486-03)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
914	ЭЧЭ-6 Чудово, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
915	ЭЧЭ-6 Чудово, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
916	ЭЧЭ-6 Чудово, ПВ2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	600/5	1261-02		
917	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
918	ЭЧЭ-6 Чудово, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
919	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф2-10 (ф.486-12)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
920	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф4-10 (ф.486-14)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
921	ЭЧЭ-6 Чудово, ЭЧК	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	100/5	1407-60		
922	ЭЧЭ-6 Чудово, СЦБ1,2 (АБ)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
923	ЭЧЭ-6 Чудово, СЦБ3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	1	100/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	1	100/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	1	100/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
924	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф1СЦБ (АБ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5	21573-01		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	300/5	21573-01		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	21573-01		
925	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2СЦБ (АБ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	B	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	C	О-49	0,5	300/5	617-50		
926	ЭЧЭ-7 Гряды, ф.Дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	71031-18		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	71031-18		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	71031-18		
927	ЭЧЭ-7 Гряды, ВВ1-10	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
928	ЭЧЭ-7 Гряды, ПВ1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
929	ЭЧЭ-7 Гряды, ТСН1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
930	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
931	ЭЧЭ-7 Гряды, ВВ2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
932	ЭЧЭ-7 Гряды, ПВ2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
933	ЭЧЭ-7 Гряды, ТСН2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
934	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
935	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2-10 (ф.485-15)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
936	ЭЧЭ-7 Гряды, Л.Октябрьская-7	Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
937	ЭЧЭ-7 Гряды, Л.Октябрьская-10	Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15		
938	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, В-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
939	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5S	1000/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5S	1000/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
940	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16		
941	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ФПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФ-10	0,5	75/5	517-50		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
942	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф1-10 (ф. Стекольный з-д)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М У2	0,5S	300/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М У2	0,5S	300/5	47958-16		
943	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф3-10 (ф. Узел 1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	150/5	1261-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	150/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
944	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, В-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
945	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
946	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16		
947	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф2-10 (Узел 2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
948	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
949	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ЭЧК-6 (ЭЧК)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
950	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Л. Октябрьская-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
951	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Л. Октябрьская-7	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
952	ЭЧЭ-29 Бурга, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
953	ЭЧЭ-29 Бурга, ПВ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М У2	0,5S	750/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М У2	0,5S	750/5	47958-16		
954	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
955	ЭЧЭ-29 Бурга, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
956	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф1-10 (ф. С/Х 1)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
957	ЭЧЭ-29 Бурга, ВВ2-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
958	ЭЧЭ-29 Бурга, ПВ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 У2	0,5S	800/5	7069-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 У2	0,5S	800/5	7069-07		
959	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
960	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф2-10 (ф С/Х-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
961	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф4-10 (ф С/Х-4)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
962	ЭЧЭ-29 Бурга, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		
963	ЭЧЭ-29 Бурга, ТТ-Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
964	ЭЧЭ-29 Бурга, ТТ-Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
965	ЭЧЭ-29 Бурга, АБ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
966	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф.Дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
967	ЭЧЭ-30 Оксочи, В1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
968	ЭЧЭ-30 Оксочи, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	1	800/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	1	800/5	9143-01		
969	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф1-10 (ф.С/Х 2)	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
970	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф3-10 (ф.С/Х 4)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
971	ЭЧЭ-30 Оксочи, В2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
972	ЭЧЭ-30 Оксочи, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
973	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф4-10 (ф.С/Х 1)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
974	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф2-10 (ф.С/Х 3)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
975	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВш-2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
976	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВш-3-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
977	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВш-4-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
978	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВш-5-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
979	ЭЧЭ-30 Оксочи, ОВ-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
980	ЭЧЭ-30 Оксочи, Т-1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
981	ЭЧЭ-30 Оксочи, Т-2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
982	ЭЧЭ-30 Оксочи, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
983	ЭЧЭ-30 Оксочи, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
984	ЭЧЭ-31 Торбино, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
985	ЭЧЭ-31 Торбино, ПВ1 (ПВА-1)	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10 4	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10 4	0,5	800/5	2473-69		
986	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
987	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф1-10 (ф.31-07 (с.х.1))	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У2	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У2	0,5S	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
988	ЭЧЭ-31 Торбино, ВВ2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
989	ЭЧЭ-31 Торбино, ПВ2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
990	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
991	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф2-10 (ф.31-07 (с.х.2))	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
992	ЭЧЭ-31 Торбино, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
993	ЭЧЭ-31 Торбино, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
994	ЭЧЭ-31 Торбино, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
995	ЭЧЭ-31 Торбино, Т-1-110	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
996	ЭЧЭ-31 Торбино, Т-2-110	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
997	ЭЧЭ-31 Торбино, ЛВШ-4 (ВШ-4-110)	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
998	ЭЧЭ-31 Торбино, ЛВШ-6 (ВШ-6-110)	Счетчик	EA02RAL-P4B-4		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
999	ЭЧЭ-32 Боровенка, СЦБ (фАБ)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1000	ЭЧЭ-32 Боровенка, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1001	ЭЧЭ-32 Боровенка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
1002	ЭЧЭ-32 Боровенка, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
1003	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1004	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф1-10 (ф.32-08 (с/х 1))	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	150/5	25433-03		
1005	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф3-10 (ф.32-03 (с/х 3))	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
1006	ЭЧЭ-32 Боровенка, ВВ2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1007	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1008	ЭЧЭ-32 Боровенка, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
1009	ЭЧЭ-32 Боровенка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
1010	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф2-10 (ф.32-14 (с/х 2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
1011	ЭЧЭ-32 Боровенка, Т-1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1012	ЭЧЭ-32 Боровенка, Т-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1013	ЭЧЭ-33 Окуловка, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
1014	ЭЧЭ-33 Окуловка, ф.Дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	20/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	20/5	1407-60		
1015	ЭЧЭ-33 Окуловка, ВВ-1-10	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1016	ЭЧЭ-33 Окуловка, ПВ1 (ПВА-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
1017	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф5-10 (ф.33-08 (с.х.7))	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1018	ЭЧЭ-33 Окуловка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
1019	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф1-10 (ф.33-03 (с.х. 3))	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1020	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф3-10 (ф.33-04 (с.х. 5))	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
1021	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф7-10 (ф. Узел-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1022	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
1023	ЭЧЭ-33 Окуловка, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1024	ЭЧЭ-33 Окуловка, ПВ-2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
1025	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф8-10 (ф. Узел-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1026	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
1027	ЭЧЭ-33 Окуловка, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1028	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф2-10 (ф.33-14 (с.х.2))	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
1029	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф6-10 (ф.33-17 (с.х.4))	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
1030	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф4-10 (ф.33-15 (с.х.6))	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
1031	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Угловка-Окуловка	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1032	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Яблоновка-Окуловка	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1033	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Окуловская-1	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1034	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Окуловская-2	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1035	ЭЧЭ-33 Окуловка, Т-1-110	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1036	ЭЧЭ-33 Окуловка, Т-2-110	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1037	ЭЧЭ-36 Волхово, В1-10	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1038	ЭЧЭ-36 Волхово, В2-10	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1039	ЭЧЭ-36 Волхово, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1040	ЭЧЭ-36 Волхово, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
1041	ЭЧЭ-36 Волхово, МЛР-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
1042	ЭЧЭ-36 Волхово, ТТУ1-110 (Т-1-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1043	ЭЧЭ-36 Волхово, СВ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1044	ЭЧЭ-36 Волхово, ТТУ2-110 (Т-2-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1045	ЭЧЭ-37 Красненка, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1046	ЭЧЭ-37 Красненка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1047	ЭЧЭ-37 Красненка, ВВ2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1048	ЭЧЭ-37 Красненка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1049	ЭЧЭ-37 Красненка, ТСН1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
1050	ЭЧЭ-37 Красненка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	800/5	26820-04		
1051	ЭЧЭ-37 Красненка, ТТ1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1052	ЭЧЭ-37 Красненка, ТТ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1053	ЭЧЭ-37 Красненка, СВ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1054	ЭЧЭ-37 Красненка, МЛР-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1055	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1056	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1057	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ВВ2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1058	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1059	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф1-10 (с/х 1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1060	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
1061	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
1062	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
1063	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТТ1-110 (Т-1-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1064	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТТ2-110 (Т-2-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
1065	ЭЧЭ-39 Заозерье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1066	ЭЧЭ-39 Заозерье, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1067	ЭЧЭ-39 Заозерье, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1068	ЭЧЭ-39 Заозерье, Ф1-ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1069	ЭЧЭ-39 Заозерье, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1070	ЭЧЭ-39 Заозерье, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1071	ЭЧЭ-39 Заозерье, Т-1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1072	ЭЧЭ-39 Заозерье, Т-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1073	ЭЧЭ-39 Заозерье, СВ-110 (МВ-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1074	ЭЧЭ-39 Заозерье, МЛР-110 (РП-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1075	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ввв1-10 (ВВ-1-10)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1076	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ПВ1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	800/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	800/5	8913-82		
1077	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ТСН1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
1078	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1079	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф3ПЭ (ПЭ-3)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1080	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф1-10 (ф.24-06)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1081	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ввв2-10 (ВВ-2-10)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1082	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-02		
1083	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ПВ2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	800/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	800/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1084	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1085	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф2-10 (ф.24-11)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1086	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф4-10 (ф.24-15)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1087	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ЭЧК-13	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	36382-07		
		ТТ	B	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	36382-07		
		ТТ	C	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	36382-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1088	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ЭЧС-6	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
1089	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1090	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
1091	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1092	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1093	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
1094	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
1095	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТСН1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1096	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТСН2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1097	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, Магистральная (Бор-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1098	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТТУ1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
1099	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, Бор-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1100	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТТУ2-110	Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
1101	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВВ1-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
1102	ЭЧЭ-5 Яблоновка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1103	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВВ2-10	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1104	ЭЧЭ-5 Яблоновка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1105	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ТСН-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
1106	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ТСН-2	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T+		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-04		
1107	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВЛ-110 кВ Окуловка	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТФМ-110	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110	0,5	600/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1108	ЭЧЭ-5 Завидово, ВВОД-1 п/ст 9	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
1109	ЭЧЭ-5 Завидово, ВВОД-2 Безбородово	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
1110	ЭЧЭ-5 Завидово, ПВА-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
1111	ЭЧЭ-5 Завидово, ТСН-1	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1112	ЭЧЭ-5 Завидово, ПВА-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
1113	ЭЧЭ-5 Завидово, ТСН-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
1114	ЭЧЭ-5 Завидово, ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1115	ЭЧЭ-5 Завидово, ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1116	ЭЧЭ-5 Завидово, ф. ЭЧК	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	1	200/5	6891-78		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	1	200/5	6891-78		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	1	200/5	6891-78		
1117	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ВВОД-1 Редкино	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
1118	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ВВОД-2 Эммаус	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
1119	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-07		
		ТТ	B	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-07		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1120	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07		
1121	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	B	ТОЛ-35	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5S	300/5	21256-07		
1122	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07		
1123	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.РУ-6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	15/5	3689-73		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1124	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1125	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1126	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.Ж.Д	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
1127	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.3 Сельхоз	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1128	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф. гараж	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	О-49	0,5	300/5	617-50		
1129	ЭЧЭ-8 Редкино, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1130	ЭЧЭ-8 Редкино, Т-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1131	ЭЧЭ-8 Редкино, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1132	ЭЧЭ-8 Редкино, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
1133	ЭЧЭ-8 Редкино, ПЭ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1134	ЭЧЭ-8 Редкино, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1135	ЭЧЭ-8 Редкино, Ф-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1136	ЭЧЭ-8 Редкино, Ф-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1137	ЭЧЭ-8 Редкино, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1138	ЭЧЭ-8 Редкино, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1139	ЭЧЭ-17 Конаково, Ввод-1 ГРЭС	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1140	ЭЧЭ-17 Конаково, Ввод-2 ГРЭС	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
1141	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Фаянсовый завод	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
1142	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.7 ПМК	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		
1143	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.9 РП-3	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1144	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.11 насосная	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
1145	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.13 РП-1-I	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1146	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.8 РП-1-II	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
1147	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.10 водное хоз-во	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1148	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.12 больница	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
1149	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.14 водное хоз-во	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
1150	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Т-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	150/5	3689-73		
1151	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Т-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5S	150/5	21256-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5S	150/5	21256-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1152	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.15 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1153	ЭЧЭ-17 Конаково, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1154	ЭЧЭ-17 Конаково, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1155	ЭЧЭ-1 Бологое, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1156	ЭЧЭ-1 Бологое, Т-2 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1157	ЭЧЭ-1 Бологое, Ввод-1 35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	B	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
1158	ЭЧЭ-1 Бологое, Ввод-2 35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	B	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
1159	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.10 Город	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1160	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.11 Город	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
1161	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.6 Бушевец	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1162	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.16 ПМС-292	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
1163	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.15 Город	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1164	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.12 Заозерная-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1165	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф. ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1166	ЭЧЭ-1 Бологое, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1167	ЭЧЭ-1 Бологое, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1168	ЭЧЭ-1 Бологое, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-В-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1169	ЭЧЭ-1 Бологое, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-В-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1170	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Злино	Счетчик	ЕА05L-В-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
1171	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-1	Счетчик	ЕА05L-В-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1172	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-6 №1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
1173	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Медведево-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1174	ЭЧЭ-1 Бологое, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1175	ЭЧЭ-1 Бологое, ПВА-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1176	ЭЧЭ-1 Бологое, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1177	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-6 №2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1178	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Медведево-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1179	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.5 Куженкино	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1180	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф. Медведево-3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1181	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.1 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1182	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.3 Едрово	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1183	ЭЧЭ-2 Алёшинка, Ввод-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1184	ЭЧЭ-2 Алёшинка, Ввод-2-110кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1185	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.1 Березайка	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
1186	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.3 Всходы	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1187	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.5 ОН-55/3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1188	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.7 ОН-55/3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1189	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.2 Линево	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
1190	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.4 Лыкошино	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1191	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.6 Рютино	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1192	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1193	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1194	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1195	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1196	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1197	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1198	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1199	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1200	ЭЧЭ-3 Угловка, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1201	ЭЧЭ-3 Угловка, ВЛ-110 Окуловка	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1202	ЭЧЭ-3 Угловка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1203	ЭЧЭ-3 Угловка, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1204	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
1205	ЭЧЭ-3 Угловка, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1206	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-7	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1207	ЭЧЭ-3 Угловка, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1208	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1209	ЭЧЭ-3 Угловка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1210	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х-Бологое	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1211	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х-Поплавенец	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1212	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х-Яблоновка	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1213	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х-Угловка	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
1214	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Обходная с.ш.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	A	ТФМ-110	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1215	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1216	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Т -2 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1217	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
1218	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
1219	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1220	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1221	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1222	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1223	ЭЧЭ-6 Бочановка, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1224	ЭЧЭ-6 Бочановка, Т-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1225	ЭЧЭ-6 Бочановка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1226	ЭЧЭ-6 Бочановка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1227	ЭЧЭ-6 Бочановка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1228	ЭЧЭ-6 Бочановка, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1229	ЭЧЭ-6 Бочановка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1230	ЭЧЭ-6 Бочановка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1231	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1232	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
1233	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-3-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	300/5	59870-15		
1234	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-3-2	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
1235	ЭЧЭ-7 Тверь, Т-4-35	Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1236	ЭЧЭ-7 Тверь, Т-5-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/5	59870-15		
1237	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.Т-5-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
1238	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.-3-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
1239	ЭЧЭ-7 Тверь, ТСН-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1240	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.Т-4-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
1241	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.-2-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	200/5	69606-17		
1242	ЭЧЭ-7 Тверь, ТСН-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	40/5	69606-17		
1243	ЭЧЭ-7 Тверь, ПЭ-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	100/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1244	ЭЧЭ-7 Тверь, ТЭЦ 4-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
1245	ЭЧЭ-7 Тверь, Южная-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
1246	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф1 ПЭ-6	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
1247	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф24-6	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1248	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф25-6	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
1249	ЭЧЭ-7 Тверь, СЦБ-1 6 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1250	ЭЧЭ-7 Тверь, СЦБ-2 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
1251	ЭЧЭ-7 Тверь, РТСН-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1252	ЭЧЭ-7 Тверь, РТСН-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
1253	ЭЧЭ-8 Кулицкая, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1254	ЭЧЭ-8 Кулицкая, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1255	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.13 Лямово	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1256	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.14 Рогодино	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B							
		ТН	C							
		ТТ	A	ТЛО-10		0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-						
		ТТ	C	ТЛО-10		0,2S	75/5	25433-03		
1257	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.12 Жив.комплекс	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B							
		ТН	C							
		ТТ	A	ТЛО-10		0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-						
		ТТ	C	ТЛО-10		0,2S	100/5	25433-03		
1258	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.8 КЭМЗ	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B							
		ТН	C							
		ТТ	A	ТЛО-10		0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-						
		ТТ	C	ТЛО-10		0,2S	100/5	25433-03		
1259	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B							
		ТН	C							
		ТТ	A	ТЛО-10		0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-						
		ТТ	C	ТЛО-10		0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1260	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1261	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
1262	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1263	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1264	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2	75/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2	75/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2	75/5	25433-11		
1265	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1266	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1267	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.Отопление	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1268	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.Дом	Счетчик	EA05RL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1269	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
1270	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1271	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД -3 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1272	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1273	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.ТСН-1 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1274	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	B	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
1275	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	B	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1276	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.5 ЭЦ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
1277	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1278	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.ТСН-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1279	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	B	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	C	ТПОЛ 10	0,5	100/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1280	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.Ж.Д.-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1281	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1282	ЭЧЭ-9 Лихославль, СЦБ 1,2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШ-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	B	ТШ-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
1283	ЭЧЭ-9 Лихославль, СЦБ 3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1284	ЭЧЭ-9 Лихославль, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
1285	ЭЧЭ-9 Лихославль, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
1286	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф. Дом 0,4 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1287	ЭЧЭ-10 Калашниково, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1288	ЭЧЭ-10 Калашниково, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1289	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф. с/х Калашниково-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1290	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.ОЧС-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1291	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Завод-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1292	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Селище	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1293	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.ОЧС-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1294	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Завод-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1295	ЭЧЭ-10 Калашниково, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1296	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1297	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
1298	ЭЧЭ-10 Калашниково, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1299	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1300	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2	100/5	25433-11		
1301	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф. Ж.Д. дом	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1302	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1303	ЭЧЭ-10 Калашниково, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1304	ЭЧЭ-10 Калашниково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1305	ЭЧЭ-11 Спирово, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1306	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.ВВОД 35 Т-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		
		ТТ	B	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		
		ТТ	C	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		
1307	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.ВВОД 35 Т-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		
		ТТ	B	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		
		ТТ	C	ТВ-35/10	1	600/5	3186-72		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1308	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.С/Х-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
1309	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.С/Х-3	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1310	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.С/Х-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1311	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.С/Х-4	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1312	ЭЧЭ-11 Спирово, перемычка РУ-10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1313	ЭЧЭ-11 Спирово, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-11		
1314	ЭЧЭ-11 Спирово, ПВА-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
1315	ЭЧЭ-11 Спирово, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1316	ЭЧЭ-11 Спирово, ф. Ж.Д.-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
1317	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.РРС	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	75/5	25433-11		
1318	ЭЧЭ-11 Спирово, ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	75/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	75/5	25433-11		
1319	ЭЧЭ-11 Спирово, ПВА-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1320	ЭЧЭ-11 Спирово, ф. Ж.Д.-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
1321	ЭЧЭ-11 Спирово, ТСН-1	Счетчик	A1R-4-AL-C25-T		0,2S	1	14555-95		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1322	ЭЧЭ-11 Спирово, ТСН-2	Счетчик	A1R-4-AL-C25-T		0,2S	1	14555-95		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1323	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1324	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ВВОД-1-35	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
1325	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ВВОД-2-35	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	75/1	37491-08		
1326	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ф.Терелесово	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
1327	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПВА-1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1328	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	B	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	C	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
1329	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПЭ-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1330	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПЭ-2	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1331	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1332	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
1333	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	26820-04		
1334	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
1335	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1336	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод-1 35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
1337	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод-2 35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-I У1	0,5	200/5	26419-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
1338	ЭЧЭ-13 Академическая, ф.С/Х-1	Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03		
1339	ЭЧЭ-13 Академическая, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1340	ЭЧЭ-13 Академическая, ПВА-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1341	ЭЧЭ-13 Академическая, ТСН-1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
1342	ЭЧЭ-13 Академическая, ПЭ-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
1343	ЭЧЭ-13 Академическая, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1344	ЭЧЭ-13 Академическая, ПВА-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1345	ЭЧЭ-13 Академическая, ТСН-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
1346	ЭЧЭ-13 Академическая, ПЭ-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1347	ЭЧЭ-13 Академическая, ф.ВРП	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1348	ЭЧЭ-14 Торжок, ВВОД -21 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1349	ЭЧЭ-14 Торжок, ВВОД -23 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
1350	ЭЧЭ-14 Торжок, ПВА-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1351	ЭЧЭ-14 Торжок, ПВА-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1352	ЭЧЭ-14 Торжок, ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
1353	ЭЧЭ-14 Торжок, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1354	ЭЧЭ-14 Торжок, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1355	ЭЧЭ-14 Торжок, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1356	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВЛ-110 кВ В.Волочёк	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1357	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВЛ-110 кВ Бочановка	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1358	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод-1 35 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
1359	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод-2 35 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1360	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.С/Х-1 Олимп	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1361	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.13 ООО"ЛДК"	Счетчик	A1R-4-AL-C29-T		0,2S	1	14555-02		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1362	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.С/Х-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1363	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.24 ООО"ЛДК"	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1364	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
1365	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
1366	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик		A2R-3-AL-C29-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1367	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПВА-1	Счетчик		A1R-4-AL-C29-T	0,2S	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1368	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1369	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1370	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПВА-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-11		
1371	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1372	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ТСН-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1373	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ТСН-2	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T+		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
1374	ЭЧЭ-16 Брянцево, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1375	ЭЧЭ-16 Брянцево, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1376	ЭЧЭ-16 Брянцево, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1377	ЭЧЭ-16 Брянцево, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1378	ЭЧЭ-16 Брянцево, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1379	ЭЧЭ-16 Брянцево, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1380	ЭЧЭ-16 Брянцево, ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1381	ЭЧЭ-16 Брянцево, ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1382	ЭЧЭ-16 Брянцево, РП 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1383	ЭЧЭ-16 Брянцево, СВ 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1384	ЭЧЭ-17 Крючково, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1385	ЭЧЭ-17 Крючково, Т-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1386	ЭЧЭ-17 Крючково, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1387	ЭЧЭ-17 Крючково, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1388	ЭЧЭ-17 Крючково, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1389	ЭЧЭ-17 Крючково, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1390	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1391	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1392	ЭЧЭ-17 Крючково, РП 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1393	ЭЧЭ-17 Крючково, СВ 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1394	ЭЧЭ-18 Барановка, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1395	ЭЧЭ-18 Барановка, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1396	ЭЧЭ-18 Барановка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1397	ЭЧЭ-18 Барановка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1398	ЭЧЭ-18 Барановка, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1399	ЭЧЭ-18 Барановка, ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1400	ЭЧЭ-18 Барановка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1401	ЭЧЭ-18 Барановка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1402	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВЛ-110 Л-Барановка	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1403	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВЛ-110 Л-Лихославль	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1404	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВЛ-110 Л-Хохоленка	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1405	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВЛ-110 Л-Спирово	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1406	ЭЧЭ-19 Левошинка, Обходная с.ш.	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1407	ЭЧЭ-19 Левошинка, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1408	ЭЧЭ-19 Левошинка, Т -2 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1409	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
1410	ЭЧЭ-19 Левошинка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
1411	ЭЧЭ-19 Левошинка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1412	ЭЧЭ-19 Левошинка, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1413	ЭЧЭ-19 Левошинка, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1414	ЭЧЭ-19 Левошинка, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1415	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -1 110 кВ от ВЛ-110 Спирово-Новая	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1416	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -2 110 кВ от ВЛ-110 Холохолёнка-Новая	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
1417	ЭЧЭ-20 Индустрия, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
		ТТ	B	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
		ТТ	C	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
1418	ЭЧЭ-20 Индустрия, Т-2 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
		ТТ	B	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
		ТТ	C	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	100/5	2793-71		
1419	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1420	ЭЧЭ-20 Индустрия, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1421	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
1422	ЭЧЭ-20 Индустрия, ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
1423	ЭЧЭ-20 Индустрия, ТСН-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1424	ЭЧЭ-20 Индустрия, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
1425	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ВЛ-110 кВ П-Бологое	Счетчик	EA02RAL-P4B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1426	ЭЧЭ-21 Поплавенец, Вл-110 кВ П-Хмелевка	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1427	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ф.Гузятино	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1428	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ф.Дубровка	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1429	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ф.В/Ч	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1430	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ф.Анисимово	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1431	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ф.2 Березайка	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1432	ЭЧЭ-21 Поплавенец, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
1433	ЭЧЭ-21 Поплавенец, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
1434	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1435	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1436	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ПЭ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
1437	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
1438	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ПВА-2	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1439	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1440	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	B	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	C	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
1441	ЭЧЭ-21 Поплавенец, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	B	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	C	ТК-40	0,5	600/5	3688-73		
1442	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Л-125 110 кВ	ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
1443	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Л-117 110 кВ	ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1444	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Т-1 110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
1445	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Т-2 110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
1446	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ВВ1-10	ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1447	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ВВ2-10	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1448	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПВ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1449	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПВ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1450	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1451	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1452	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-01	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1453	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-02	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1454	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-03	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1455	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-04	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1456	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-05	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1457	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-06	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1458	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-07	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1459	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-08	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	300/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1460	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-11	ТТ	А	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5	50/5	7069-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5	50/5	7069-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1461	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ТСН-1	ТТ	А	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	В	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1462	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ТСН-2	ТТ	А	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	В	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1463	ЭЧЭ-1 Чкаловская, СЦБ	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1464	ЭЧЭ-2 Муромская, ВВ1-10	ТТ	А	ТОЛ 10-I	0,5	200/5	7069-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-I	0,5	200/5	7069-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1465	ЭЧЭ-2 Муромская, ВВ2-10	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1466	ЭЧЭ-2 Муромская, ПВ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
1467	ЭЧЭ-2 Муромская, ПВ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1468	ЭЧЭ-2 Муромская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1469	ЭЧЭ-2 Муромская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1470	ЭЧЭ-2 Муромская, ТСН-1	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1471	ЭЧЭ-2 Муромская, ТСН-2	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1472	ЭЧЭ-2 Муромская, СЦБ	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1473	ЭЧЭ-3 Пионерская, ВВ1-10	ТТ	А	ТОЛ 10-I-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-I-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1474	ЭЧЭ-3 Пионерская, ВВ2-10	ТТ	А	ТОЛ 10-I-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-I-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1475	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПВ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1476	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПВ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
1477	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1478	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1479	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ3-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1480	ЭЧЭ-3 Пионерская, ТСН-1	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1481	ЭЧЭ-3 Пионерская, ТСН-2	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М 0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1482	ЭЧЭ-3 Пионерская, СЦБ	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1483	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-171	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1484	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-172	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1485	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-181	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1486	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-182	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1487	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Обходной выключатель 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1488	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1489	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1490	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 ТСН-3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
1491	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1492	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
1493	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1494	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1495	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-3 (питание на выпрямительный модуль 3,3 кВ)	Счетчик	A1805RALXQV-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21	0,2S	100/5	62259-15		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21	0,2S	100/5	62259-15		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1496	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	В	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1497	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	В	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1498	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 4	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1499	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 5 (Юг)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	TPU 40.21	0,5S	30/5	45424-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	TPU 40.21	0,5S	30/5	45424-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1500	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ПС-65 ТСН1 яч.6 (РП-110-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	B	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	C	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1501	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 12 (П/пит)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	B	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	C	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1502	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 13 (Север)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	B	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	C	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1503	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ПС-65 ТСН2 яч.16 (РП-110-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	B	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	C	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1504	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ВЛ 10 кВ ПЭ яч. 17	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	B	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	C	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-06		
1505	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	B	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	C	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
1506	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	B	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	C	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-03		
1507	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 СЦБ (минус от ТСН)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM60-E4A	0,5	600/5	25559-03		
		ТТ	B	RM60-E4A	0,5	600/5	25559-03		
		ТТ	C	RM60-E4A	0,5	600/5	25559-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1508	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-202 (на ПС-16 "Кондопога"). 1 с.ш.	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	А	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	В	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	С	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
1509	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-203 (на ПС-103 "Сегежа"). 2 с.ш.	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	А	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	В	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	С	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
1510	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-207 (на тяговую - ввод-1-220). 1 с.ш.	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	А	ТФМ-220-II У1	0,5	300/5	22741-02		
		ТТ	В	ТФМ-220-II У1	0,5	300/5	22741-02		
		ТТ	С	ТФМ-220-II У1	0,5	300/5	22741-02		
1511	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-208 (на тяговую - ввод-2-220). 2 с.ш.	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	А	ТФМ-220-II У1	0,5	600/5	22741-02		
		ТТ	В	ТФМ-220-II У1	0,5	600/5	22741-02		
		ТТ	С	ТФМ-220-II У1	0,5	600/5	22741-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1512	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Обходной выключатель. 1 с.ш.	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	А	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	В	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	С	ТФМ-220-II У1	0,5	1000/5	22741-02		
1513	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-19-4 (10 кВ)	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
1514	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-19-17 (10 кВ)	Счетчик	SL761DCB		0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
1515	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1516	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
1517	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	-					
1518	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
1519	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ДПР-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5	50/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5	50/5	49935-12		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1520	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1521	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1522	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1523	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 2 ПЭ ячейка 4 (СЦБ Новострой)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1524	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 1 ПЭ (Медгора) ячейка 5	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-10-I	0,5	300/5	15128-96		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-10-I	0,5	300/5	15128-96		
1525	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 12-10 (резерв) ячейка 12	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1526	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 13-10 (резерв) ячейка 13	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1527	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 15-10 (Щебёночный завод) ячейка 15	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1528	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1529	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1530	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 СЦБ (минус от ЭЧ-8)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
1531	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1532	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
1533	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	600/5	49935-12		
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	600/5	49935-12		
		ТТ	С	-					
1534	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	600/5	49935-12		
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	600/5	49935-12		
		ТТ	С	-					
1535	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1536	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1537	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
1538	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
1539	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 3 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1540	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 4 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
1541	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 10 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
1542	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 11 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
1543	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 12 "Карелэнерго" (резерв)	Счетчик	EA05RAL-P3B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	75/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	75/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1544	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СН-РП-НГП (Негарантированное питание)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	B	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	C	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
1545	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СН-РП-ГП (Гарантированное питание)	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	B	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	C	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
1546	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1547	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1548	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СЦБ (вычитаются от ЭЧ-8)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	B	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	C	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
1549	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
1550	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 145	0,5S	150/5	32002-06		
1551	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1552	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
1553	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1554	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
1555	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1556	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ПВА 1 - 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	600/5	9143-01		
1557	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ПВА 2 - 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	600/5	9143-01		
1558	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ДПРКС-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1559	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ДПРКС-2)	Счетчик	EA05RAL-P3B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1560	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ЦРП-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
1561	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ЦРП-2)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
1562	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ	B	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ	C	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
1563	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ	B	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ	C	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1564	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л-212-220 кВ (на тяговую ввод-1-220)	Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	В	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	С	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
1565	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л-211-220 кВ (на тяговую ввод-2-220)	Счетчик	EA02RAL-B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	В	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	С	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
1566	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л-203-2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
1567	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л-233-2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1568	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Обходной-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
1569	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧ-8 ПС-103 Ввод 0,4 кВ ТСН-1-6 кВ от ТП-3 (первая секция шин)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	B	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	C	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
1570	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧ-8 ПС-103 Ввод 0,4 кВ ТСН-2-10 кВ от ЭЧЭ-101 (вторая секция шин)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	B	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	C	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
1571	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" ф. "Мегафон" рез.(коэфф. ТТ 30/5 учит.счётчиком)	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1572	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1-220 кВ (Линия 212 от ПС-103)	Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	B	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	C	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	A	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
1573	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2-220 кВ (линия 211 от ПС-103)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	B	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	C	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	A	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
1574	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
1575	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		
		ТТ	B	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		
		ТТ	C	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1576	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1577	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ДПР-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1578	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 КУ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5	19720-06		
		ТТ	C	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5	19720-06		
1579	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1-10 кВ ячейка 3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1580	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2-10 кВ ячейка 14	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
1581	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. РП-1 ячейка 4	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
1582	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ТП-3 ячейка 5	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
1583	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. Горсеть ячейка 6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1584	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ТП-2 ячейка 13	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
1585	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. Ячейка 15 резерв	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
1586	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф.РП-103 ячейка16	Счетчик	EA02RAL-P4B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1587	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ДПРКС ячейка 17	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	30/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1588	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
1589	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
1590	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
1591	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1592	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	В	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	С	-					
1593	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	В	ТОЛ 35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	С	-					
1594	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	С	-					
1595	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1596	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1597	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1598	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
1599	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" ВАТ-1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1600	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л-214-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
1601	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л-209-220 кВ (на тяговую)	Счетчик	EA05RAL-P2CN-4W		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	B	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	C	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
1602	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л-210-220 кВ (на тяговую)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	B	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	C	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
1603	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1-220 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	B	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	C	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	A	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1604	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2-220 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	B	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	C	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	A	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		
		ТТ	B	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		
		ТТ	C	IMB 245	0,2S	150/5	32002-06		
1605	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
1606	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5	19720-00		
1607	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ДПР-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1608	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ДПР-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	B	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	C	-					
1609	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1610	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1611	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1612	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 14 Ф. ПЭ "Север"	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1613	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ПЭ (РП-1)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
1614	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 11 Ф. РП-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
1615	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ПС 91	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1616	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 12 Ф резерв (ПС-2)	Счетчик	EA05RAL-P3B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1617	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. "Карелминерал" (ячейка 17)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
1618	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ	B	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ	C	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
1619	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ	B	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ	C	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1620	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ф. СЦБ (минус от ТСН)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	RM70-E4A	0,2S	600/5	25559-03		
		ТТ	B	RM70-E4A	0,2S	600/5	25559-03		
		ТТ	C	RM70-E4A	0,2S	600/5	25559-03		
1621	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-110 ЛНик-1 (на ПС-368 110 кВ "Никольская")	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
1622	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-110 ЛНик-2 (на ПС-368 110 кВ "Никольская")	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
1623	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-220 кВ АТ-1 (Л-203)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	B	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	C	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1624	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-220 кВ АТ-2 (Л-204)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	A	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	B	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	C	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
1625	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" ВЛ-110 кВ Свирская-1 на тяговую Свирь	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	B	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	C	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
1626	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" ВЛ-110 кВ Свирская-2 на тяговую Свирь	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	A	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	B	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	C	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
1627	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Л-154	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W		0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1628	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Л-155	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1629	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1630	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1631	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1632	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1633	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1634	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ДПР-2	Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1635	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1636	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2-10 кВ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-06		
1637	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.ЛПХ-12	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
1638	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.БТП-3	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1639	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.БТП-4	Счетчик		EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1640	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.Калгалакша (ВЛ-48-11)	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-06		
1641	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.ДПРКС	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1642	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ф. Ростелеком (РРС)	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1643	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ТСН-1	Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1644	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1645	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	1	300/5	17551-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	1	300/5	17551-06		
1646	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Л-155	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1647	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Л-156	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1648	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1649	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1650	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1651	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1652	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	C	-					
1653	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	C	-					
1654	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1655	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1656	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 5 ПЭ Север	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	75/5	1276-59		
1657	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф.6 Ростелеком (ТУСМ)	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
1658	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 7 БТП-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1659	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 9 ЛПК-36	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1660	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф.10 Поньгома	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,2S	50/5	25433-03		
1661	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 12 БТП-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1662	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 14 ДПРКС	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1663	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1664	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1665	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	1	300/5	6891-85		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5	15764-96		
1666	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Рабочая перемычка 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1667	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ремонтная перемычка 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1668	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1669	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1670	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1671	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1672	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	C	-					
1673	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	C	-					
1674	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1675	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1676	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 5 ТП-33 Очистные сооружения	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-5	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-5	0,5	200/5	9143-01		
1677	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 6 Электродепо	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1678	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 8 ТП-33 Очистные сооружения	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
1679	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 9 Электродепо	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1680	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 10 ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1681	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 11 Узел станции (ПЭ Север)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
1682	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 13 Вагонное депо	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1683	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 14 Вагонное депо	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1684	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1685	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1686	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 СЦБ	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	1	100/5	36382-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	1	100/5	36382-07		
1687	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1688	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
1689	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1690	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1691	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1692	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	C	-					
1693	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	C	-					
1694	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1695	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1696	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 5 ПЭ Юг	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1697	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 7 резерв	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
1698	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 9 ЖД-1	Счетчик	EA05RAL-P4B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1699	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф.10 ЖД-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1700	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф-14-10 ДПРКС (ячейка 14)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
1701	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1702	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
1703	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	36382-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1704	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-159 110 кВ (на Сумпосад, Нюхча)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
1705	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-160 110 кВ (на Сумпосад, Нюхча)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
1706	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-161 110 кВ (на тяговую п/ст Беломорск)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	B	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	C	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
1707	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-162 110 кВ (на тяговую п/ст Беломорск)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	B	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	C	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1708	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Обходной 110 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110-II У1	0,5	600/5	16023-97		
1709	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Рабочая перемычка 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,5	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,5	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,5	600/5	44640-11		
1710	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ремонтная перемычка 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/1	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/1	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/1	44640-11		
1711	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1712	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
1713	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	-					
1714	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	-					
1715	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1716	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	50/5	46101-10		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	50/5	46101-10		
		ТТ	C	-					
1717	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1718	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1719	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф. ПЭ-Юг "ПСК" (ячейка 3)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	TPU 40.11	0,5	15/5	45424-10		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	TPU 40.11	0,5	15/5	45424-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1720	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-4-10 Ж.д. дома (ячейка 4)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1721	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-5-10 (Ф. 3 "ПСК") (ячейка 5)	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-6	0,5	50/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-6	0,5	50/5	25433-03		
1722	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ПЭ Запад (ячейка 6)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	TPU 40.21	0,5	15/5	17085-98		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	TPU 40.21	0,5	15/5	17085-98		
1723	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ж д Резерв (ячейка 7)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1724	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ж д Резерв (ячейка 16)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	TPU 40.21	0,5	10/5	45424-10		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	TPU 40.21	0,5	10/5	45424-10		
1725	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-18-10 (Ф. 4 "ПСК") (ячейка 18)	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1726	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-19-10 (ПЭ-Север) (ячейка 19)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	TPU 40.21	0,5S	15/5	17085-98		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	TPU 40.21	0,5S	15/5	17085-98		
1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1728	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
1729	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
1730	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		
1731	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	150/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1732	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
1733	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
1734	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	B	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	C	-					
1735	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ДПР-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	B	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1736	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	B	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
1737	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	B	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
1738	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. 1 ячейка.5 (резерв)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1739	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. ПЭ-1 "Север" ячейка.4	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1740	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Л-84-06 ячейка.6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
1741	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Л-84-12 ячейка 12	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
1742	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. 4 Ячейка 13 (резерв)	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	300/5	9143-01		
1743	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. ПЭ-2 "Восток" ячейка14	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1744	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
1745	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП-0,66	0,5S	800/5	15173-06		
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
1746	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	B	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	C	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
1747	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Линия 160 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФЗМ-110Б-IУ1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1748	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Линия 159 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
1749	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Линия "Малошуйка" -110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
1750	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
1751	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	A	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	B	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	C	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1752	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
1753	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	C	ТФМ-35-II	0,5	600/5	17552-98		
1754	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
1755	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 ДПР-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1756	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1757	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
1758	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ф ПЭ Север. ячейка.2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
1759	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ф РП-1 ячейка 3 (резерв)	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1760	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ф ПЭ Восток ячейка.12	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
1761	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 Ф РП-2. ячейка13 (резерв)	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
1762	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	B	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	C	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		
1763	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	B	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		
		ТТ	C	ТШП 0,66	0,5	800/5	15173-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1764	ЭЧЭ-85 Нюхча, ЭЧЭ-85 СЦБ	Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	B	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	C	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
1765	РТП-44 Катозеро, РТП-44 ВВ-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1766	РТП-44 Катозеро, РТП-44 ВВ-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1767	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1-110 кВ Т-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1768	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2-110 кВ Т-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1769	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВЛ-110кВ л. 97	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1770	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВЛ-110кВ л. 124	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1771	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	B	ТФЗМ35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1772	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	B	ТФЗМ35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	C	-					
1773	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
1774	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
1775	ЭЧЭ-7 Кильдин, Т-3 ф. Транзит 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1776	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. 2 Бойлер	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1777	ЭЧЭ-7 Кильдин, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
1778	ЭЧЭ-7 Кильдин, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
1779	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1780	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-5	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1781	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-4	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1782	ЭЧЭ-8 Мурманск, Ф. 9 "Гларус"	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
1783	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 4 "Гларус"	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1784	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 1 "Пескосушилка"	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
1785	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 5 "ТП-7"	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1786	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. ВВ ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1787	ЭЧЭ-8 Мурманск, ВВ-1 ф. 18	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1788	ЭЧЭ-8 Мурманск, ВВ-2-6 ф. 17	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01		
1789	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 2 "ТП-6"	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1790	ЭЧЭ-8 Мурманск, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
1791	ЭЧЭ-8 Мурманск, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1792	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 7 "Резерв"	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1793	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 6 "Резерв"	Счетчик	A1140-05-RAL-BW-4T		0,5S/1,0	1	33786-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	С	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
1794	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. "Дом"	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТК-20	0,5	50/5	1407-60		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	1	50/5	6891-85		
1795	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 1 ОПХ Восход	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1796	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 6 ОПХ Восход	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-08		
1797	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 5	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1798	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 7	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1799	ЭЧЭ-9 Лопарская, ВВ-ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1800	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 9 (резерв)	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1801	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
1802	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 4	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1803	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Вв-1-110 /Т-3 /	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1804	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Вв-2-110кВ. /Т-4 /	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1805	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Т-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
1806	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-127	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
1807	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-128	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1808	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-138	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1809	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
1810	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5	59870-15		
1811	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ЛМ-61	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	A	ТФНД-35	0,5	40/5	3689-73		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТФНД-35	0,5	40/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1812	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1813	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1814	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф3.ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1815	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.7	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1816	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10	A	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН		B					
		ТН		C					
		ТТ	ТЛК-10	A	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	-	B					
		ТТ	ТЛК-10	C	0,5	100/5	9143-01		
1817	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10	A	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН		B					
		ТН		C					
		ТТ	ТЛК-10	A	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-	B					
		ТТ	ТЛК-10	C	0,5	50/5	9143-01		
1818	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10	A	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН		B					
		ТН		C					
		ТТ	ТЛК-10	A	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-	B					
		ТТ	ТЛК-10	C	0,5	50/5	9143-01		
1819	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.4 ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10	A	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН		B					
		ТН		C					
		ТТ	ТЛК-10	A	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-	B					
		ТТ	ТЛК-10	C	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1820	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1821	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.2	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
1822	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-Т-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1823	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-1-110/Т-1	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1824	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-2-110/Т-3	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1825	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-119	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1826	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-137	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1827	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-139	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1828	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-70	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1829	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-110	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1830	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-118	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1831	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1832	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1833	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
1834	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
1835	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ф. 5 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1836	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 9 КТП	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1837	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 1 ТП-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1838	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 7 ТП-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5	9143-01		
1839	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 3 ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1840	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1841	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ф. 6 ТП-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1842	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 2 ТП-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1843	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 4 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1844	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
1845	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ф. Резерв	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
1846	ЭЧЭ-13 Имандра, Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
1847	ЭЧЭ-13 Имандра, Т-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1848	ЭЧЭ-13 Имандра, Л-144	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1849	ЭЧЭ-13 Имандра, Л-146	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1850	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. 1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
		ТТ	B	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
1851	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. 2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ	B	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1852	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. ВВ-ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1853	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-110 кВ (Т-1)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1854	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-110 кВ (Т-3)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1855	ЭЧЭ-14 Апатиты, Л-114	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1856	ЭЧЭ-14 Апатиты, Л-115	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1857	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4W		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					
1858	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					
1859	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1860	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1861	ЭЧЭ-14 Апатиты, ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1862	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. ПЭ-3	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1863	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 7	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1864	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
1865	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 11	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
1866	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 9	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
1867	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 6	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1868	ЭЧЭ-14 Апатиты, ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1869	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. ВВ-ПЭ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
1870	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 2	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
1871	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 8	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1872	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
1873	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 4 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
1874	ЭЧЭ-16 Питкуль, Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1875	ЭЧЭ-16 Питкуль, Т-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1876	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-111	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1877	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-112	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1878	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-114	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1879	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-115	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1880	РТП-58 Кица, ВВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
1881	РТП-58 Кица, Ф. 3 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1882	РТП-58 Кица, Ф. 5 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1883	РТП-58 Кица, Ф. 7	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1884	РТП-58 Кица, Ф . 4 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1885	РТП-58 Кица, Ф. 6	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1886	РТП-58 Кица, ВВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	B	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
1887	РТП-58 Кица, Ф. 8 ДСС	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	50/5	51679-12		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	50/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1888	РТП-58 Кица, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
1889	РТП-58 Кица, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
1890	РТП-58 Кица, СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
1891	ЭЧЭ-60 Хибины, Л-109	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1892	ЭЧЭ-60 Хибины, Л-146	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
1893	ЭЧЭ-60 Хибины, ВВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1894	ЭЧЭ-60 Хибины, ВВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1895	ЭЧЭ-60 Хибины, Ф. 3 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1896	ЭЧЭ-60 Хибины, Ф. 4 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
1897	ЭЧЭ-60 Хибины, Ф. 1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1898	ЭЧЭ-60 Хибины, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		
1899	ЭЧЭ-60 Хибины, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-40	0,5	800/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1900	ЭЧЭ-61 Африканда, ВВ-1-10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	B	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
1901	ЭЧЭ-61 Африканда, ВВ-2-10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	B	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
1902	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 3 - ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1903	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 1	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1904	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 5	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1905	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 4 - ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1906	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 2	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1907	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 6	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-00		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1908	ЭЧЭ-61 Африканда, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
1909	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
1910	ЭЧЭ-61 Африканда, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	B	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	C	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
1911	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. АБ-СЦБ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
1912	ПС-337 Пяйве, ВВ-35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
1913	ПС-343 Печенга, ВВ-35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
1914	ПС-410 Нял, ВВ-1-35 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
1915	ПС-410 Нял, ВВ-2-35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	40/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1916	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф.АБ-СЦБ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	40/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	40/5	1407-60		
1917	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ф. Энергосбыт	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
1918	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ввод-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
1919	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф-МРЦ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1920	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ПЭ-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
1921	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1922	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ввод-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
1923	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1924	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТП-57	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
1925	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф-4-10 ТП-СУД	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1926	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1927	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ф.3 ТП-42	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1928	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф.АБ-СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
1929	РТП-85 Ковда, РТП-85 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1930	РТП-85 Ковда, РТП-85 ПЭ-3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1931	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф. РРС	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1932	РТП-85 Ковда, РТП-85 Ввод-1 (10 кВ)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1933	РТП-85 Ковда, РТП-85 ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1934	РТП-85 Ковда, РТП-85 ПЭ-4	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1935	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф. Лесозаводский	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	B	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	C	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1936	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф.РН	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1937	РТП-85 Ковда, РТП-85 Ввод-2 (10 кВ)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1938	РТП-85 Ковда, РТП-85Л-85	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1939	РТП-85 Ковда, РТП-85 Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1940	РТП-85 Ковда, РТП-85 Л-86	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1941	РТП-85 Ковда, РТП-85 Т-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
1942	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1943	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1944	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Л-87	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1945	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Л-150	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
1946	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Обходной	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1947	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1948	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					
1949	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 Т-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1950	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 Т-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1951	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1952	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1953	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ДПР-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1954	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-5	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	20/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	20/5	25433-06		
1955	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-1	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	40/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	40/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1956	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-3	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	40/5	25433-06		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	40/5	25433-06		
1957	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1958	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1959	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-2	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1960	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-4	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
1961	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ЖД-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1962	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ЖД-2	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1963	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ПЭ-Север	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1964	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ф.Лок. Депо	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1965	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ф. Пост. ЭЦ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1966	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
1967	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1968	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-149	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1969	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-153	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1970	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-154	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1971	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-199	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1972	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-198	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1973	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 В0-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1974	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48А ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1975	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48А ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1976	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48а ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	С	-					
1977	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48а ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	С	-					
1978	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	В	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	С	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		
1979	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	В	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	С	ТФЗМ 110Б	0,5	600/5	24811-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1980	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1981	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	B	ТФЗМ 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	C	-					
1982	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ввод-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
1983	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ввод-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1984	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф3-10 ПС69	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-03		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-03		
1985	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ф.1 ТП Станция	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1986	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1987	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф. 1 ПЭ Юг	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1988	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф6-10 ПС69	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
1989	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ф.2 ТП Станция	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1990	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1991	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф.2 ПЭ Север	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1992	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ЛЭП Уполокша	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01		
1993	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
1994	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
1995	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Л-85	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1996	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Л-145	Счетчик	EA02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
1997	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1998	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-2-10	Счетчик	EA05RAL-P3B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1999	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЭ-4	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2000	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЭ-3	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2001	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2002	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2003	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЧ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2004	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-1-27.5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					
2005	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-2-27.5	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-					
2006	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ф. АБ-СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТШ-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	B	ТШ-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	C	ТШ-20	0,5	200/5	1407-60		
2007	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Пояконда Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2008	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Т-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
2009	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Л-86	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
2010	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Л-87	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
2011	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Ввод-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2012	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Ввод-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
2013	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2014	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2015	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-99		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2016	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.РН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2017	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.РН-3	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2018	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ББС	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
2019	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S	1	14555-95		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
2020	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.АБ-СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	ТК-20	0,5	150/5	1407-60	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТК-20	0,5	150/5	1407-60		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

4 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 3, 6, 7, 9 – 18, 21 – 23, 25 – 52, 55, 63, 65, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 85, 88, 89, 94, 97– 116, 123, 133 – 153, 158, 162, 164, 165, 167, 169 – 174, 179 – 182, 192 – 196, 206, 208 – 210, 212 – 215, 217, 220 – 225, 227, 229 – 237, 239, 245, 247 – 250, 253, 256 – 258, 260 – 271, 275 – 285, 290, 291, 293 – 296, 302 – 307, 313, 314, 321, 323, 324, 327 – 363, 372, 373, 375 – 380, 384 – 427, 432, 433, 437, 441 – 444, 447 – 451, 453 – 456, 464 – 467, 469, 472, 474, 483 – 486, 492, 493, 495 – 498, 505 – 508, 520, 521, 525 – 549, 552 – 555, 560 – 565, 568, 570 – 576, 578, 580 – 583, 585, 587, 590, 591, 593, 595 – 601, 603, 606, 607, 609 – 614, 617 – 621, 623, 625 – 630, 634 – 637, 642 – 644, 649, 650, 653 – 662, 665 – 668, 674 – 677, 679 – 682, 684, 686 – 689, 696, 698, 701 – 706, 713, 714, 716, 722, 727, 732, 733, 741 – 743, 753, 754, 761, 762, 770, 771, 773, 780 – 783, 799 – 801, 811 – 814, 816, 819 – 823, 829 – 831, 834 – 837, 854 – 856, 859, 861, 865 – 868, 870 – 886, 889, 893, 894, 903 – 920, 922 – 947, 950 – 953, 957, 958, 960, 963, 964, 975 – 981, 984, 985, 988, 995, 996, 998, 1000, 1002, 1006, 1008, 1010 – 1012, 1015, 1017, 1019 – 1021, 1023, 1025, 1027 – 1045, 1051 – 1059, 1061 – 1064, 1071 – 1076, 1078 – 1084, 1086 – 1090, 1092, 1093, 1095 – 1100, 1107 – 1113, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1127, 1129 – 1132, 1135 – 1151, 1155 – 1158, 1166, 1167, 1174, 1183, 1184, 1197, 1200, 1201, 1210 – 1216, 1221 – 1224, 1227, 1231 – 1254, 1268 – 1272, 1274 – 1277, 1279 – 1282, 1285 – 1288, 1295, 1302 – 1305, 1312, 1323 – 1326, 1334 – 1337, 1339, 1340, 1342 – 1352, 1354 – 1359, 1364, 1365, 1369, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382 – 1385, 1392 – 1395, 1400, 1402 – 1408, 1411, 1413 – 1418, 1425 – 1427, 1432, 1433, 1435, 1440 – 1465, 1468 – 1474, 1477 – 1490, 1493 – 1497, 1506, 1508 – 1516, 1520 – 1522, 1531 – 1538, 1547, 1549 – 1552, 1554, 1555, 1557, 1564 – 1573, 1579, 1580, 1586, 1589, 1591 – 1593, 1595, 1598 – 1604, 1606, 1617, 1620 – 1631, 1634 – 1637, 1639 – 1642, 1645 – 1679, 1681 – 1692, 1694, 1695, 1698, 1699, 1703 – 1712, 1717, 1718, 1731, 1746 – 1752, 1754 – 1757, 1759, 1764 – 1770, 1773 – 1775, 1783, 1787, 1788, 1793, 1794, 1798, 1801, 1803 – 1808, 1810, 1816 – 1818, 1821 – 1830, 1833, 1836 – 1842, 1845 – 1851,

1853 – 1858, 1870, 1874 – 1881, 1886, 1888 – 1901, 1908 – 1915, 1917 – 1919, 1922, 1926, 1928 – 1960, 1962, 1963, 1965, 1968 – 1983, 1993 – 1998, 2001, 2004, 2005, 2007 – 2010, 2018 активная, реактивная; для ИК № 4, 5, 8, 19, 20, 24, 53, 54, 56 – 62, 64, 66 -69, 72, 74, 76 – 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90 – 93, 95, 96, 117 – 122, 124 – 132, 154 – 157, 159 – 161, 163, 166, 168, 175 – 178, 183 – 191, 197 – 205, 207, 211, 216, 218, 219, 226, 228, 238, 240 – 244, 246, 251, 252, 254, 255, 259, 272 – 274, 286 – 289, 292, 297 – 301, 308 – 312, 315 – 320, 322, 325, 326, 364 – 371, 374, 381 – 383, 428 – 431, 434 – 436, 438 – 440, 445, 446, 452, 457 – 463, 468, 470, 471, 473, 475 – 482, 487 – 491, 494, 499 – 504, 509 – 519, 522 – 524, 550, 551, 556 – 559, 566, 567, 569, 577, 579, 584, 586, 588, 589, 592, 594, 602, 604, 605, 608, 615, 616, 622, 624, 631 – 633, 638 – 641, 645 – 648, 651, 652, 663, 664, 669 – 673, 678, 683, 685, 690 – 695, 697, 699, 700, 707 – 712, 715, 717 – 721, 723 – 726, 728 – 731, 734 – 740, 744 – 752, 755 – 760, 763 – 769, 772, 774 – 779, 784 – 798, 802 – 810, 815, 817, 818, 824 – 828, 832, 833, 838 – 853, 857, 858, 860, 862 – 864, 869, 887, 888, 890 – 892, 895 – 902, 921, 948, 949, 954 – 956, 959, 961, 962, 965 – 974, 982, 983, 986, 987, 989 – 994, 997, 999, 1001, 1003 – 1005, 1007, 1009, 1013, 1014, 1016, 1018, 1022, 1024, 1026, 1046 – 1050, 1060, 1065 – 1070, 1077, 1085, 1091, 1094, 1101 – 1106, 1114 – 1116, 1119, 1122, 1124 – 1126, 1128, 1133, 1134, 1152 – 1154, 1159 – 1165, 1168 – 1173, 1175 – 1182, 1185 – 1196, 1198, 1199, 1202 – 1209, 1217 – 1220, 1225, 1226, 1228 – 1230, 1255 – 1267, 1273, 1278, 1283, 1284, 1289 – 1294, 1296 – 1301, 1306 – 1311, 1313 – 1322, 1327 – 1333, 1338, 1341, 1353, 1360 – 1363, 1366 – 1368, 1370, 1372, 1373, 1376, 1377, 1380, 1381, 1386 – 1391, 1396 – 1399, 1401, 1409, 1410, 1412, 1419 – 1424, 1428 – 1431, 1434,1436 – 1439, 1466, 1467, 1475, 1476, 1491, 1492, 1498 – 1505, 1507, 1517 – 1519, 1523 – 1530, 1539 – 1546, 1548, 1553, 1556, 1558 – 1563, 1574 – 1578, 1581 – 1585, 1587, 1588, 1590, 1594, 1596, 1597, 1605, 1607 – 1616, 1618, 1619, 1632, 1633, 1638, 1643, 1644, 1680, 1693, 1696, 1697, 1700 – 1702, 1713 – 1716, 1719 – 1730, 1732 – 1745, 1753, 1758, 1760 – 1763, 1771, 1772, 1776 – 1782, 1784 – 1786, 1789 – 1792, 1795 – 1797, 1799, 1800, 1802, 1809, 1811 – 1815, 1819, 1820, 1831, 1832, 1834, 1835, 1843,1844, 1852, 1859 – 1869, 1871 – 1873, 1882 – 1885, 1887, 1902 – 1907, 1916, 1920, 1921, 1923 – 1925, 1927, 1961, 1964, 1966, 1967, 1984 – 1992, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2011 – 2017, 2019, 2020 активная.

Таблица 4 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электро-энергии	Границы основной погрешности (±δ), %	Границы погрешности в рабочих условиях (±δ), %
1	2	3	4
1 – 13, 16 – 22, 24, 25, 27 – 58, 70 – 80, 88 – 96, 100 – 128, 133 – 148, 152 – 165, 169 – 174, 180 – 188, 192 – 203, 209, 210, 212 – 225, 229 – 233, 236, 237, 239, 240, 243 – 245, 247 – 256, 261 – 271, 275 – 281, 283 – 289, 293 – 300, 304 – 307, 311 – 368, 372 – 380, 384 – 391, 396 – 416, 419, 420, 423 – 427, 429 – 435, 437 – 440, 442 – 445, 447 – 452, 454 – 480, 483 – 489, 495 – 501, 505, 506, 508 – 521, 525 – 550, 552 – 566, 570 – 589, 593 – 609, 612 – 621, 625 – 637, 642 – 650, 653 – 674, 679 – 689, 692 – 709, 713 – 719, 722 – 728, 732 – 738, 741 – 749, 753 – 758, 761 – 766, 770 – 776, 780 – 787, 794 – 807, 811 – 818, 822 – 828, 832 – 840, 844 – 850, 854 – 862, 865 – 868, 870 – 879, 883 – 897, 901 – 920, 927 – 947, 950 – 964, 967, 969 – 981, 984 – 991, 995 – 998, 1000 – 1012, 1015 – 1048, 1051 – 1059, 1063, 1064, 1067 – 1076, 1078 – 1081, 1083 – 1086, 1089 – 1094, 1097 – 1104, 1107 – 1110, 1112, 1114, 1115, 1117 – 1127, 1129 – 1136, 1139 – 1220, 1223 – 1228, 1231 – 1250, 1253 – 1264, 1269 – 1280, 1287 – 1300, 1305, 1308 – 1320, 1324 – 1330, 1334 – 1352, 1356 – 1371, 1374 – 1379, 1382 – 1389, 1392 – 1399, 1402 – 1412, 1415 – 1422, 1425 – 1439, 1442 – 1460, 1464 – 1469, 1473 – 1479, 1483 – 1489, 1491 – 1504, 1508 – 1527, 1531 – 1543, 1549 – 1561, 1564 – 1568, 1572 – 1587, 1591 – 1595, 1599 – 1617, 1621 – 1642, 1646 – 1662, 1666 – 1683, 1687 – 1700, 1704 – 1726, 1730 – 1743, 1747 – 1761, 1765 – 1793, 1795 – 1887, 1891 – 1897, 1900 – 1907, 1912 – 1915, 1918 – 1927, 1929 – 2005, 2007 – 2019	Активная	1,2	5,7

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 16 – 18, 21, 22, 25, 27 – 52, 55, 70, 71, 73, 75, 80, 88, 89, 94, 100 – 116, 123, 133 – 148, 152, 153, 158, 162, 164, 165, 169 – 174, 180 – 182, 192 – 196, 209, 210, 212 – 215, 217, 220 – 225, 229 – 233, 236, 237, 239, 245, 247 – 250, 253, 256, 261 – 271, 275 – 281, 283 – 285, 293 – 296, 304 – 307, 313, 314, 321, 323, 324, 327 – 363, 372, 373, 375 – 380, 384 – 391, 396 – 416, 419, 420, 423 – 427, 432, 433, 437, 442 – 444, 447 – 451, 454 – 456, 464 – 467, 469, 472, 474, 483 – 486, 495 – 498, 505, 506, 508, 520, 521, 525 – 549, 552 – 555, 560 – 565, 570 – 576, 578, 580 – 583, 585, 587, 593, 595 – 601, 603, 606, 607, 609, 612 – 614, 617 – 621, 625 – 630, 634 – 637, 642 – 644, 649, 650, 653 – 662, 665 – 668, 674, 679 – 682, 684, 686 – 689, 696, 698, 701 – 706, 713, 714, 716, 722, 727, 732, 733,741 – 743, 753, 754, 761, 762, 770, 771, 773, 780 – 783, 799 – 801, 811 – 814, 816, 822, 823, 834 – 837, 854 – 856, 859, 861, 865 – 868, 870 – 879, 883 – 886, 889, 893, 894, 903 – 920, 927 – 947, 950 – 953, 957, 958, 960, 963, 964, 975 – 981, 984, 985, 988, 995, 996, 998, 1000, 1002, 1006, 1008, 1010 – 1012, 1015, 1017, 1019 – 1021, 1023, 1025, 1027 – 1045, 1051 – 1059, 1063, 1064, 1071 – 1076, 1078 – 1081, 1083, 1084, 1086, 1089, 1090, 1092, 1093, 1097 – 1100, 1107 – 1110, 1112, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1127, 1129 – 1132, 1135, 1136, 1139 – 1151, 1155 – 1158, 1166, 1167, 1174, 1183, 1184, 1197, 1200, 1201, 1210 – 1216, 1223, 1224, 1227, 1231 – 1250, 1253, 1254, 1269 – 1272, 1274 – 1277, 1279, 1280, 1287, 1288, 1295, 1305, 1312, 1324 – 1326, 1334 – 1337, 1339, 1340, 1342 – 1352, 1356 – 1359, 1364, 1365, 1369, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382 – 1385, 1392 – 1395, 1402 – 1408, 1411, 1415 – 1418, 1425 – 1427, 1432, 1433, 1435, 1442 – 1460, 1464, 1465, 1468, 1469, 1473, 1474, 1477 – 1479, 1483 – 1489, 1493 – 1497, 1508 – 1516, 1520 – 1522, 1531 – 1538, 1549 – 1552, 1554, 1555, 1557, 1564 – 1568, 1572, 1573, 1579, 1580, 1586, 1591 – 1593, 1595, 1599 – 1604, 1606, 1617, 1621 – 1631, 1634 – 1637, 1639 – 1642, 1646 – 1662, 1666 – 1679, 1681 – 1683, 1687 – 1692, 1694, 1695, 1698, 1699, 1704 – 1712, 1717, 1718, 1731, 1747 – 1752, 1754 – 1757, 1759, 1765 – 1770, 1773 – 1775, 1783, 1787, 1788, 1793, 1798, 1801, 1803 – 1808, 1810, 1816 – 1818, 1821 – 1830, 1833, 1836 – 1842, 1845 – 1851, 1853 – 1858, 1870, 1874 – 1881, 1886, 1891 – 1897, 1900, 1901, 1912 – 1915, 1918, 1919, 1922, 1926, 1929 – 1960, 1962, 1963, 1965, 1968 – 1983, 1993 – 1998, 2001, 2004, 2005, 2007 – 2010, 2018	Реактивная	2,5	4,1

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
14, 15, 23, 26, 59 – 69, 81 – 87, 97 – 99, 129 – 132, 149 – 151, 166 – 168, 175 – 179, 189 – 191, 204 – 208, 211, 226 – 228, 234, 235, 238, 241, 242, 246, 257 – 260, 272 – 274, 282, 290 – 292, 301 – 303, 308 – 310, 369 – 371, 381 – 383, 392 – 395, 417, 418, 421, 422, 428, 436, 441, 446, 453, 481, 482, 490 – 494, 502 – 504, 507, 522 – 524, 551, 567 – 569, 590 – 592, 610, 611, 622 – 624, 638 – 641, 651, 652, 675 – 678, 690, 691, 710 – 712, 720, 721, 729 – 731, 739, 740, 750 – 752, 759, 760, 767 – 769, 777 – 779, 788 – 793, 808 – 810, 819 – 821, 829 – 831, 841 – 843, 851 – 853, 863, 864, 869, 880 – 882, 898 – 900, 921, 922, 924 – 926, 948, 965, 966, 982, 983, 992 – 994, 999, 1013, 1014, 1049, 1050, 1060 – 1062, 1065, 1066, 1077, 1082, 1087, 1088, 1095, 1096, 1105, 1106, 1128, 1137, 1138, 1221, 1222, 1229, 1230, 1251, 1252, 1265 – 1268, 1281 – 1286, 1301 – 1304, 1321 – 1323, 1331 – 1333, 1353 – 1355, 1372, 1373, 1380, 1381, 1390, 1391, 1400, 1401, 1413, 1414, 1423, 1424, 1440, 1441, 1461 – 1463, 1470 – 1472, 1480 – 1482, 1490, 1505 – 1507, 1528 – 1530, 1544 – 1548, 1562, 1563, 1569 – 1571, 1588 – 1590, 1596 – 1598, 1618 – 1620, 1643, 1644, 1663, 1664, 1684, 1685, 1701 – 1703, 1727 – 1729, 1744 – 1746, 1762 – 1764, 1888 – 1890, 1898, 1899, 1908 – 1911, 1916, 1917, 1928, 2006, 2020	Активная	1,0	5,6
14, 15, 23, 26, 63, 65, 82, 85, 97 – 99, 149 – 151, 167, 179, 206, 208, 227, 234, 235, 257, 258, 260, 282, 290, 291, 302, 303, 392 – 395, 417, 418, 421, 422,441, 453, 492, 493, 507, 568, 590, 591, 610, 611, 623, 675 – 677, 819 – 821, 829 – 831, 880 – 882, 922, 924 – 926, 1061, 1062, 1082, 1087, 1088, 1095, 1096, 1137, 1138, 1221, 1222, 1251, 1252, 1268, 1281, 1282, 1285, 1286, 1302 – 1304, 1323, 1354, 1355, 1400, 1413, 1414, 1440, 1441, 1461 – 1463, 1470 – 1472, 1480 – 1482, 1490, 1506, 1547, 1569 – 1571, 1589, 1598, 1620, 1663, 1664, 1684, 1685, 1703, 1746, 1764, 1888 – 1890, 1898, 1899, 1908 – 1911, 1917, 1928	Реактивная	2,1	4,0
968, 1111, 1113, 1306, 1307	Активная	1,8	10,7
1111, 1113	Реактивная	3,9	5,8
923, 949, 1116, 1645, 1665, 1686, 1794	Активная	1,7	10,6

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
923, 1645, 1665, 1686, 1794	Реактивная	3,7	5,7
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), (±Δ), с			5

Примечания

1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 5% $I_{ном}$ cosφ = 0,5 инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°С.

3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия:	
параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{ном}$	от 99 до 101
- ток, % от $I_{ном}$	100
- коэффициент мощности	0,87
- частота, Гц	от 49,85 до 50,15
температура окружающей среды, °С:	
- для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94	от +21 до +25
- для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005	от +21 до +25
ГОСТ 26035-83	от +18 до +22
Рабочие условия:	
параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{ном}$	от 90 до 110
- ток, % от $I_{ном}$	от 1(5) до 120
- коэффициент мощности, не менее	0,5
- частота, Гц	от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С:	
- для ТТ и ТН	от -45 до +40
- для счетчиков	от +5 до +35
- для УСПД	от +10 до +25
- для сервера, УССВ	от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа:	
- срок службы, лет, не менее	30
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии Альфа А1140:	
- средняя наработка до отказа, ч, не менее	150000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72

Продолжение таблицы 5

1	2
счетчики электроэнергии Альфа А1800:	
- средняя наработка до отказа, ч, не менее	120000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97):	
- средняя наработка на отказ, ч, не менее	50000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07):	
- средняя наработка на отказ, ч, не менее	80000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии SL7000:	
- средний срок службы, лет	20
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
УСПД ЭКОМ-3000:	
- средняя наработка до отказа, ч, не менее	75000
УСПД RTU-327:	
- средняя наработка до отказа, ч, не менее	35000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г:	
- средняя наработка на отказ, ч, не менее	22000
- время восстановления, ч	2
устройство синхронизации времени УСВ-3:	
- среднее время наработки на отказ, ч	45000
- время восстановления, ч	2
Глубина хранения информации	
счетчики электроэнергии:	
- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД:	
- суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее	45
при отключенном питании, лет, не менее	3
ИВК:	
- результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

− защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

− резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

− журнал счетчика:
  − параметрирования;
  − пропадания напряжения;
  − коррекции времени в счетчике;
− журнал УСПД:
  − параметрирования;

- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках и УСПД;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:
- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электрической энергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - счетчиков электрической энергии;
  - УСПД.

Возможность коррекции времени в:
- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:
- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:
- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений
Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	ТЛО-10	789 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10	339 шт.
Трансформатор тока	ТШП 0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	92 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-60	6 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	40 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	487 шт.
Трансформатор тока	ТШ-0,66	2 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-40	12 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-30	6 шт.
Трансформатор тока	ТШ-0,66 У3	4 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ 10	25 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10	209 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66	112 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-А УХЛ3	1 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	634 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10	12 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11С	63 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-А	3 шт.
Трансформатор тока	ТСН-6	27 шт.
Трансформатор тока	ТК-20	69 шт.
Трансформатор тока	ТРО 7	18 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	19 шт.
Трансформатор тока	ТСН-8	27 шт.
Трансформатор тока	ТРО 7	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 У2	2 шт.
Трансформатор тока	STSM-38	12 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	4 шт.
Трансформатор тока	ТВК-10	24 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2 шт.
Трансформатор тока	ТШП 0,66	12 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	36 шт.
Трансформатор тока	ТГФ-220-II* УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66 УХЛ3	3 шт.
Трансформатор тока	AN 36/250	6 шт.
Трансформатор тока	GIF-30-45	22 шт.
Трансформатор тока	ТОП 0,66	3 шт.
Трансформатор тока	О-49	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	14 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III УХЛ1*	21 шт.
Трансформатор тока	TPU 40.21	10 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35М	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	17 шт.
Трансформатор тока	VAU-123	48 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	RM60N-E4A	9 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	TG 145N УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	TPU 40.41	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	36 шт.
Трансформатор тока	IMB 123	9 шт.
Трансформатор тока	IMB 145	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35III-II УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66 М У3	6 шт.
Трансформатор тока	4МС7	33 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	5 шт.
Трансформатор тока	ТК-40	29 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110-УХЛ1	70 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10	45 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	40 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	3 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35М	11 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35	4 шт.
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	90 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35	28 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35-III	2 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1	16 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-1 У3	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	51 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-2 У3	18 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-I У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-2 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10 У3	6 шт.
Трансформатор тока	GIF 40,5	6 шт.
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	34 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТПФ-10	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛУ-10	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5 У3	45 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66У3	33 шт.
Трансформатор тока	IMB 245	15 шт.
Трансформатор тока	ТСН-6.2	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-6 У3	79 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-2 У3	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-4 У3	144 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-35-II	30 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-05 УХЛ1	4 шт.
Трансформатор тока	ТГМ-110 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-23	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-24	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1 У3	54 шт.
Трансформатор тока	ТПФМУ-10	3 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	13 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10 4	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-6	136 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35/25	21 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35	21 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1	35 шт.
Трансформатор тока	ТГМ-35 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	26 шт.
Трансформатор тока	ТШ-20	2 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35/10	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-I У1	1 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IУ1	13 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 У3	19 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-1	21 шт.
Трансформатор тока	ТОП М-0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	ТШП М-0,66 У3	18 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-I	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-I-2 У2	4 шт.
Трансформатор тока	TG 145	19 шт.
Трансформатор тока	ТВ 35-II ХЛ2	18 шт.
Трансформатор тока	ТРО 70.11	31 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21	2 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	RM85-E6A	12 шт.
Трансформатор тока	RM60-E4A	3 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-220-II У1	15 шт.
Трансформатор тока	ТОП 0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	TG-245	6 шт.
Трансформатор тока	ТНШЛ-0,66	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 35	8 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35-II ХЛ2	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-220	6 шт.
Трансформатор тока	RM85-E5A	6 шт.
Трансформатор тока	RM70-E4A	3 шт.
Трансформатор тока	TG 145 У1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220 III УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-5	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5	2 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110-II У1	9 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6 шт.
Трансформатор тока	TPU 40.11	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-6	2 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110-II	20 шт.
Трансформатор тока	ТВ 35-II	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ35А-ХЛ1	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	6 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35	2 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-У1	18 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б	6 шт.
Трансформатор тока	ТШ-20	3 шт.
Трансформатор напряжения	SVAS 123	6 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 У2	2 шт.
Трансформатор напряжения	3НОЛП-ЭК-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	70 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	352 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 УХЛ2	41 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	28 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	164 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	7 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	25 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10 У2	18 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	119 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	40 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-1 УХЛ2	1 шт.
Трансформатор напряжения	NTSM-38	21 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-6	7 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	21 шт.
Трансформатор напряжения	CPA 123	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМ-10	3 шт.
Трансформатор напряжения	VAU-123	48 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	4MT40,5	12 шт.
Трансформатор напряжения	4MU4	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	5 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	5 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	32 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	5 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-10-66	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	19 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	94 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	6 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ 220-58 У1	12 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10 У3	2 шт.
Трансформатор напряжения	CPA 245	6 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	61 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4	481 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05L-B-3	344 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-4	65 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-3	113 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P3B-4	53 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-4	95 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-3	72 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3B-4	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-3-0L-C25-T	58 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05L-B-4	147 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P4B-4W	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	11 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	20 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	35 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	14 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALXQ-P4G-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALX-P4GB-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RALX-P3B-4	76 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	216 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-GS-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3BN-3	14 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	12 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P4B-3	19 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLXQ-P4G-DW-4	4 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-GS-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLXQ-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-B-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-4-0L-C25-T	8 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4W	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLQ-P4GB-DW-4	5 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3B-3	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P4B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-4-0L-C25-T+	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P3B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1R-4-AL-C25-T	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1R-4-AL-C29-T	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-3-AL-C29-T	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P2B-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALXQV-P4GB-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	SL761DCB	7 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P2CN-4W	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1140-05-RAL-BW-4T	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4G-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-3	1 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	9 шт.
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	9 шт.
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Формуляр	71319484.411711.001.34. ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Телефон: +7 (495) 544-00-00
Web-сайт: www.rostest.ru
E-mail: info@rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87522-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС

Назначение средства измерений

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС (далее – резервуары) предназначены для измерений объема, а также приема, хранения и отпуска нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м^3.

Описание средства измерений

Резервуары представляют собой стальные горизонтальные сосуды с обечайкой цилиндрической формы и коническими или усеченно-коническими днищами.

Заполнение и выдача нефтепродукта производится через приемный и раздаточный патрубки. Каждый резервуар оборудован эксплуатационной горловиной, на крышке которой установлен замерный люк, использующийся для отбора проб нефтепродуктов и измерения уровня наполнения резервуара.

Принцип действия резервуаров основан на измерении объема нефтепродуктов в зависимости от уровня наполнения.

К данному типу резервуаров относятся пять модификации, различающиеся номинальной вместимостью и типом расположения:

РГСН-5 – резервуар наземный с номинальной вместимостью 5 м^3, с заводскими номерами №№ 15, 88;

РГСН-10 – резервуар наземный с номинальной вместимостью 10 м^3, с заводскими номерами №№ 74, 139, 140;

РГСП-10 – резервуар подземный с номинальной вместимостью 10 м^3, с заводскими номерами №№ 125, 126;

РГСН-25 – резервуар наземный, с номинальной вместимостью 25 м^3, с заводскими номерами №№ 16, 17;

РГСН-50 – резервуар наземный, с номинальной вместимостью 50 м^3, с заводскими номерами №№ 72, 73, 78, 232.

Резервуары модификаций РГСН-5, РГСН-10, РГСН-25 смонтированы в контейнере.

Нанесение знака поверки на резервуары не предусмотрено.

Заводские номера, идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений, нанесены на маркировочную табличку резервуара ударным способом и в технические паспорта резервуаров печатным способом.

Общий вид резервуаров горизонтальных стальных цилиндрических РГС с указанием места нанесения заводского номера представлен на рисунках 1 и 2.

Внешний вид маркировочной таблички представлен на рисунке 3.

Рисунок 1 - Общий вид резервуаров модификаций РГСН-5, РГСН-10, РГСН-25

Рисунок 2 - Общий вид резервуаров модификаций РГСН-50

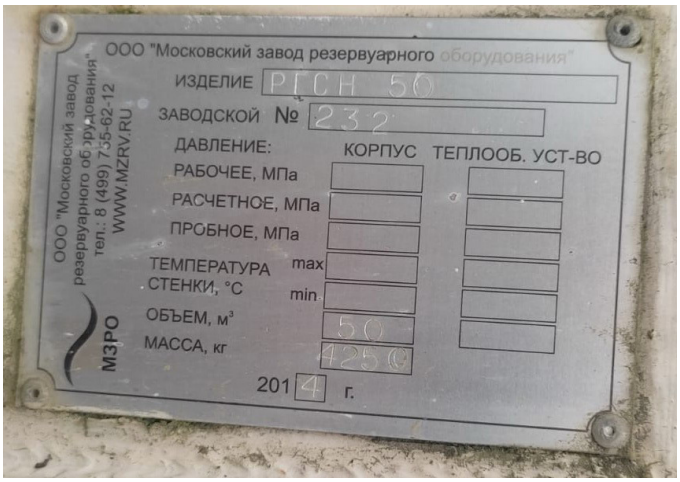

Рисунок 3 – Общий вид маркировочной таблички резервуара

Пломбирование резервуаров не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость резервуара при температуре 20 °С, $м^3$: - модификация РГСН-5 - модификации РГСН-10, РГСП-10 - модификация РГСН-25 - модификация РГСН-50	 5 10 25 50
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара, %	±0,25

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С	 от -40 до +40

Знак утверждения типа наносится
на титульный лист паспорта резервуара типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на резервуар не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический	РГС	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 1 «Общие сведения об изделии» паспорта

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод резервуарного оборудования» (ООО «МЗРО»)
ИНН 7733808031
Адрес: 125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16
Телефон/факс: +7(495)740-53-60
E-mail: info@mzro.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод резервуарного оборудования» (ООО «МЗРО»)
ИНН 7733808031
Адрес: 125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16
Телефон/факс: +7(495)740-53-60
E-mail: info@mzro.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)
Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Адрес осуществления деятельности: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Дзержинского, д. 2
Телефон: +7 (496) 242-41-62
Факс: +7 (496) 247-70-70
Web-сайт: www.rostest.ru
E-mail: info.kln@rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87523-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока программируемые IT6000

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока программируемые IT6000 (далее - источники) предназначены для воспроизведений/измерений силы и напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия источников основан на преобразовании напряжения питания переменного тока в стабилизированные силу и напряжение постоянного тока. При этом напряжение сети выпрямляется и фильтруется. Полученные напряжение и сила постоянного тока измеряются и отображаются на дисплее.

Конструктивно источники выполнены в металлическом корпусе настольного исполнения. Индикация режимов работы, установленных значений напряжения и силы постоянного тока, осуществляется с помощью дисплея. Установка выходных параметров и управление режимами работы осуществляются с помощью функциональных клавиш и поворотного переключателя, расположенных на лицевой панели. На задней панели источников расположены аналоговые и цифровые интерфейсы связи, разъем для подключения к сети питания.

Источники выпускаются в следующих модификациях, отличающихся максимальными значениями воспроизведений силы, напряжения постоянного тока и выходной мощности: IT6005-80-150, IT6010-80-300, IT6015-80-450, IT6006-300-75, IT6012-300-150, IT6018-300-225, IT6006-500-40, IT6012-500-80, IT6018-500-120, IT6006-800-25, IT6012-800-50, IT6018-800-75, IT6018-1500-40, IT6018-2250-25.

Источники выпускаются в исполнениях B, C, D. Источники питания исполнения B и C являются двунаправленными и отличаются наличием встроенной электронной нагрузки, поддержкой функции симуляции вольт-амперной характеристики (далее – ВАХ) солнечных батарей и функции симуляции батарей. Источники питания исполнения B поддерживают расширенный режим работы электронных нагрузок.

Для увеличения выходной мощности одинаковые модели источников питания могут работать в параллельном режиме. Допускается соединение до 64-х источников питания.

Серийный номер наносится на заднюю панель на маркировочную наклейку в виде цифрового кода.

Общий вид источников с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа представлен на рисунках 1 и 2. Нанесение знака поверки на источники не предусмотрено. Пломбирование мест настройки (регулировки) источников не предусмотрено.

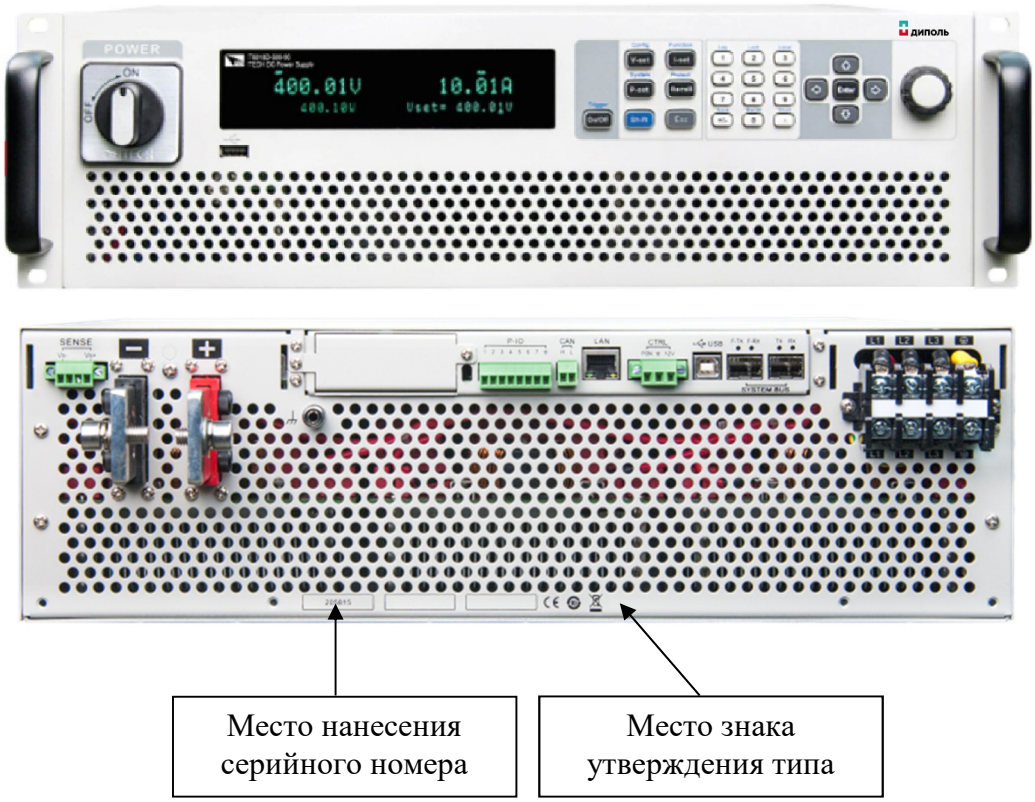

Рисунок 1 - Общий вид источников исполнений D, C с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа

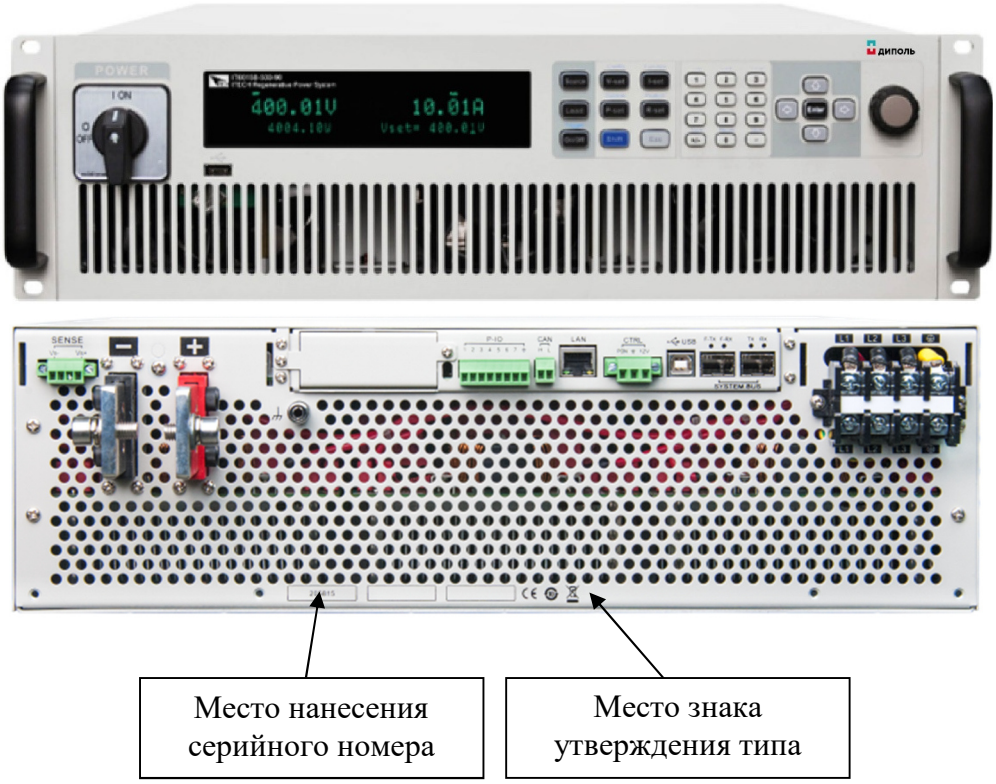

Рисунок 2 - Общий вид источников исполнения B с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) источников состоит из встроенного и внешнего ПО.

Встроенное ПО является метрологически значимым и служит для управления режимами работы источников, выбора встроенных измерительных и вспомогательных функций.

Метрологические характеристики источников нормированы с учетом влияния ПО.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Внешнее ПО представляет из себя встроенный Web-сервер для мониторинга и управления источниками через веб-браузер персонального компьютера (далее – ПК). Использование внешнего ПО осуществляется соединением источников к ПК через интерфейс связи LAN.

Идентификационные данные метрологически значимого встроенного ПО источников приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	V00.006.036
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Модификация источников	Диапазон воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/ измерений силы постоянного тока, А	Максимальная выходная мощность, Вт
IT6005-80-150	от 0 до 80	$\pm0{,}0002\cdot U$[1)]$+0{,}016$	от 0 до 150	$\pm0{,}001\cdot I$[4)]$+0{,}150$	5000
IT6010-80-300	от 0 до 80	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}016$	от 0 до 300	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}300$[5)]/ $\pm0{,}01\cdot I+0{,}300$[6)]	10000
IT6015-80-450	от 0 до 80	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}016$	от 0 до 450	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}450$[5)]/ $\pm0{,}015\cdot I+0{,}450$[6)]	15000
IT6006-300-75	от 0 до 300	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}060$	от 0 до 75	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}075$	6000
IT6012-300-150	от 0 до 300	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}060$	от 0 до 150	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}150$	12000
IT6018-300-225	от 0 до 300	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}060$	от 0 до 225	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}225$[5)]/ $\pm0{,}015\cdot I+0{,}225$[6)]	18000
IT6006-500-40	от 0 до 500	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}100$	от 0 до 40	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}040$	6000
IT6012-500-80	от 0 до 500	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}100$	от 0 до 80	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}080$	12000
IT6018-500-120	от 0 до 500	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}100$	от 0 до 120	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}120$	18000
IT6006-800-25	от 0 до 800	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}160$	от 0 до 25	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}025$	6000
IT6012-800-50	от 0 до 800	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}160$	от 0 до 50	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}050$	12000
IT6018-800-75	от 0 до 800	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}160$	от 0 до 75	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}075$	18000
IT6018-1500-40	от 0 до 1500	$\pm0{,}0002\cdot U+0{,}300$[2)] / $\pm0{,}015\cdot U+0{,}300$[3)]	от 0 до 40	$\pm0{,}001\cdot I+0{,}040$	18000

Модификация источников	Диапазон воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/ измерений силы постоянного тока, А	Максимальная выходная мощность, Вт
IT6018-2250-25	от 0 до 2250	$\pm 0{,}0002 \cdot U + 0{,}450$ [2] / $0{,}015 \cdot U + 0{,}450$ [3]	от 0 до 25	$\pm 0{,}001 \cdot I + 0{,}025$	18000

Примечания:
[1] U – воспроизводимое/измеренное значение напряжения постоянного тока, В;
[2] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока до 1000 В включ.;
[3] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока свыше 1000 В;
[4] I – воспроизводимое/измеренное значение силы постоянного тока, А;
[5] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений силы постоянного тока до 200 А включ.;
[6] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока св. 200 А.

Таблица 3 – Метрологические характеристики в режиме стабилизации напряжения

Модификация источников	Нестабильность выходного напряжения постоянного тока, В		Уровень пульсаций выходного напряжения постоянного тока, В[1], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении тока на нагрузке от $I_{макс}$ до $0{,}1 \cdot I_{макс}$ [2]	
IT6005-80-150	±0,008	±0,016	0,12
IT6010-80-300	±0,008	±0,016	0,12
IT6015-80-450	±0,008	±0,016	0,12
IT6006-300-75	±0,030	±0,060	0,12
IT6012-300-150	±0,030	±0,060	0,12
IT6018-300-225	±0,030	±0,060	0,12
IT6006-500-40	±0,050	±0,100	0,20
IT6012-500-80	±0,050	±0,100	0,20
IT6018-500-120	±0,050	±0,100	0,20
IT6006-800-25	±0,080	±0,160	0,80
IT6012-800-50	±0,080	±0,160	0,80
IT6018-800-75	±0,080	±0,160	0,80
IT6018-1500-40	±0,150	±0,300	0,60
IT6018-2250-25	±0,225	±0,450	0,90

Примечания:
[1] – среднеквадратическое значение/размах сигнала.
[2] $I_{макс}$ – максимальное значения силы постоянного тока на нагрузке.

Таблица 4 – Метрологические характеристики в режиме стабилизации силы тока

Модификация источников	Нестабильность выходного сигнала силы постоянного тока, А		Уровень пульсаций выходной силы постоянного тока, А[1)], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении напряжения на нагрузке от $U_{макс}$ до $0{,}1 \cdot U_{макс}$[3)]	
IT6005-80-150	0,075	0,075	$0{,}001 \cdot I$[2)]
IT6010-80-300	0,150	0,150	$0{,}001 \cdot I$
IT6015-80-450	0,225	0,225	$0{,}001 \cdot I$
IT6006-300-75	0,038	0,038	$0{,}001 \cdot I$
IT6012-300-150	0,075	0,075	$0{,}001 \cdot I$
IT6018-300-225	0,113	0,113	$0{,}001 \cdot I$
IT6006-500-40	0,020	0,020	$0{,}001 \cdot I$
IT6012-500-80	0,040	0,040	$0{,}001 \cdot I$
IT6018-500-120	0,060	0,060	$0{,}001 \cdot I$
IT6006-800-25	0,013	0,013	$0{,}001 \cdot I$
IT6012-800-50	0,025	0,025	$0{,}001 \cdot I$
IT6018-800-75	0,038	0,038	$0{,}001 \cdot I$
IT6018-1500-40	0,020	0,020	$0{,}001 \cdot I$
IT6018-2250-25	0,013	0,013	$0{,}001 \cdot I$

Примечания:
1) – среднеквадратическое значение;
2) I – воспроизводимое значение силы постоянного тока, А;
3) $U_{макс}$ – максимальное значения напряжения постоянного тока на нагрузке.

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	 380^{+148}_{-38} 50
Потребляемая мощность, В·А, не более	17000
Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более	155×805×485
Масса, кг, не более	40
Рабочие условия измерений: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %	 от 0 до +50 до 80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус источников любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Источник питания постоянного тока программируемый IT6000	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 2 «Осмотр и установка» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

«Источники питания постоянного тока программируемые IT6000. Стандарт предприятия» ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».

Правообладатель

ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай

Адрес юридического лица: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Изготовители

ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай

Адрес юридического лица: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Адрес места осуществления деятельности: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314019.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87524-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока программируемые IT6500

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока программируемые IT6500 (далее - источники) предназначены для воспроизведений/измерений силы и напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия источников основан на преобразовании напряжения питания переменного тока в стабилизированные силу и напряжение постоянного тока. При этом напряжение сети выпрямляется и фильтруется. Полученные напряжение и сила постоянного тока измеряются и отображаются на дисплее.

Конструктивно источники выполнены в металлическом корпусе настольного исполнения. Индикация режимов работы, установленных значений напряжения и силы постоянного тока, осуществляется с помощью дисплея. Установка выходных параметров и управление режимами работы осуществляются с помощью функциональных клавиш и поворотного переключателя, расположенных на лицевой панели. На задней панели источников расположены аналоговые и цифровые интерфейсы связи, разъем для подключения к сети питания.

Источники выпускаются в следующих модификациях, отличающихся максимальными значениями воспроизведений/измерений силы, напряжения постоянного тока и воспроизводимой мощности: IT6512, IT6513, IT6514, IT6515, IT6516, IT6517, IT6522, IT6523, IT6524, IT6525, IT6526, IT6527, IT6532, IT6533, IT6534, IT6535, IT6536, IT6537.

Источники выпускаются в исполнениях C и D. Исполнение источников C отличается наличием встроенной нагрузки.

Серийный номер наносится на заднюю панель на маркировочную наклейку в виде цифрового кода.

Общий вид источников с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа представлен на рисунке 1. Нанесение знака поверки на источники не предусмотрено. Пломбирование мест настройки (регулировки) источников не предусмотрено.

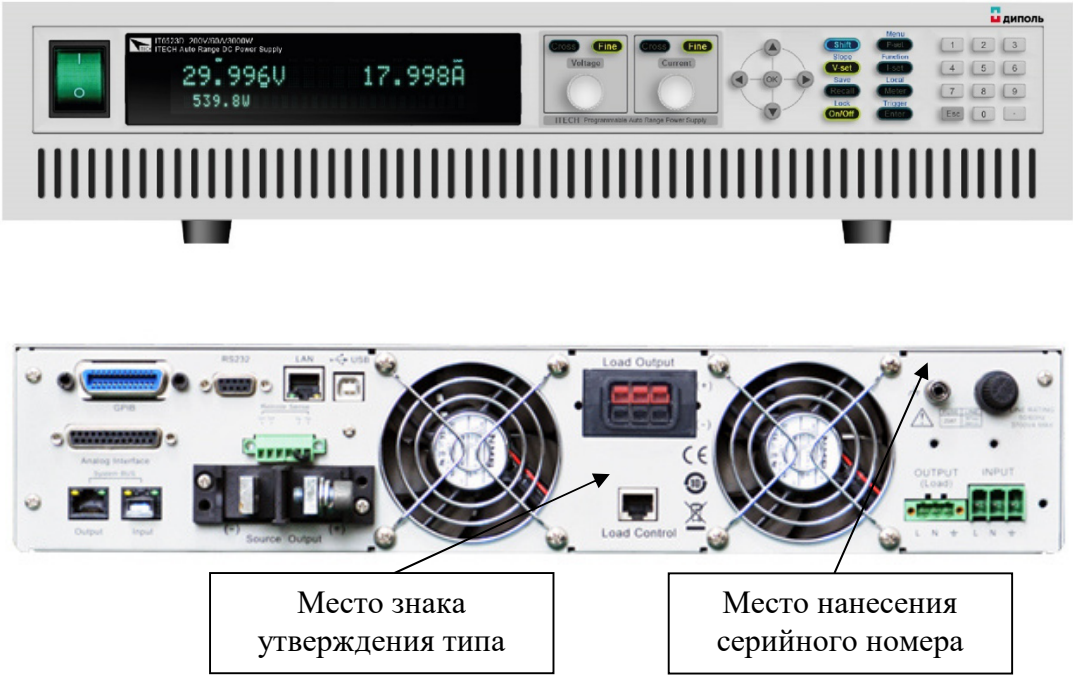

Рисунок 1 – Общий вид источников модификаций IT6512, IT6513, IT6514, IT6515, IT6516, IT6517, IT6522, IT6523, IT6524 с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа

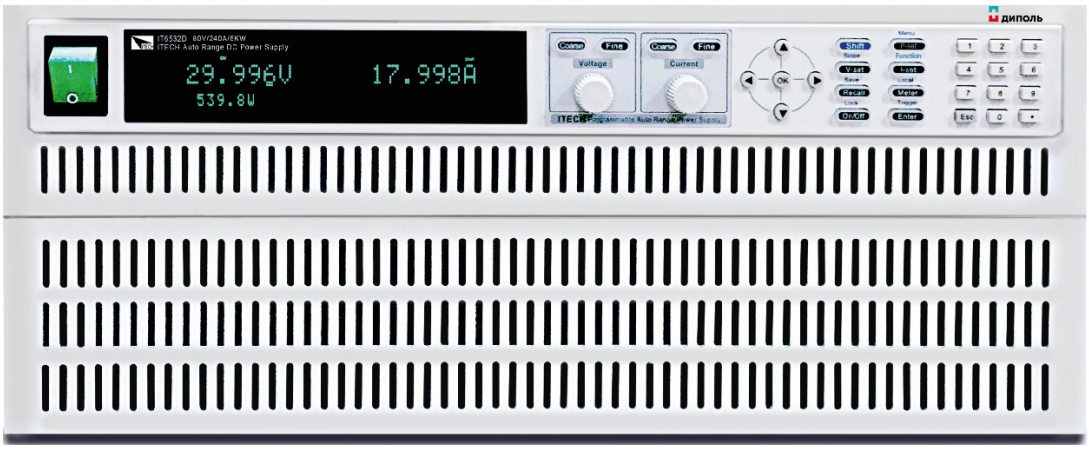

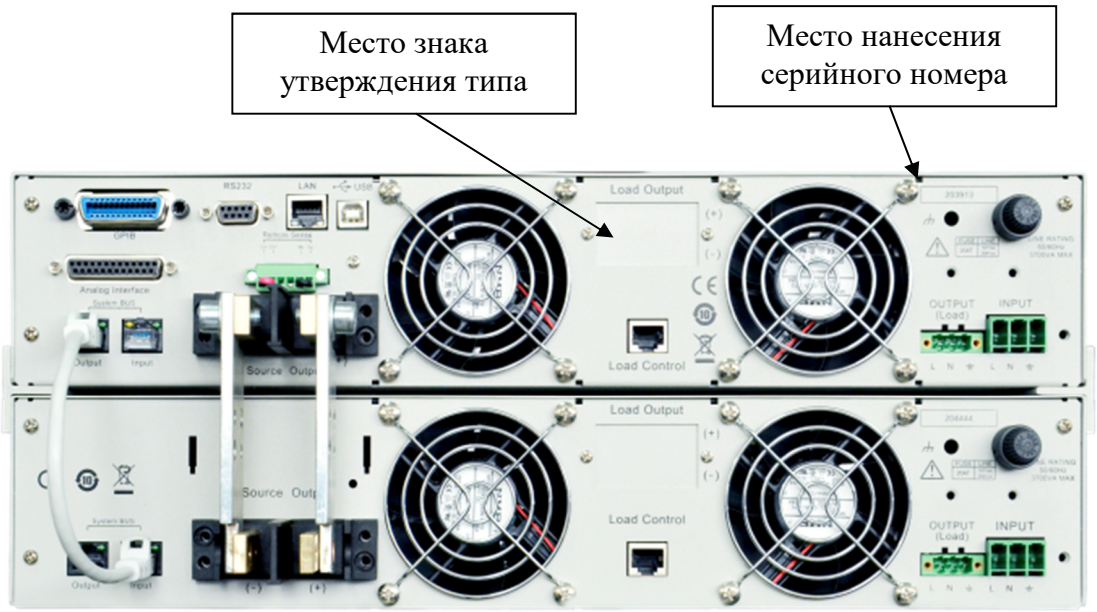

Рисунок 2 - Общий вид источников модификаций IT6525, IT6526, IT6527, IT6532, IT6533, IT6534, IT6535, IT6536, IT6537с указанием места нанесения серийного номера и места нанесения знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) источников состоит из встроенного и внешнего ПО.

Встроенное ПО является метрологически значимым и служит для управления режимами работы источников, выбора встроенных измерительных и вспомогательных функций.

Метрологические характеристики источников нормированы с учетом влияния встроенного ПО.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Внешнее ПО представляет из себя встроенный Web-сервер для мониторинга и управления источниками через веб-браузер персонального компьютера (далее – ПК). Использование внешнего ПО осуществляется соединением источников к ПК через интерфейс связи LAN.

Идентификационные данные метрологически значимого встроенного ПО источников приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	0.39P-0.44P
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Модификация источников	Диапазон воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/ измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон воспроизведений /измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений силы постоянного тока, А	Максимальная выходная мощность, Вт
IT6512	от 0 до 80	±0,0005·U[1)]+0,030	от 0 до 120	±0,002·I[2)]+0,120	1800
IT6513	от 0 до 200	±0,0005·U+0,100	от 0 до 60	±0,002·I+0,060	1800
IT6514	от 0 до 360	±0,0005·U+0,135	от 0 до 30	±0,002·I+0,030	1800
IT6515	от 0 до 500	±0,0005·U+0,200	от 0 до 20	±0,002·I+0,020	1800
IT6516	от 0 до 750	±0,0005·U+0,300	от 0 до 15	±0,002·I+0,015	1800
IT6517	от 0 до 1000	±0,0005·U+0,375	от 0 до 10	±0,002·I+0,010	1800
IT6522	от 0 до 80	±0,0005·U+0,030	от 0 до 120	±0,002·I+0,120	3000
IT6523	от 0 до 200	±0,0005·U+0,100	от 0 до 60	±0,002·I+0,060	3000
IT6524	от 0 до 360	±0,0005·U+0,135	от 0 до 30	±0,002·I+0,030	3000
IT6525	от 0 до 500	±0,0005·U+0,200	от 0 до 20	±0,002·I+0,020	3000
IT6526	от 0 до 750	±0,0005·U+0,300	от 0 до 15	±0,002·I+0,015	3000
IT6527	от 0 до 1000	±0,0005·U+0,375	от 0 до 10	±0,002·I+0,010	3000
IT6532	от 0 до 80	±0,0005·U+0,030	от 0 до 240	±0,002·I+0,240[3)]/ ±0,015·I+0,240[4)]	6000
IT6533	от 0 до 200	±0,0005·U+0,100	от 0 до 120	±0,002·I+0,120	6000
IT6534	от 0 до 360	±0,0005·U+0,135	от 0 до 60	±0,002·I+0,060	6000
IT6535	от 0 до 500	±0,0005·U+0,200	от 0 до 40	±0,002·I+0,040	6000
IT6536	от 0 до 750	±0,0005·U+0,300	от 0 до 30	±0,002·I+0,030	6000
IT6537	от 0 до 1000	±0,0005·U+0,375	от 0 до 20	±0,002·I+0,020	6000

Примечания:

[1)] U – воспроизводимое/измеренное значение напряжения постоянного тока, В;

[2)] I – воспроизводимое/измеренное значение силы постоянного тока, А;

[3)] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений силы постоянного тока до 200 А включ.;

[4)] пределы допускаемой погрешности в диапазоне воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока св. 200 А.

Таблица 3 – Метрологические характеристики в режиме стабилизации напряжения

Модификация источников	Нестабильность выходного напряжения постоянного тока, В		Уровень пульсаций выходного напряжения постоянного тока, В[1)], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении тока нагрузки от $I_{макс}$ до 0,1·$I_{макс}$[3)]	
IT6512	±0,0001·U[2)]+0,010	±0,0001·U[2)]+0,030	0,08
IT6513	±0,0001·U+0,020	±0,0001·U+0,050	0,20

Модификация источников	Нестабильность выходного напряжения постоянного тока, В		Уровень пульсаций выходного напряжения постоянного тока, В[1], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении тока нагрузки от $I_{макс}$ до $0,1 \cdot I_{макс}$[3]	
IT6514	±0,0001·*U*+0,040	±0,0001·*U*+0,135	0,36
IT6515	±0,0001·*U*+0,050	±0,0001·*U*+0,100	0,50
IT6516	±0,0001·*U*+0,075	±0,0001·*U*+0,200	0,75
IT6517	±0,0001·*U*+0,100	±0,0001·*U*+0,375	1,50
IT6522	±0,0001·*U*+0,010	±0,0001·*U*+0,030	0,08
IT6523	±0,0001·*U*+0,020	±0,0001·*U*+0,050	0,20
IT6524	±0,0001·*U*+0,040	±0,0001·*U*+0,135	0,36
IT6525	±0,0001·*U*+0,050	±0,0001·*U*+0,100	0,50
IT6526	±0,0001·*U*+0,075	±0,0001·*U*+0,200	0,75
IT6527	±0,0001·*U*+0,100	±0,0001·*U*+0,375	1,50
IT6532	±0,0001·*U*+0,010	±0,0001·*U*+0,030	0,08
IT6533	±0,0001·*U*+0,020	±0,0001·*U*+0,050	0,20
IT6534	±0,0001·*U*+0,040	±0,0001·*U*+0,135	0,36
IT6535	±0,0001·*U*+0,050	±0,0001·*U*+0,100	0,50
IT6536	±0,0001·*U*+0,075	±0,0001·*U*+0,200	0,75
IT6537	±0,0001·*U*+0,100	±0,0001·*U*+0,375	1,50

Примечания:
[1] – среднеквадратическое значение/размах сигнала;
[2] *U* – воспроизводимое значение напряжения постоянного тока, В;
[3] $I_{макс}$ – максимальное значения силы постоянного тока на нагрузке.

Таблица 4 – Метрологические характеристики в режиме стабилизации силы тока

Модификация источников	Нестабильность выходного сигнала силы постоянного тока, А		Уровень пульсаций выходной силы постоянного тока, А[1], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении напряжения на нагрузке от $U_{макс}$ до $0,1 \cdot U_{макс}$	
IT6512	±0,0001·*I*[2]+0,060	±0,005·*I*[2]+0,120	0,0005·*I*[2]+0,06
IT6513	±0,0001·*I*+0,030	±0,0005·*I*+0,060	0,05
IT6514	±0,0001·*I*+0,015	±0,0005·*I*+0,030	0,0005·*I*+0,03
IT6515	±0,0001·*I*+0,010	±0,0005·*I*+0,020	0,04
IT6516	±0,0001·*I*+0,0075	±0,0005·*I*+0,015	0,03
IT6517	±0,0001·*I*+0,005	±0,0005·*I*+0,010	0,0005·*I*+0,01
IT6522	±0,0001·*I*+0,060	±0,0005·*I*+0,120	0,0005·*I*+0,06
IT6523	±0,0001·*I*+0,030	±0,0005·*I*+0,060	0,05
IT6524	±0,0001·*I*+0,015	±0,0005·*I*+0,030	0,0005·*I*+0,03
IT6525	±0,0001·*I*+0,010	±0,0005·*I*+0,020	0,04
IT6526	±0,0001·*I*+0,0075	±0,0005·*I*+0,015	0,03
IT6527	±0,0001·*I*+0,005	±0,0005·*I*+0,010	0,0005·*I*+0,01
IT6532	±0,0001·*I*+0,120	±0,0005·*I*+0,240	0,0005·*I*+0,12
IT6533	±0,0001·*I*+0,060	±0,0005·*I*+0,120	0,10

Модификация источников	Нестабильность выходного сигнала силы постоянного тока, А		Уровень пульсаций выходной силы постоянного тока, А[1)], не более
	при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального	при изменении напряжения на нагрузке от $U_{макс}$ до $0{,}1 \cdot U_{макс}$	
IT6534	$\pm 0{,}0001 \cdot I + 0{,}030$	$\pm 0{,}0005 \cdot I + 0{,}060$	$0{,}0005 \cdot I + 0{,}06$
IT6535	$\pm 0{,}0001 \cdot I + 0{,}020$	$\pm 0{,}0005 \cdot I + 0{,}040$	0,08
IT6536	$\pm 0{,}0001 \cdot I + 0{,}015$	$\pm 0{,}0005 \cdot I + 0{,}030$	0,06
IT6537	$\pm 0{,}0001 \cdot I + 0{,}010$	$\pm 0{,}0005 \cdot I + 0{,}020$	$0{,}0005 \cdot I + 0{,}02$

Примечания:
[1)] – среднеквадратическое значение;
[2)] I – воспроизводимое значение силы постоянного тока, А
[3)] $U_{макс}$ – максимальное значения напряжения постоянного тока на нагрузке.

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	 220±22 50
Потребляемая мощность, В·А, не более	7600
Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более	195×642×484
Масса, кг, не более	35
Рабочие условия измерений: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %	 от 0 до +40 до 80

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус источников любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Источник питания постоянного тока программируемый IT6500	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 1 «Осмотр и установка» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

«Источники питания постоянного тока программируемые IT6500. Стандарт предприятия» ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».

Правообладатель

ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай

Адрес юридического лица: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Изготовитель

ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай

Адрес юридического лица: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Адрес места осуществления деятельности: 210039, No.108, XiShanqiao Nanlu, Nanjing city, China

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314019.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87510-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-1000

Назначение средства измерений

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-1000 (далее – резервуар) предназначен для измерений объема, а также приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Принцип действия резервуара основан на заполнении его нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего объему нефтепродукта согласно градуировочной таблице резервуара.

Резервуар представляет собой металлический сосуд в форме вертикального цилиндра, со стационарной крышей. На боковых стенках и крыше предусмотрены люки-лазы для обслуживания резервуара, а также смотровые, монтажные и замерные люки. Днища резервуара металлические. Резервуар снабжен лестницами для доступа на крышу.

Заводской номер резервуара в виде цифрового обозначения, состоящий из арабских цифр, нанесен аэрографическим способом на стенку резервуара, а также нанесен типографским способом в паспорте завода-изготовителя резервуара. Способ нанесения заводского номера на стенке резервуара обеспечивает возможность прочтения информации и ее сохранность в процессе эксплуатации резервуара.

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-1000, заводской № 24 установлен на территории наливного пункта «Брянск» Брянского районного управления филиала акционерного общества «Транснефть - Дружба», по адресу: 241518, Брянская область, Брянский район, п. Свень, ул. Снежетьский Вал, д. 14 НП «Брянск».

Общий вид резервуара представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-1000, заводской № 24

Пломбирование резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-1000 не предусмотрено.

Конструкция резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-1000 не предусматривает нанесение на него знака поверки.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, $м^3$	1000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (геометрический метод), %	±0,2

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа	 от -50 до +50 от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	50

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (заводской № 24)	РВС-1000	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в разделе 1.13 «Методика (метод) измерений» паспорта резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-1000, заводской № 24.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Акционерное общество «Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (АО «СЗ КВОиТ»)
ИНН 6318116093
Адрес: 443022, г. Самара, проезд. Мальцева, д. 1
Тел.: +7(846) 955-01-81
E-mail: info@gk-kvoit.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (АО «СЗ КВОиТ»)
ИНН 6318116093
Адрес: 443022, г. Самара, проезд. Мальцева, д. 1
Тел.: +7(846) 955-01-81
E-mail: info@gk-kvoit.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический центр»
(ООО «Метрологический центр»)
Адрес: 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, 33-й мкр., д. 1, пом. 155
Тел./факс: 8 (3955) 68-05-77
E-mail: metrolog.irk@yandex.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU 312397.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87511-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Ключи моментные предельные CMTN

Назначение средства измерений

Ключи моментные предельные CMTN (далее по тексту - ключи), предназначены для измерений крутящего момента силы при нормированной затяжке резьбовых соединений с правой резьбой.

Описание средства измерений

Принцип действия ключей заключается в активации механизма регулировки значения крутящего момента силы, расположенного в корпусе, под действием приложенной к рукоятке ключа нагрузки. В момент достижения заданного значения крутящего момента силы, механизм срабатывает и происходит снятие нагрузки, сопровождающиеся звуковым и тактильным сигналом в виде щелчка.

Ключи состоят из корпуса-рукоятки, на котором нанесена шкала установки крутящего момента, трещотки с присоединительным квадратом под сменные насадки и механизма установки крутящего момента силы.

Механизм регулировки крутящего момента силы представляет собой кулачковый блок, поджатый регулировочной пружиной. При достижении заданного значения крутящего момента силы, кулачки проскальзывают и происходит снятие нагрузки с корпуса-рукоятки. Настройка значения крутящего момента силы осуществляется путем вращения барабана (совмещение его указателя до значения, указанного на шкале корпуса ключа), закрепленного на рукоятке ключа.

Ключи моментные предельные CMTN выпускаются в разных модификациях и отличаются диапазоном измерений, ценой деления шкалы установки крутящего момента, габаритными размерами и массой. Ключи с обозначением «А» изготавливаются с укороченной рабочей частью. Количество модификаций – 21.

Структура условного обозначения модификаций:

ключ моментный предельный CMTN-XA, где;

X – верхняя граница диапазона измерений
(5; 10; 22,5; 25; 50; 100; 180; 200; 230; 300; 400; 500; 680; 760; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000);

А – укороченная рабочая часть (длина ключа меньше за счет укороченной рукоятки).

Без обозначения «А» – стандартный размер рукоятки.

На корпусе ключа установлена маркировочная табличка с информацией об изготовителе и верхней границе диапазона измерений, соответствующей его модификации. Заводской номер в виде цифрового кода наносится методом гравировки на оборотной стороне корпуса.

Опломбирование ключей моментных предельных CMTN не предусмотрено, ограничение доступа к метрологически значимым функциям обеспечивается конструкцией.

Нанесение знака поверки на средство измерения не предусмотрено

Фотография общего вида ключей CMTN, представлена на рисунке 1.

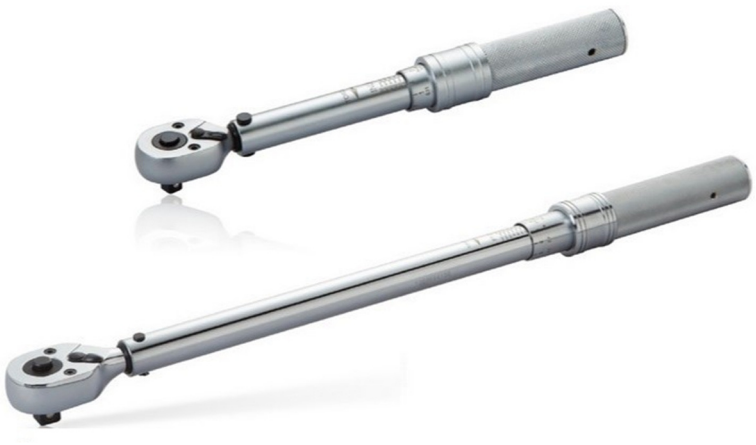

Рисунок 1 – Ключи моментные предельные CMTN

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристик	Значение характеристик											
Модификация	5	10	22,5	25	50	100	180	200	230	300	400	400A
Диапазон измерений, Н·м	от 1 до 5	от 2 до 10	от 5 до 22,5	от 5 до 25	от 10 до 50	от 20 до 100	от 40 до 180	от 40 до 200	от 50 до 230	от 60 до 300	от 80 до 400	
Цена деления, Н·м	0,05	0,1		0,25	0,5	1				1,5	2	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения крутящего момента силы, %	±4,0											

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристик	Значение характеристик								
Модификация	500	680	760	1000	1200	1500	2000	2000A	3000
Диапазон измерений, Н·м	от 100 до 500	от 160 до 680	от 160 до 760	от 300 до 1000	от 400 до 1200	от 450 до 1500	от 750 до 2000		от 1000 до 3000
Цена деления, Н·м	2,5	4	5	8	7,5	12,5	16	10	4
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения крутящего момента силы, %	±4,0								

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристик	Значение характеристик										
Модификация	5	10	22,5	25	50	100	180	200	230	300	400
Размер присоединительного квадрата, не более, мм	6,35	9,53				12,7				19,05	
Габаритные размеры: - длина, мм, не более	190	200	255		310	420	530	580	670	680	890
- ширина, мм, не более	50										
Масса, кг, не более	0,20		0,3	0,5		0,9	1,5	1,8	1,9	2,6	3,7

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристик	Значение характеристик									
Модификация	400А	500	680	760	1000	1200	1500	2000	2000А	3000
Размер присоединительного квадрата, не более, мм	19,05				25,4					
Габаритные размеры: - длина, мм, не более	780	890	1100		1300	1530	1300	1830	1320	1500
- ширина, мм не более	50									
Масса, кг, не более	3,2	3,3	6,8		7,6	8,5	7,8	12	7,6	25

Таблица 3 – Общие технические характеристики

Наименование характеристик	Значение характеристик
Средняя наработка циклов на отказ, не менее	10000
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, - относительная влажность воздуха - атмосферное давление, кПа	 от + 15 до + 35 °С до 80 % от 84 до 106

Знак утверждения типа
наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность ключей моментных предельных CMTN

Наименование	Обозначение	Количество
Ключ моментный предельный	CMTN-XA	1 шт.
Кейс для хранения и переноски	-	1 шт.
Комплект сменных насадок (головок)	-	-*
Паспорт	CMTN – ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	CMTN – РЭ	1 экз.
* – по согласованию с заказчиком		

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 2.2 раздела 2 «Выполнение измерений» документа «Ключи моментные предельные CMTN. Руководство по эксплуатации» CMTN – РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 31 июля 2019 г. № 1794 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений крутящего момента силы»;

Стандарт предприятия «Ключи моментные предельные CMTN» фирмы «Aviation Industry Corporation of China, Ltd».

Правообладатель

Фирма «Aviation Industry Corporation of China, Ltd», Китай
Адрес: P.O.B.57 South Region of Hanzhong Economic Development Zone (723102), Shaanxi, China
Телефон: +86-916-5302 096/188
Web-сайт: avic.com

Изготовитель

Фирма «Aviation Industry Corporation of China, Ltd», Китай
Адрес: P.O.B.57 South Region of Hanzhong Economic Development Zone (723102), Shaanxi, China
Телефон: +86-916-5302 096/188
Web-сайт: avic.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д.1
Тел.: 8 800 200 22 14
E-mail: mail@nncsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87512-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Глубиномеры микрометрические

Назначение средства измерений

Глубиномеры микрометрические (далее по тексту – глубиномеры) предназначены для измерений глубины пазов и высоты уступов до 300 мм.

Описание средства измерений

Принцип действия глубиномеров основан на использовании точной винтовой пары для преобразования вращательного движения микрометрического винта в поступательное движение измерительного наконечника до соприкосновения с измеряемой поверхностью.

Глубиномер состоит из основания с измерительной поверхностью прямоугольной формы, в которое запрессована микрометрическая головка. В отверстие микрометрического винта устанавливаются сменные измерительные стержни с плоской измерительной поверхностью, которые обеспечивают требуемый диапазон измерений.

В диапазоне от 0 до 25 мм измерение осуществляется прямым методом по отсчетному устройству, в диапазоне от 25 до 300 мм – с применением сменных измерительных стержней (входят в комплект глубиномера), при этом установка глубиномера на нулевой отсчет производится по концевым мерам длины.

Число модификаций – 12 (ГМ 25, ГМ 50, ГМ 75, ГМ 100, ГМ 125, ГМ 150, ГМ 175, ГМ 200, ГМ 225, ГМ 250, ГМ 275, ГМ 300), отличающихся друг от друга диапазоном измерений, количеством и номинальной длиной сменных измерительных стержней.

Общий вид глубиномеров, в зависимости от диапазона измерений, представлен на рисунке 1.

Логотип ZITOM наносится на паспорт глубиномеров типографским методом, на основание глубиномера методом лазерной маркировки.

Заводской номер наносится на барабан микрометрической головки глубиномера методом лазерной маркировки в формате буквенно-цифрового обозначения.

Сведения о диапазоне измерений и цене деления наносятся на основание глубиномера методом лазерной маркировки.

Пломбирование глубиномеров от несанкционированного доступа не предусмотрено.

Возможность нанесения знака поверки на средство измерений отсутствует.

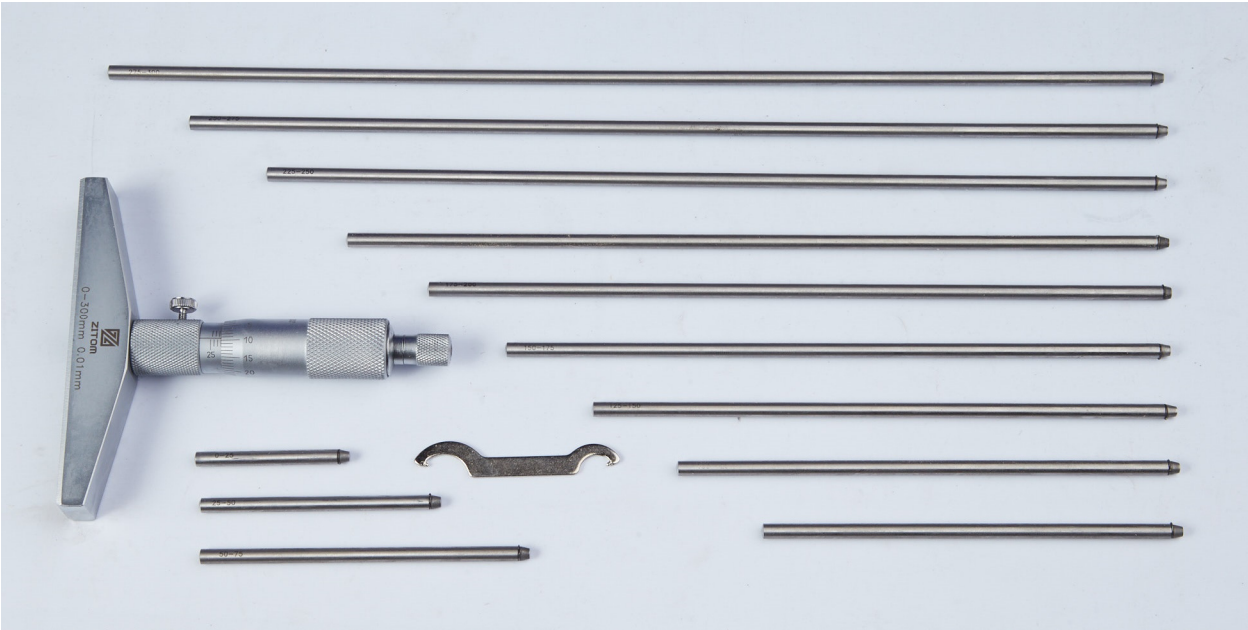

Рисунок 1 – Общий вид глубиномеров модификации ГМ 300

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Измерительное усилие, Н	Колебание измерительного усилия, Н, не более
ГМ 25	От 0 до 25	0,01	От 3 до 6	2
ГМ 50	От 0 до 50			
ГМ 75	От 0 до 75			
ГМ 100	От 0 до 100			
ГМ 125	От 0 до 125			
ГМ 150	От 0 до 150			
ГМ 175	От 0 до 175			
ГМ 200	От 0 до 200			
ГМ 225	От 0 до 225			
ГМ 250	От 0 до 250			
ГМ 275	От 0 до 275			
ГМ 300	От 0 до 300			

Таблица 2 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Измеряемая глубина, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
От 0 до 25 включ.	±5
свыше 25 до 50 включ.	±8
свыше 50 до 100 включ.	±10
свыше 100 до 300	±12

Таблица 3 – Технические характеристики глубиномеров

Наименование характеристики	Значение
Отклонение плоскостности измерительной поверхности основания глубиномеров, мкм, не более	2,0
Габаритные размеры измерительной поверхности основания (Длина х Ширина), мм, не более	100х16
Габаритные размеры основания (Длина х Ширина х Высота), мм, не более	100х30х135
Масса, кг, не более	0,4

Таблица 4 – Условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	 От +15 до +25 80

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским методом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Комплектность
Глубиномер	-	1 шт.
Сменные измерительные стержни	-	1 компл.
Ключ	-	1 шт.
Футляр	-	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 7 «Заметки по эксплуатации, порядок работы, поверка» паспорта глубиномеров микрометрических.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2840;

JJG 24—2003 «Глубиномеры микрометрические. Стандарт предприятия».

Правообладатель

GUILIN MEASURING AND CUTTING TOOL CO., LTD, КНР
Адрес: 40 CHONGXIN ROAD, GUILIN, P.R. CHINA, 541002
Тел: (86-773) 3814349, факс: (86-773) 3814270
E-mail: sales@sinoshan.com

Изготовитель

GUILIN MEASURING AND CUTTING TOOL CO., LTD, КНР
Адрес: 40 CHONGXIN ROAD, GUILIN, P.R. CHINA, 541002
Тел: (86-773) 3814349, факс: (86-773) 3814270

E-mail: sales@sinoshan.com

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»).
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87513-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики воздушного зазора AGT-530 3G

Назначение средства измерений

Датчики воздушного зазора AGT-530 3G (далее – датчики) предназначены для измерений относительной вибрации (виброперемещение ротора относительно статора), а также измерений воздушного зазора между ротором и статором в электродвигателях и генераторах.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на зависимости электрической емкости конденсатора, образованного поверхностью чувствительного элемента и поверхностью контролируемого объекта, от расстояния между ними. Изменение расстояния в процессе перемещения контролируемого объекта приводит к пропорциональному изменению выходного напряжения. Измерение виброперемещения происходит без механического контакта чувствительного элемента с контролируемым объектом.

Датчики воздушного зазора AGT-530 3G являются преобразователями параметрического типа и могут работать, начиная с частоты, равной нулю (постоянный входной сигнал) до 1000 Гц.

Датчики воздушного зазора AGT-530 3G состоят из чувствительного элемента (преобразователя) с кабелем, демодулятора и осциллятора с кабелем.

Датчики воздушного зазора AGT-530 3G имеют маркировку AGS-525 M4. Заводские номера наносятся на кабель преобразователей, методом наклейки на специальную площадку, защищенную от внешнего воздействия прозрачной термоусадочной трубкой. Заводские номера наносятся в виде цифро-буквенного обозначения, состоящего из комбинации букв латинского алфавита и арабских цифр.

Демодуляторы предназначены для питания преобразователей и формирования измеренного выходного сигнала. Демодуляторы имеют маркировку AGD-530 M3. Заводские номера наносятся на корпус демодуляторов, методом наклейки. Заводские номера наносятся в виде цифро-буквенного обозначения, состоящего из комбинации букв латинского алфавита и арабских цифр.

Осцилляторы выпускаются в нескольких модификациях AGO-208 M3, AGO-222 M3, AGO-228 M3 и AGO-235 M3, отличающиеся между собой длиной кабеля. Заводские номера наносятся на корпус осцилляторов, методом наклейки. Заводские номера наносятся в виде цифро-буквенного обозначения, состоящего из комбинации букв латинского алфавита и арабских цифр.

Пломбирование датчиков не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Общий вид датчиков воздушного зазора AGT-530 3G представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид датчиков воздушного зазора AGT-530 3G

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики датчиков воздушного зазора AGT-530 3G

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение коэффициента преобразования, мА/мм	0,64
Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, %	±10
Диапазон измерений воздушного зазора, мм	от 5 до 30
Нелинейность амплитудной характеристики при измерении воздушного зазора, %: - в диапазоне измерений от 11 до 29 мм - в диапазоне измерений от 5 до 30 мм	 ±10 ±15
Диапазон выходного тока, мА	от 4 до 20
Диапазон измерений размаха виброперемещения, мкм	от 100 до 12000
Диапазон рабочих частот, Гц	от 0,1 до 400
Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте 20 Гц при измерении размаха виброперемещения, %, не более	±5
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты 20 Гц при измерении размаха виброперемещения, дБ, не более	±3
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, ºС	 от +15 до +25
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, вызванные изменением температуры окружающей среды от нормальных условий измерений в диапазоне рабочих температур, %/ºС	±0,03

Таблица 2 - Основные технические характеристики датчиков воздушного зазора AGT-530 3G

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: напряжение питания постоянного тока, В	 от + 22 до +26
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС - для преобразователей - для демодуляторов	 от -15 до +125 от -15 до +85
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более: - преобразователей (без кабеля) - демодуляторов - осцилляторов (без кабеля)	 264×38×4 170×63×40 120×25
Длина кабеля с осциллятором, м, не более	28
Масса, кг, не более - преобразователей (с кабелем) - демодуляторов - осцилляторов (с кабелем)	 0,1 0,5 1,5

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Датчики воздушного зазора AGT-530 3G составе: - преобразователь - демодулятор - осциллятор с кабелем	 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в руководстве по эксплуатации раздел 9 «Информация по применению».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 2772 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения»;

Техническая документация фирмы MC-monitoring SA, Швейцария.

Правообладатель

MC-monitoring SA, Швейцария
Адрес: Rte André Piller 19, 1762 Givisiez, Швейцария
Телефон: +41 (0)58 411 54 00
Web-сайт: www. mc-monitoring.com

Изготовитель

MC-monitoring SA, Швейцария
Адрес: Rte André Piller 19, 1762 Givisiez, Швейцария
Телефон: +41 (0)58 411 54 00
Web-сайт: www. mc-monitoring.com

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: +7 (495)437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87514-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения SVS 123

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения SVS 123 (далее - трансформаторы) предназначены для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц.

Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов основан на преобразовании посредством электромагнитной индукции переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте и без существенных потерь мощности.

Конструктивно трансформаторы состоят из одной первичной обмотки и трех вторичных обмоток. Трансформаторы имеют железный сердечник с активной частью. Первичная и вторичные обмотки расположены друг над другом. Высоковольтная изоляция внутри трансформатора обеспечивается за счет заполнения элегазом. Изолятор трансформатора исполнен в виде гидрофобного силикона серого цвета.

К трансформаторам данного типа относятся трансформаторы напряжения SVS 123 с зав. №№ 3038602, 3038603, 3038604, 3038605, 3038606, 3038607.

Заводской номер нанесен на крышку контактной коробки в виде маркировочной таблички методом гравировки в виде цифрового кода.

Общий вид трансформаторов с указанием места нанесения знака утверждения типа, места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1. Пломбирование трансформаторов не предусмотрено. Нанесение знака поверки на трансформаторы в обязательном порядке не предусмотрено.

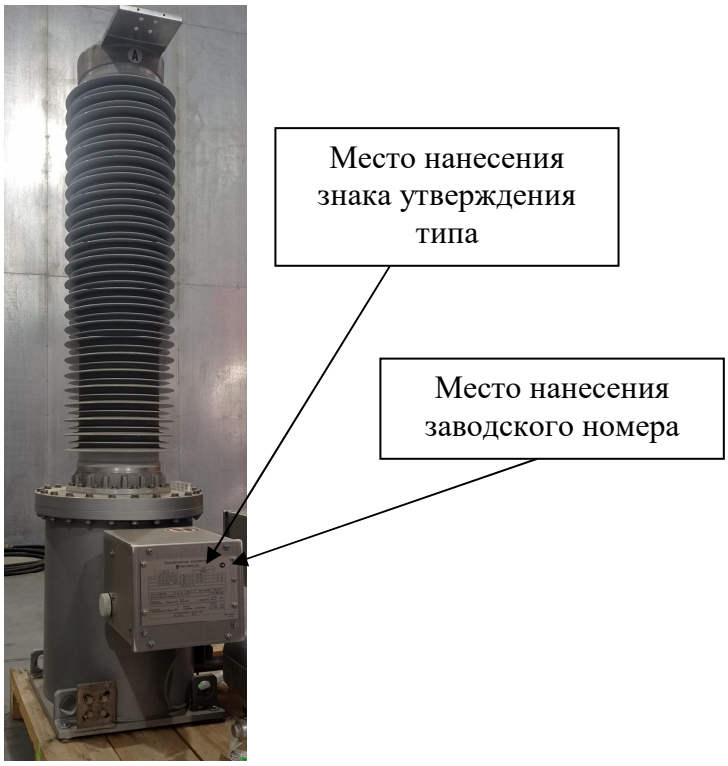

Рисунок 1 - Общий вид трансформаторов напряжения с указанием места нанесения знака утверждения типа, места нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение напряжения первичной обмотки, кВ	110/√3
Номинальное напряжение вторичных обмоток, В: -основных вторичных обмоток -дополнительной вторичной обмотки	 100/√3 100
Класс точности: - основных вторичных обмоток -дополнительной вторичной обмотки	 0,2 3P
Номинальная мощность основных вторичных обмоток для измерений при коэффициенте мощности (cos φ) активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А	60
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки при коэффициенте мощности (cos φ) активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А	300
Номинальная частота напряжения сети, Гц	50

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	690×830×2150
Масса, кг, не более	1000
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С	 от -45 до +40

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом и на маркировочную табличку трансформатора методом гравировки.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор напряжения	SVS 123	1 шт.
Паспорт	–	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 3 «Методика (методы) измерений» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3453 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/√3 до 750/√3 кВ и средств измерений электрической емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ».

Правообладатель

«Trench Germany GmbH», Германия

Адрес юридического лица: Nurnberger Strasse 199, 96050 Bamberg, Germany

Изготовитель

«Trench Germany GmbH», Германия

Адрес юридического лица: Nurnberger Strasse 199, 96050 Bamberg, Germany

Адрес места осуществления деятельности: Nurnberger Strasse 199, 96050 Bamberg, Germany

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314019.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87515-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС-60

Назначение средства измерений

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС-60 (далее – резервуары) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Тип резервуаров – горизонтальные стальные цилиндрические, номинальной вместимостью 60 м^3 подземного расположения.

Принцип действия резервуаров основан на заполнении их нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуары представляют собой горизонтально расположенный цилиндрический стальной сосуд с днищами.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки.

Заводские номера резервуаров в виде цифрового обозначения, состоящие из арабских цифр, нанесены методом сублимации на маркировочную табличку резервуара.

Маркировочная табличка крепится на крышке технологической шахты резервуара.

Резервуары РГС-60 с заводскими номерами 14, 15, 16, 17, расположены на территории нефтебазы «Ростовская» по адресу: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148 В.

Фотографии люков и мест нанесения заводских номеров приведены на рисунках 1, 2, 3, 4. Эскиз общего вида резервуаров приведен на рисунке 5.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Рисунок 1 – Люк резервуара РГС-60 зав.№14 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 2 – Люк резервуара РГС-60 зав.№15 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 3 – Люк резервуара РГС-60 зав.№16 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 4 – Люк резервуара РГС-60 зав.№17 с указанием места нанесения заводского номера

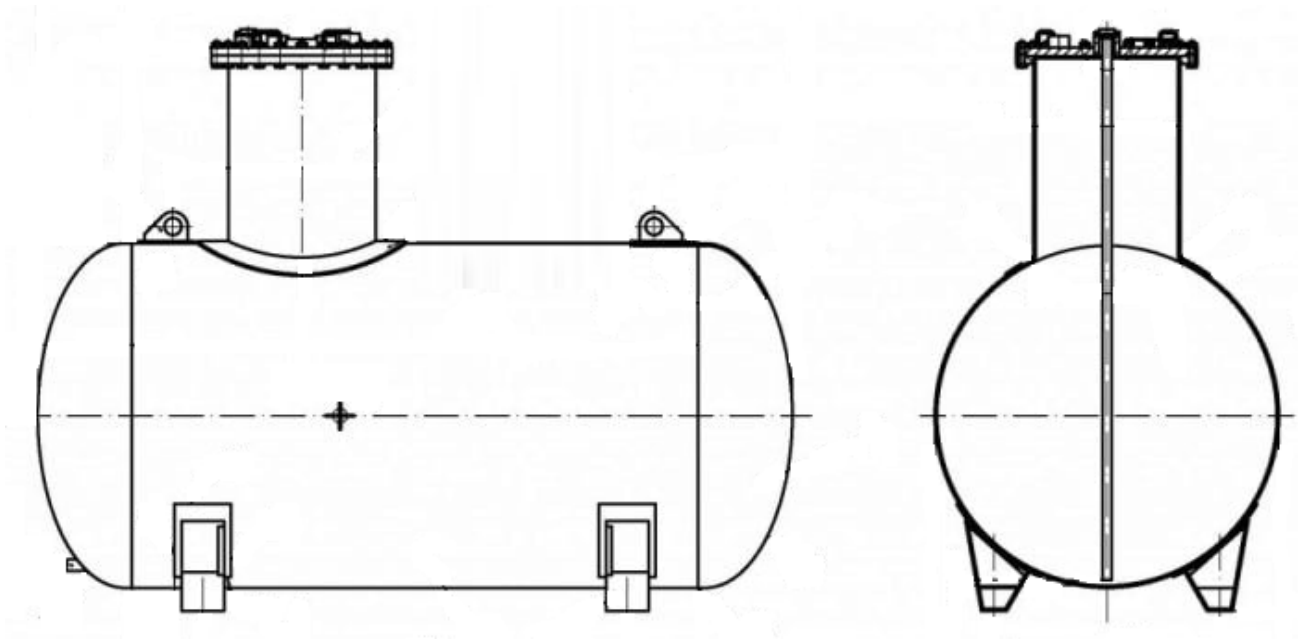

Рисунок 5 – Эскиз общего вида резервуаров

Пломбирование резервуаров РГС-60 не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м^3	60
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (объемный метод), %	±0,25

Т а б л и ц а 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ºС	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

Комплектность средства измерений.

Т а б л и ц а 3- Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический	РГС-60	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 8 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов» (ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»)
ИНН 6163105307
Адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 70/128, офис 4
Телефон/ факс: +7(863) 242-44-81/ (863) 242-44-82
E-mail: ubsr@ubsr.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов» (ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»)
ИНН 6163105307
Адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 70/128, офис 4
Телефон/ факс: +7(863) 242-44-81/ (863) 242-44-82
E-mail: ubsr@ubsr.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ» (ООО «МетроКонТ»)
Адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, офис 51
Телефон: +7 9372834420
Факс +7 (843) 515-00-21
E-mail: trifonovua@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312640.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87516-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС-140

Назначение средства измерений

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГС-140 (далее – резервуары) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Тип резервуаров – горизонтальные стальные цилиндрические, номинальной вместимостью 140 м^3 подземного расположения.

Принцип действия резервуаров основан на заполнении их нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуары представляют собой горизонтально расположенный цилиндрический стальной сосуд с днищами.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки.

Заводские номера резервуаров в виде цифрового обозначения, состоящие из арабских цифр, нанесены методом сублимации на маркировочную табличку резервуара.

Маркировочная табличка крепится на крышке технологической шахты резервуара.

Резервуары РГС-140 с заводскими номерами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, расположены на территории нефтебазы «Ростовская» по адресу: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148 В.

Фотографии люков и мест нанесения заводских номеров приведены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эскиз общего вида резервуаров приведен на рисунке 11.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Рисунок 1 – Люк резервуара РГС-140 зав.№4 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 2 – Люк резервуара РГС-140 зав.№5 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 3 – Люк резервуара РГС-140 зав.№6 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 4 – Люк резервуара РГС-140 зав.№7 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 5 – Люк резервуара РГС-140 зав.№8 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 6 – Люк резервуара РГС-140 зав.№9 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 7 – Люк резервуара РГС-140 зав.№10 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 8 – Люк резервуара РГС-140 зав.№11 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 9 – Люк резервуара РГС-140 зав.№12 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 10 – Люк резервуара РГС-140 зав.№13 с указанием места нанесения заводского номера

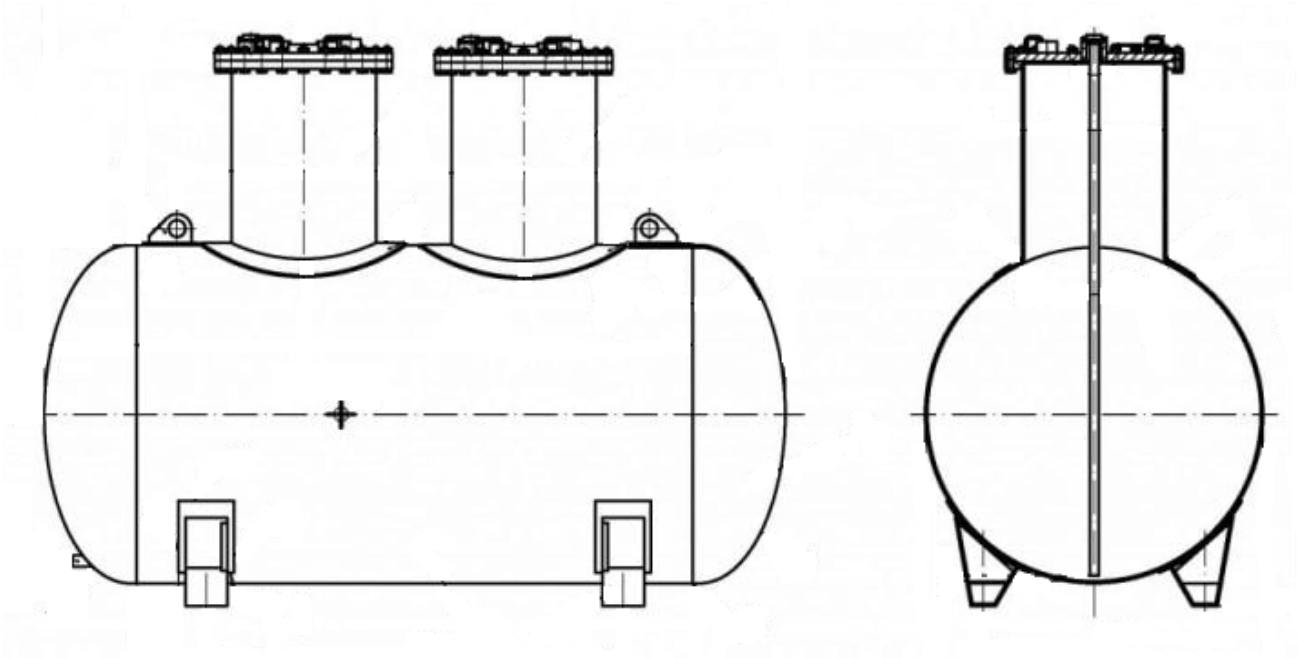

Рисунок 11 – Эскиз общего вида резервуаров

Пломбирование резервуаров РГС-140 не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м^3	140
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (объемный метод), %	±0,25

Т а б л и ц а 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ºС	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

Комплектность средства измерений.

Т а б л и ц а 3- Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический	РГС-140	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 8 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов» (ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»)
ИНН 6163105307
Адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 70/128, офис 4
Телефон/ факс: +7(863) 242-44-81/ (863) 242-44-82
E-mail: ubsr@ubsr.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов» (ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»)
ИНН 6163105307
Адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 70/128, офис 4
Телефон/ факс: +7(863) 242-44-81/ (863) 242-44-82
E-mail: ubsr@ubsr.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ» (ООО «МетроКонТ»)
Адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, офис 51
Телефон: +7 9372834420
Факс +7 (843) 515-00-21
E-mail: trifonovua@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312640.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87517-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-5000

Назначение средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-5000 (далее – резервуары) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Тип резервуаров – стальные вертикальные цилиндрические, номинальной вместимостью 5000 м^3.

Принцип действия резервуаров основан на заполнении их нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуары представляют собой наземные вертикально расположенные стальные сосуды, состоящие из цилиндрической стенки, днища и крыши.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки, расположенные в нижней части резервуара.

Заводские номера резервуаров в виде цифрового обозначения, состоящие из арабских цифр, нанесены аэрографическим способом на цилиндрическую стенку резервуара.

Резервуары РВС-5000 с заводскими номерами 1, 3 расположены по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 9-й км правого поворота 18 км тракта Екатеринбург-Челябинск, д. б/н, Шабровская нефтебаза ООО «Газпромнефть-Терминал».

Общий вид резервуаров РВС-5000 с указанием мест нанесения заводских номеров приведены на рисунках 1, 2.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Рисунок 1 – Общий вид резервуара РВС-5000 №1 с указанием места нанесения заводского номера

Рисунок 2 – Общий вид резервуара РВС-5000 №3 с указанием места нанесения заводского номера

Пломбирование резервуаров РВС-5000 не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, $м^3$	5000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (геометрический метод), %	±0,10

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ºС	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3- Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-5000	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 8 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал» (ООО «Газпромнефть-Терминал»)
ИНН 5406807595
Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, помещ. 13
Телефон: +7 (812) 679-56-00
Web-сайт: www.gazprom-neft.ru
E-mail: terminal@gazprom-neft.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал» (ООО «Газпромнефть-Терминал»)
ИНН 5406807595
Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, помещ. 13
Телефон: +7 (812) 679-56-00
Web-сайт: www.gazprom-neft.ru
E-mail: terminal@gazprom-neft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ» (ООО «МетроКонТ»)
Адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, офис 51
Телефон: +7 9372834420
Факс +7 (843) 515-00-21
E-mail: trifonovua@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312640.