


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ (МОЛЯРНОЙ) ДОЛИ И МАССОВОЙ (МОЛЯРНОЙ) КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ

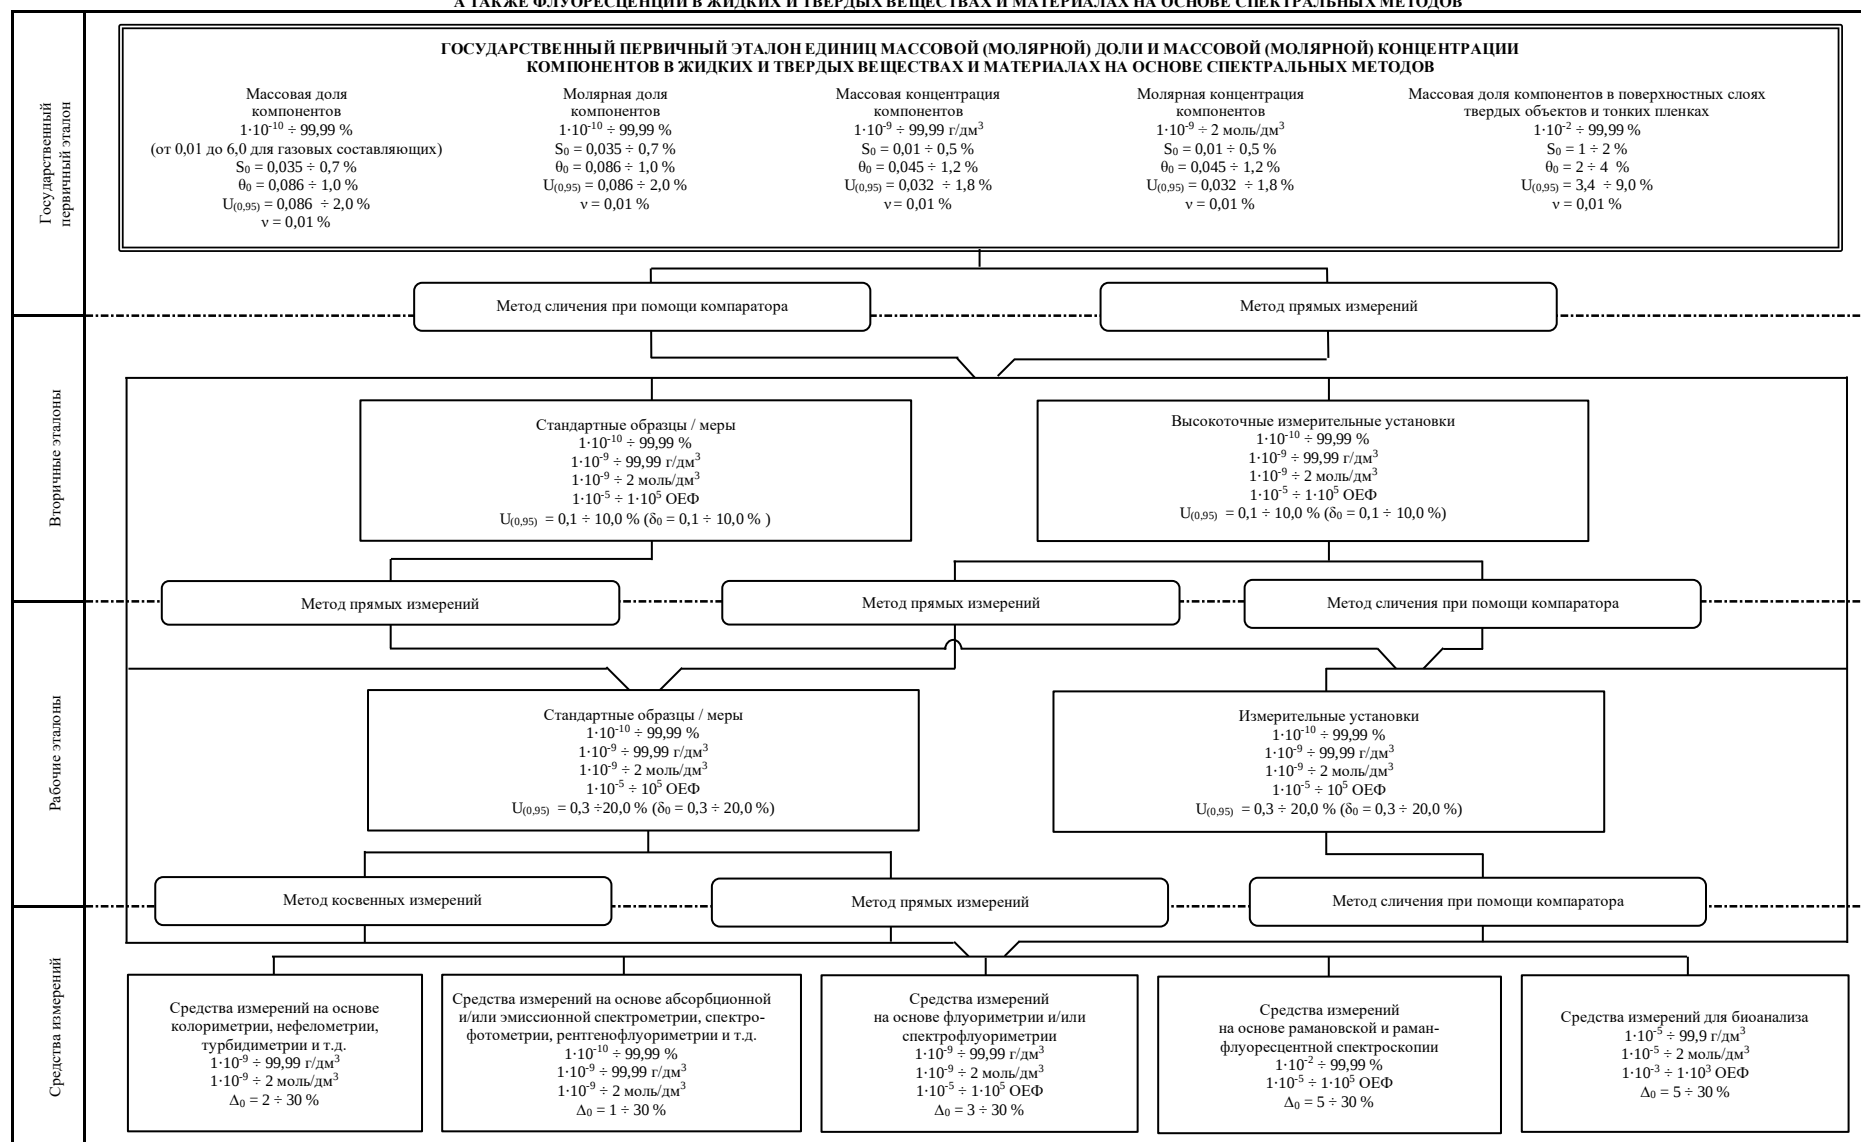

Обозначения: S_0 – относительное СКО (относительная случайная погрешность), θ_0 – относительная неисключенная систематическая погрешность, $U_{(0,95)}$ - относительная расширенная неопределенность при доверительной вероятности $P=0,95$, v - нестабильность, δ_0 – доверительные границы относительной погрешности, Δ_0 - предел допускаемой относительной погрешности