

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 15 » _____ октября 2024 г. № 2454

Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, не влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообладатель	Отменяемая методика поверки	Действие методик поверки сохраняется	Устанавливаемая методика поверки	Заявитель	Юридическое лицо, выдавшее заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Контроллеры промышленные	DevLink	-	78510-20	-	-	ЖАЯК.420000.0 02 МП	-	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственная фирма «КРУГ» (ООО НПФ «КРУГ»), г. Пенза	ФБУ «Пензенский ЦСМ», г. Пенза
2.	Источники питания постоянного тока	АКИП-1167	-	90734-23	«SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD», Китай	-	МП-ПР-15-2023	-	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»), г. Москва	АО «ПриСТ», г. Москва

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «15» октября 2024 г. № 2454

Регистрационный № 78510-20

Лист № 1
Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Контроллеры промышленные DevLink

Назначение средства измерений

Контроллеры промышленные DevLink (далее – контроллеры DevLink) предназначены для измерений силы и напряжения постоянного тока, электрического сопротивления, количества импульсов и времени, преобразования электрического сопротивления в значения температуры, а также для воспроизведения силы и напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Конструктивно контроллеры DevLink представляют собой проектно-компонуемые изделия и состоят из модулей ввода-вывода и процессорных модулей.

Модули ввода реализованы на основе аналого-цифровых преобразователей, а модули вывода – на основе цифроаналоговых преобразователей.

Модули ввода передают информацию по цифровой линии связи в процессорный модуль, который осуществляет преобразование полученной информации в результат измерений (в единицах измеряемой величины).

В соответствии с алгоритмом пользователя, работающем в системе реального времени контроллера (далее – СРБК), или внешним сигналом управления с интерфейса пользователя верхнего уровня (персональный компьютер), поступающем по линии связи Ethernet или беспроводной линии связи GSM, процессорный модуль выдаёт управляющие сигналы на модули вывода унифицированных аналоговых или дискретных сигналов.

Контроллеры DevLink имеют несколько модификаций (таблица 1), отличающихся функциональными возможностями, составом и количеством измерительных каналов. Перечень возможных модулей, из которых строятся контроллеры DevLink, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Модификации контроллеров DevLink


Модули контроллеров DevLink	Описание
Модули ввода/вывода	
Модули ввода/вывода DevLink-A10	Осуществляют непосредственное измерение аналоговых сигналов (электрического напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, электрического сопротивления и температуры), фиксируют состояние дискретных сигналов, выдают дискретные и аналоговые управляющие воздействия на исполнительные механизмы

Продолжение таблицы 1

Модули контроллеров DevLink	Описание
Процессорные модули	
Промышленный модем DevLink-B50	Осуществляет передачу измеренных сигналов от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, на верхний уровень
Промышленный модем DevLink-B100	Осуществляет передачу измеренных сигналов от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, на верхний уровень с дополнительными возможностями обработки и преобразований получаемых и передаваемых данных
Конвертор протоколов DevLink-D200	Осуществляет преобразование данных, получаемых от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, в единый унифицированный формат данных
Конвертор протоколов DevLink-D300	Осуществляет преобразование и обработку данных, получаемых от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, в единый унифицированный формат данных
Контроллер сбора данных DevLink-G500	Осуществляет сбор и передачу данных от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, в системах учета энергоресурсов и диспетчеризации, системах телемеханики и др. по проводным и беспроводным каналам связи
Устройство сбора и передачи данных DevLink-FS600	Осуществляет сбор и передачу данных от интеллектуальных устройств, в т. ч. от DevLink-A10, в системах учета энергоресурсов и диспетчеризации и др. по проводным и беспроводным каналам связи
Универсальный свободно программируемый промышленный контроллер DevLink-C1000	Осуществляет сбор и алгоритмическую обработку данных, а также выдачу управляющих сигналов на модули ввода/вывода DevLink-A10 и др. интеллектуальные устройства, осуществляет архивирование данных, протоколирование зафиксированных событий и др.

Система обозначений модификаций процессорных модулей и программного обеспечения в соответствии с руководством по эксплуатации.

Система обозначений модификаций аппаратной платформы модулей ввода/вывода DevLink-A10 приведена на рисунке 1.

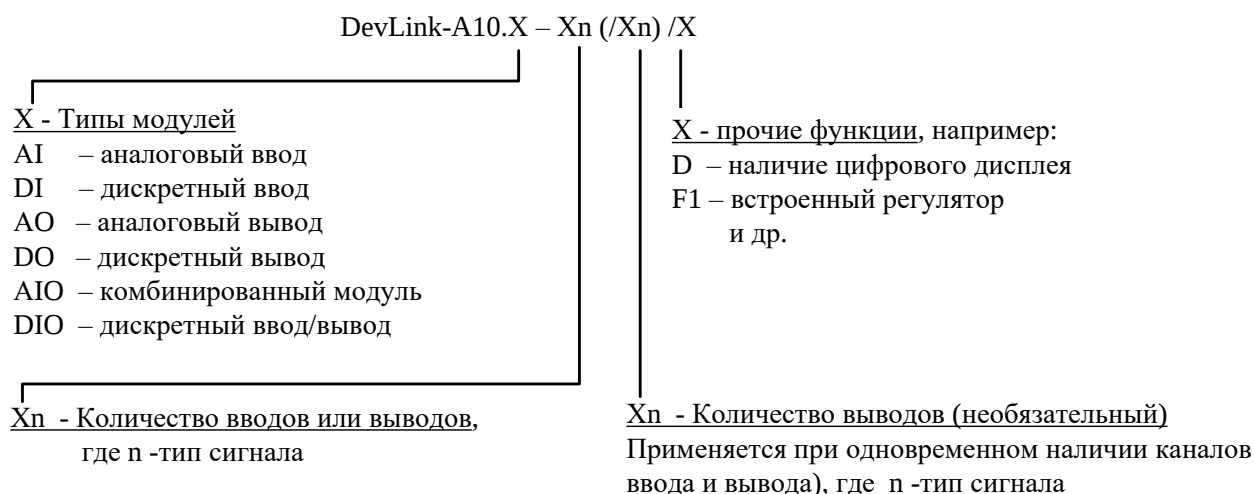

n – Тип сигнала

ТС – сигнал термоэлектрических преобразователей	T – транзисторный
UI – унифицированные сигналы напряжения и тока	R (A, A4) – релейный
RTD – сигнал термометров сопротивления	S – симисторный
BD – двунаправленный дискретный ввод или вывод	H – высоковольтные
и др	

Примеры обозначений:

DevLink-A10. AI-3RTD/D - модуль ввода аналоговых сигналов с 3 каналами ввода (сигналы термометров сопротивлений), с наличием цифрового дисплея

DevLink-A10. DIO-8H/4RA - модуль дискретного ввода-вывода, с 8 каналами дискретного ввода (высоковольтные), с 4 каналами вывода (релейные)

DevLink-A10. AIO-1/F1 - модуль комбинированный ввода-вывода, с 1 каналом аналогового ввода, с 1 каналом аналогового вывода, с 4 каналами дискретного ввода, с 6 каналами дискретного вывода (транзисторный), со встроенным регулятором

DevLink-A10. AIO-4/4R/M0 - модуль комбинированный ввода-вывода с 4 каналами аналогового ввода, с 4 каналами дискретного ввода, с 4 каналами дискретного вывода (релейные)

Рисунок 1 – Система обозначений модулей ввода/вывода DevLink A10

Общий вид контроллеров DevLink приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Общий вид контроллеров DevLink

Для предотвращения несанкционированного доступа к контроллерам DevLink на его корпусе предусмотрен концевой выключатель. Принцип его действия состоит в том, что при вскрытии корпуса в протокол событий CPVK добавляется соответствующая запись.

Дополнительная защита может быть предусмотрена путем закрепления контроллеров DevLink на DIN-рейку в корпусе шкафа, который закрывается на ключ или пломбируется. Также в шкаф может ставиться датчик открытия дверцы, информация с которого записывается в протокол событий контроллера, внешний вид датчика открытия дверцы приведен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Внешний вид датчика открытия дверцы

Программное обеспечение

Процессорные модули контроллеров DevLink включают программное обеспечение – СРВК, которое в зависимости от модификаций может обеспечивать выполнение следующих функций:

- измерение и контроль технологических параметров;
- выполнение технологических программ пользователя;
- формирование и выдача данных оперативному персоналу;
- формирование выходных дискретных сигналов;
- самодиагностику;
- автоматический перезапуск;
- межконтроллерный обмен;
- коррекцию системного времени контроллера по внешней команде;
- обработку и сохранение переменных баз данных;
- ведение трендов;
- взаимодействие с модулями ввода и вывода;
- управление GPRS каналом связи;
- интеграцию со сторонними цифровыми устройствами и системами по цифровым интерфейсам.

Программное обеспечение (ПО) контроллеров DevLink является встроенным и состоит из:

- ПО DevLink Linux – метрологически значимой части ПО;
- ПО СРВК DevLink (метрологически незначимой части ПО), реализованного в виде файлов операционной системы Linux.

Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Идентификационные данные ПО	Значение
Идентификационное наименование ПО	DevLink Linux
Номер версии (идентификационный номер ПО)	8.2
Цифровой идентификатор ПО	0xC973
Алгоритм подсчёта контрольной суммы	MODBUS CRC16

Метрологические характеристики контроллеров DevLink нормированы с учётом влияния ПО.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики приведены в таблицах 3-13. Технические характеристики приведены в таблице 14.

Таблица 3 – Метрологические характеристики каналов измерений напряжения постоянного тока

Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение
от 0 до 50 мВ	±0,1	50 мВ
от 0 до 150 мВ	±0,1	150 мВ
от 0 до 500 мВ	±0,1	500 мВ
от 0 до 1000 мВ	±0,1	1000 мВ

Продолжение таблицы 3

Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение
от –150 до +150 мВ	$\pm 0,1$	300 мВ
от –250 до +250 мВ	$\pm 0,1$	500 мВ
от –500 до +500 мВ	$\pm 0,1$	1000 мВ
от –1 до +1 В	$\pm 0,1$	2 В
от –2 до +2 В	$\pm 0,1$	4 В
от –5 до +5 В	$\pm 0,1$	10 В
от –10 до +10 В	$\pm 0,1$	20 В
от 0 до 1 В	$\pm 0,1$	1 В
от 0 до 2 В	$\pm 0,1$	2 В
от 0 до 5 В	$\pm 0,1$	5 В
от 0 до 10 В	$\pm 0,1$	10 В

Таблица 4 – Метрологические характеристики каналов измерений силы постоянного тока

Диапазоны входных сигналов, мА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение, мА
от –20 до +20	$\pm 0,1$	40
от 0 до 20	$\pm 0,1$	20
от 4 до 20	$\pm 0,1$	16

Таблица 5 – Метрологические характеристики каналов измерений электрического сопротивления

Диапазоны входных сигналов, Ом	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение, Ом
от 0 до 100	$\pm 0,1$	100
от 0 до 250	$\pm 0,1$	250
от 0 до 500	$\pm 0,1$	500
от 0 до 1000	$\pm 0,1$	1000
от 0 до 2000	$\pm 0,1$	2000

Таблица 6 – Метрологические характеристики измерительных каналов счета импульсов

Наименование характеристики	Значение
Диапазон счета количества импульсов, имп.	от 0 до 65535
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счёта импульсов, имп.	± 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	1000
Напряжение входного сигнала, В	от 5 до 15

Таблица 7 – Метрологические характеристики каналов воспроизведения силы постоянного тока

Диапазоны выходного сигнала, мА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение, мА
от 0 до 20	$\pm 0,1$	20
от 4 до 20	$\pm 0,1$	16

Таблица 8 – Метрологические характеристики каналов воспроизведения напряжения постоянного тока

Диапазон выходного сигнала, В	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	Нормирующее значение, В
от 0 до 5	$\pm 0,1$	5
от 0 до 10	$\pm 0,1$	10

Таблица 9 – Метрологические характеристики каналов измерений температуры с помощью внешних термодпар, нормируемые статические характеристики преобразования которых регламентированы ГОСТ Р 8.585-2001

Обозначение типа термодпары	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °C
K	от -200 до +1300	± 1
L	от -200 до +800	± 1
S	от -50 до +1700	± 2
R	от -50 до +1700	± 2
B	от +300 до +1700	± 2
A-1	от 0 до +2300	± 3
J	от -200 до +1200	± 1
N	от -200 до +1300	± 1

Таблица 10 – Метрологические характеристики каналов измерений температуры с помощью внешних термометров сопротивлений, нормируемые статические характеристики которых регламентированы ГОСТ 6651-2009

Тип термометра сопротивления	Обозначение типа термометра сопротивления	Температурный коэффициент термометра сопротивления, α , °C ⁻¹	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °C
Медный	50M	0,00428	от -180 до +200	$\pm 0,25$
Медный	100M	0,00428	от -180 до +200	$\pm 0,25$
Платиновый	Pt 50	0,00385	от -200 до +850	± 1
Платиновый	Pt 100	0,00385	от -200 до +850	± 1

Продолжение таблицы 10

Тип термометра сопротивления	Обозначение типа термометра сопротивления	Температурный коэффициент термометра сопротивления, α , $^{\circ}\text{C}^{-1}$	Диапазон измерений, $^{\circ}\text{C}$	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, $^{\circ}\text{C}$
Платиновый	Pt 500	0,00385	от -200 до $+850$	± 1
Платиновый	50П	0,00391	от -200 до $+850$	± 1
Платиновый	100П	0,00391	от -200 до $+850$	± 1
Никелевый	100Н	0,00617	от -60 до $+180$	$\pm 0,3$
Никелевый	500Н	0,00617	от -60 до $+180$	$\pm 0,3$

Таблица 11 – Метрологические характеристики каналов измерений электрического сопротивления, каналов измерений (воспроизведения) напряжения и силы постоянного тока с резервированием и/или барьерами искрозащиты

Пределы допускаемой погрешности	
основной	дополнительной
$1,1 \cdot \theta_0$	0,5 пределов допускаемой основной погрешности измерений (воспроизведения) каналов с резервированием и/или барьерами искрозащиты
Примечание. θ_0 – пределы допускаемой основной погрешности соответствующих каналов, регламентированных в таблицах 3-10.	

Таблица 12 – Метрологические характеристики каналов измерений интервалов времени

Пределы допускаемой абсолютной среднесуточной погрешности хода часов (текущего времени) без внешней синхронизации (в автономном режиме), с	
в нормальных условиях	в условиях эксплуатации
± 2	± 3

Таблица 13 – Дополнительные погрешности измерений

Характеристика	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах условий эксплуатации на каждые 10°C	$0,25\Delta$
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений температуры с помощью внешних термометров сопротивлений типов 50М и 100М, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах условий эксплуатации на каждые 10°C	Δ
Примечание. Δ – пределы допускаемой основной погрешности измерений	

Таблица 14 – Технические характеристики контроллеров DevLink

Характеристика	Значение
Масса, кг, не более: – процессорного модуля – модуля ввода/вывода	0,5 0,3
Габаритные размеры, мм, не более: – процессорного модуля* – модуля ввода/вывода DevLink-A10* – модуля ввода/вывода DevLink-A10* – модуля ввода/вывода DevLink-A10* – модуля ввода/вывода DevLink-A10*	140×90×65 или 160×90×65 70×90×58 150×90×58 105×90×58 142×107×72
Нормальные условия: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность окружающего воздуха, % – атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) – напряжение питания переменного тока, В – напряжение питания постоянного тока, В – частота питающего напряжения, Гц	от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106 (от 630 до 795) от 198 до 242 от 22 до 26 от 49 до 51
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С – атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) – напряжение питания переменного тока, В – напряжение питания постоянного тока, В – частота питающего напряжения, Гц	от –40 до +60 от 84 до 106,7 (от 630 до 800) от 170 до 260 от 18 до 30 от 47,5 до 52,5
Примечание * – в зависимости от модификаций процессорного модуля и модификаций аппаратной платформы модулей ввода/вывода DevLink-A10	

Знак утверждения типа

наносится на табличку, расположенную на задней поверхности корпуса контроллера или на лицевую сторону корпуса (в зависимости от вида модуля), и в левый верхний угол титульного листа руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность контроллеров DevLink приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Комплектность контроллеров DevLink

Наименование	Обозначение	Количество
Технические средства		
Контроллер промышленный DevLink. (конструктивное исполнение и конфигурация измерительных каналов определяется паспортом)	DevLink	1 экз.
Программное обеспечение		
Программное обеспечение DevLink	DevLink	1 компл.
Документация		
Паспорт	ЖАЯК.420000.002-XX ПС*	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ЖАЯК.420000.002-XX РЭ*	1 экз.
Эксплуатационная документация на программное обеспечение	–	1 экз.
Примечание * – в зависимости от модификации контроллера		

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационной документации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;

ЖАЯК.420000.002 ТУ. Контроллеры промышленные DevLink. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «КРУГ» (ООО НПФ «КРУГ»)

ИНН 5837003278

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1

Телефон: (8412) 49-97-75, 49-94-14, 49-72-24

E-mail: krug@krug2000.ru

Web-сайт: www.krug2000.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» (ФБУ «Пензенский ЦСМ»)

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 20

Телефон (факс): (8412) 49-82-65

E-mail: pcsm@sura.ru

Web-сайт: www.penzacsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311197.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «15» октября 2024 г. № 2454

Регистрационный № 90734-23

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока АКИП-1167

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока АКИП-1167 (далее – источники) предназначены для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока и их регулировки.

Описание средства измерений

По принципу действия источники относятся к программируемым линейным источникам питания. Принцип формирования постоянного напряжения построен на ВЧ преобразователе. Управление и контроль режимами работы источников осуществляется встроенным микроконтроллером. Установка выходных параметров осуществляется с помощью функциональных клавиш и/или поворотного переключателя, расположенного на лицевой панели источников.

Источники имеют два регулируемых канала (СН1 и СН2) и один фиксированный (СН3) – с переключаемым выходным напряжением 2,5; 3,3 и 5 В. Принцип действия регулируемых каналов основан на использовании комбинации управляемого полумоста и линейного регулятора. Полумост управляется модуляцией ширины импульса. Линейный регулятор выполняет точную стабилизацию выходного напряжения. Фиксированный канал имеет только линейный регулятор.

Источники выпускаются в двух модификациях АКИП-1167/1 и АКИП-1167/2, которые отличаются между собой дискретностью установки выходных параметров.

Конструктивно источники выполнены в металлических корпусах настольного исполнения, допускающих монтаж в приборную стойку.

На передней панели источников расположены дисплеи вольтметра и амперметра, индикаторы, регуляторы, функциональные кнопки и выключатели. На задней панели источников расположены разъемы интерфейсов USB и LAN, вентиляционная решетка, разъем подключения питания, переключатели напряжения питания.

Общий вид источников и место нанесения знака утверждения типа представлены на рисунке 1.

Знак поверки в виде оттиска клейма или наклейки с изображением знака поверки может наноситься на свободном от надписей пространстве на верхней панели прибора. Место нанесения знака поверки представлено на рисунке 1.

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям источников предусмотрена пломбировка, наносимая на стык корпуса. Пломба, в виде наклейки, может устанавливаться производителем, ремонтной организацией, поверяющей организацией или организацией, эксплуатирующей данное средство измерений. Схема опломбирования от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Заводской (серийный) номер источников состоит из буквенно-цифрового обозначения и наносится на обратную сторону корпуса при помощи наклейки. Место нанесения заводского (серийного) номера представлено на рисунке 2.

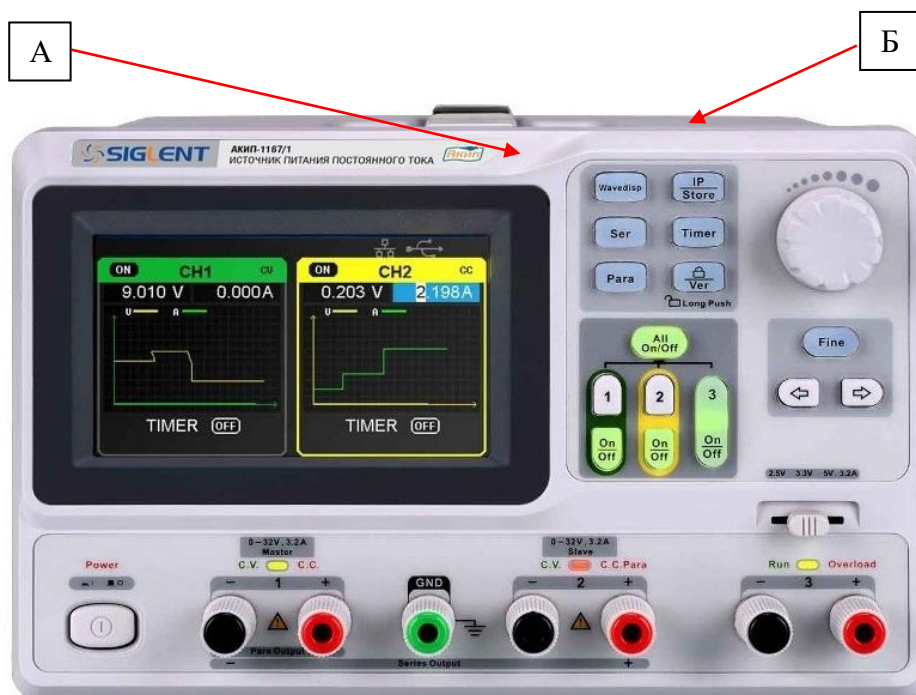


Рисунок 1 – Общий вид источников, места нанесения знака утверждения типа (А) и знака поверки (Б)



Рисунок 2 – Схема опломбирования от несанкционированного доступа (В) и места нанесения серийного номера (Г)

Программное обеспечение

Программное обеспечение источников встроено в защищенную от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированных настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов измерений. Идентификационные данные программного обеспечения источников представлены в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «средний» от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	отсутствует
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.01.01.XX
Примечание: номер версии ПО определяется по первым трем группам цифр, разделенным точкой; вместо символов X допускаются любые буквенно-цифровые обозначения	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	АКИП-1167/1	АКИП-1167/2
1	2	3
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока, В регулируемые каналы (СН1 и СН2): - независимое и параллельное включение - последовательное включение фиксированный канал (СН3)	от 0 до 32 В от 0 до 64 В 2,5/3,3/5	
Дискретность установки напряжения, мВ	1	10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения напряжения постоянного тока регулируемых каналов, В	$\pm(0,0003 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,01)$	$\pm(0,005 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,02)$
Нестабильность выходного напряжения регулируемых каналов, В, не более - при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального значения - при изменении тока нагрузки от $I_{\text{макс}}$ до 0	$0,0001 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,002$ $0,0001 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,002$	
Нестабильность выходного напряжения фиксированного канала, В, не более - при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального значения - при изменении тока нагрузки от $I_{\text{макс}}$ до 0	$0,0001 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,003$ $0,0001 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,003$	
Пульсации выходного напряжения в диапазоне частот от 5 Гц до 1 МГц регулируемых каналов, мВ _{ср} , не более	1	
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока, А регулируемые каналы (СН1 и СН2): - независимое и последовательное включение - параллельное включение	от 0 до 3,2 от 0 до 6,4	
Дискретность установки силы тока, мА	1	10
Максимальный выходной ток нерегулируемого канала (СН3), А	3,2	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы постоянного тока регулируемых каналов, А	$\pm(0,003 \cdot I_{\text{ВЫХ}} + 0,01)$	$\pm(0,005 \cdot I_{\text{ВЫХ}} + 0,02)$

Продолжение таблицы 2

1	2	3
Нестабильность выходного тока регулируемых каналов, А, не более - при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального значения - при изменении напряжения на нагрузке от $U_{\text{макс}}$ до 0,1 $U_{\text{макс}}$	$0,002 \cdot I_{\text{вых}} + 0,003$ $0,002 \cdot I_{\text{вых}} + 0,003$	
Нестабильность выходного тока фиксированного канала, А, не более - при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального значения - при изменении напряжения на нагрузке от $U_{\text{макс}}$ до 0,1 $U_{\text{макс}}$	$0,002 \cdot I_{\text{вых}} + 0,003$ $0,002 \cdot I_{\text{вых}} + 0,003$	
Пульсации выходного тока регулируемых каналов, мА _{скз} , не более	3	

Таблица 3 – Технические характеристики источников

Наименование характеристики	Значение
Максимальная выходная мощность, Вт	204,8
Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +18 до +28 75 от 84,0 до 106,7
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха (при температуре до +30 °С), %, не более - атмосферное давление, кПа	от 0 до +40 80 от 84,0 до 106,7
Напряжение питающей сети, В (переключаемое)	100/120/220/230
Номинальные значения частоты питающей сети, Гц	50/60
Масса, кг, не более	8,0
Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм	225×143×278

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель источников методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность источников

Наименование	Обозначение	Количество
Источник питания постоянного тока	АКИП-1167	1 шт.
Измерительные провода «под зажим» - «крокодил»	-	1 комп.
Измерительные провода «банан 4мм» - «крокодил»	-	1 комп.
Сетевой кабель питания	-	1 шт.
Кабель USB	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 6 «Работа с прибором» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

Приказ Росстандарта от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;

Приказ Росстандарта от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»;

Стандарт предприятия «Источники питания постоянного тока АКПП-1167».

Правообладатель

«SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD», Китай

Адрес: 3F, Building №4, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Rd, Baoan District, Shenzhen, 518101, P.R. China

Телефон: +86 755 3661 5186

Факс: +86 755 3359 1582

Web-сайт: <http://www.siglent.com/ens/>

Изготовитель

«SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD», Китай

Адрес: 3F, Building №4, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Rd, Baoan District, Shenzhen, 518101, P.R. China

Телефон: +86 755 3661 5186

Факс: +86 755 3359 1582

Web-сайт: <http://www.siglent.com/ens/>

Испытательный центр

Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»)

Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А

Телефон: +7(495) 777-55-91

Факс: +7(495) 640-30-23

Web-сайт: <http://www.prist.ru>

E-mail: prist@prist.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314740.