


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ

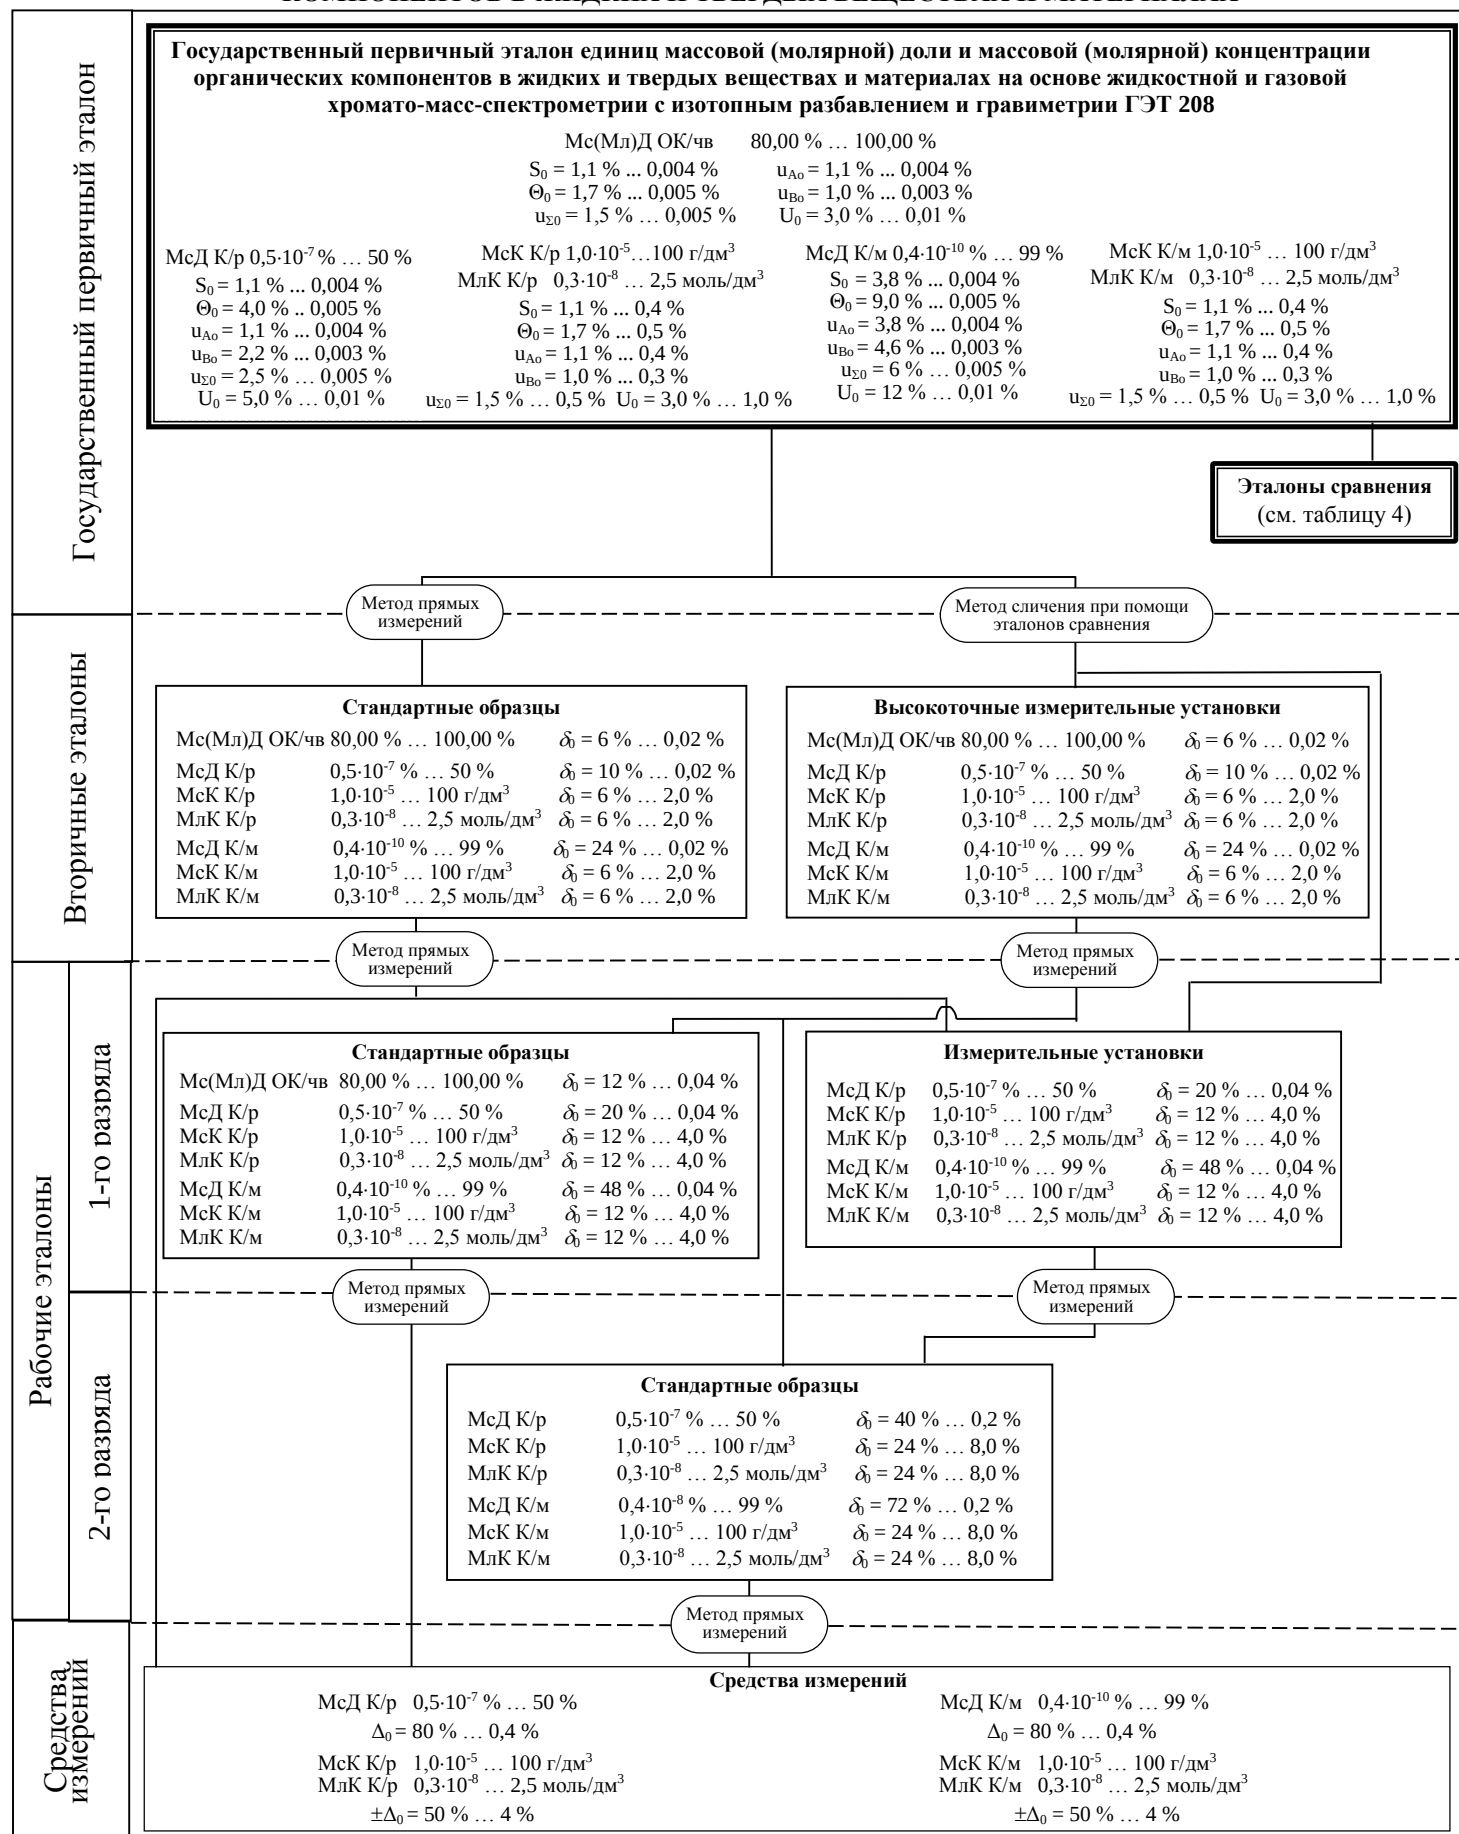

Примечание: Мс(Мл)Д ОК/чв – массовая (молярная) доля основного компонента в чистом веществе

МсД К/р – массовая доля компонента в растворе

МсК К/р – массовая концентрация компонента в растворе

МлК К/р – молярная концентрация компонента в растворе

S_0 – относительное среднее квадратическое отклонение результатов измерений (при $n=5$)

Θ_0 – относительная неисключенная систематическая погрешность (при $P = 0,95$)

δ_0 – доверительные границы относительной погрешности (при $P = 0,95$)

Δ_0 – предел допускаемых относительных погрешностей

МсД К/м – массовая доля компонента в материале

МсК К/м – массовая концентрация компонента в материале

МлК К/м – молярная концентрация компонента в материале

u_{A0} – относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А

u_{B0} – относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В

$u_{\Sigma 0}$ – относительная суммарная стандартная неопределенность

U_0 – относительная расширенная неопределенность (при $k=2$)