


Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей

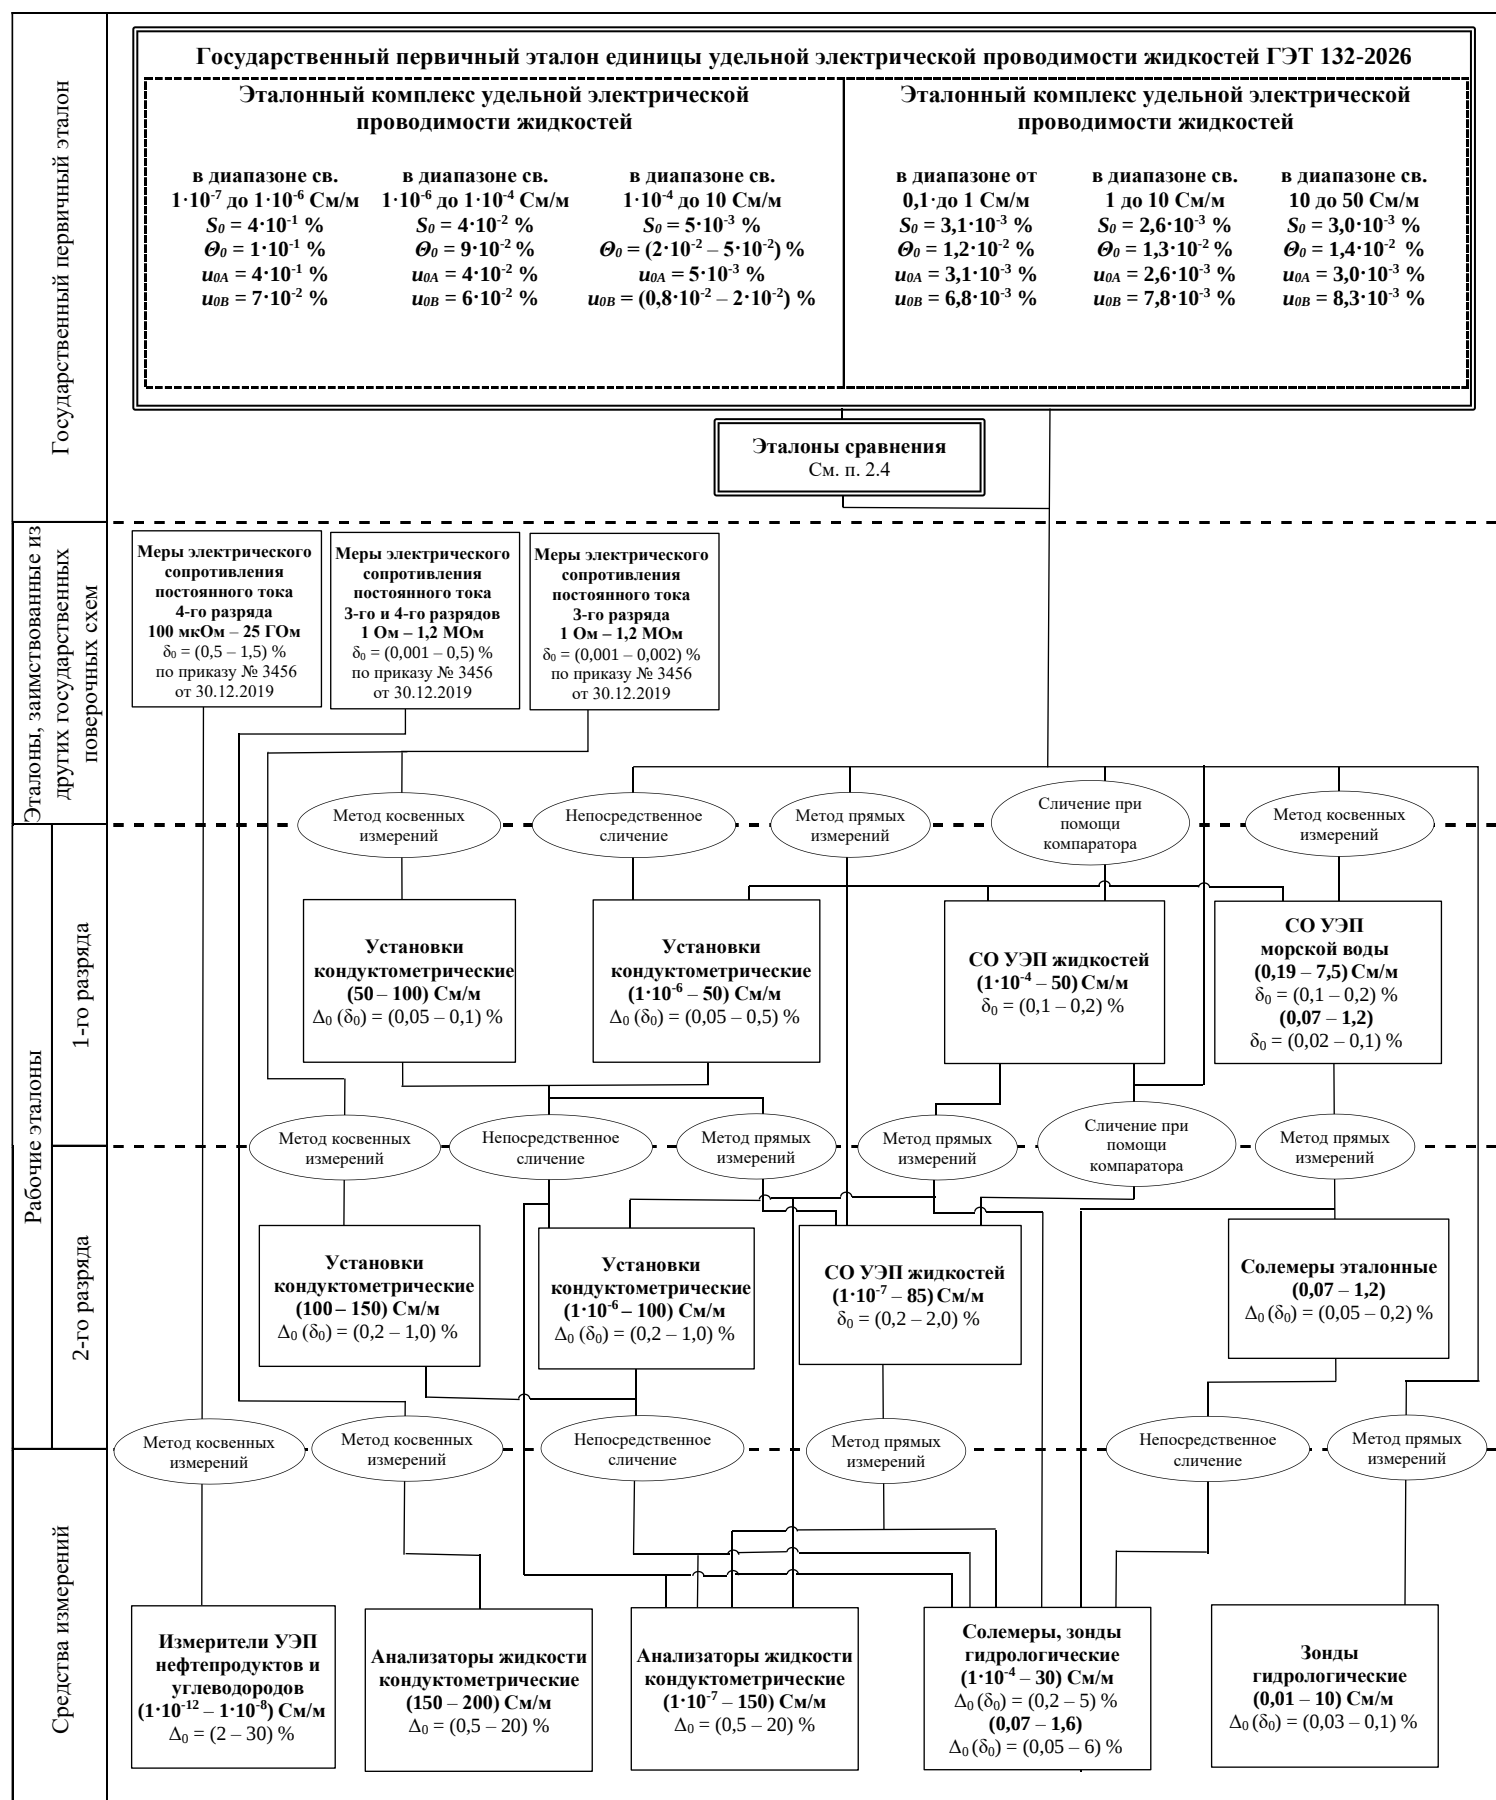

S_0 – Относительное СКО (среднее квадратическое отклонение) результата измерений; Θ_0 – Относительная НСП (неисключенная систематическая погрешность);
 u_{0A} – Относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A; u_{0B} – Относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B;
 δ_0 – Доверительные границы относительной погрешности при $P = 0,95$; Δ_0 – Предел допускаемой относительной погрешности.