


Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа

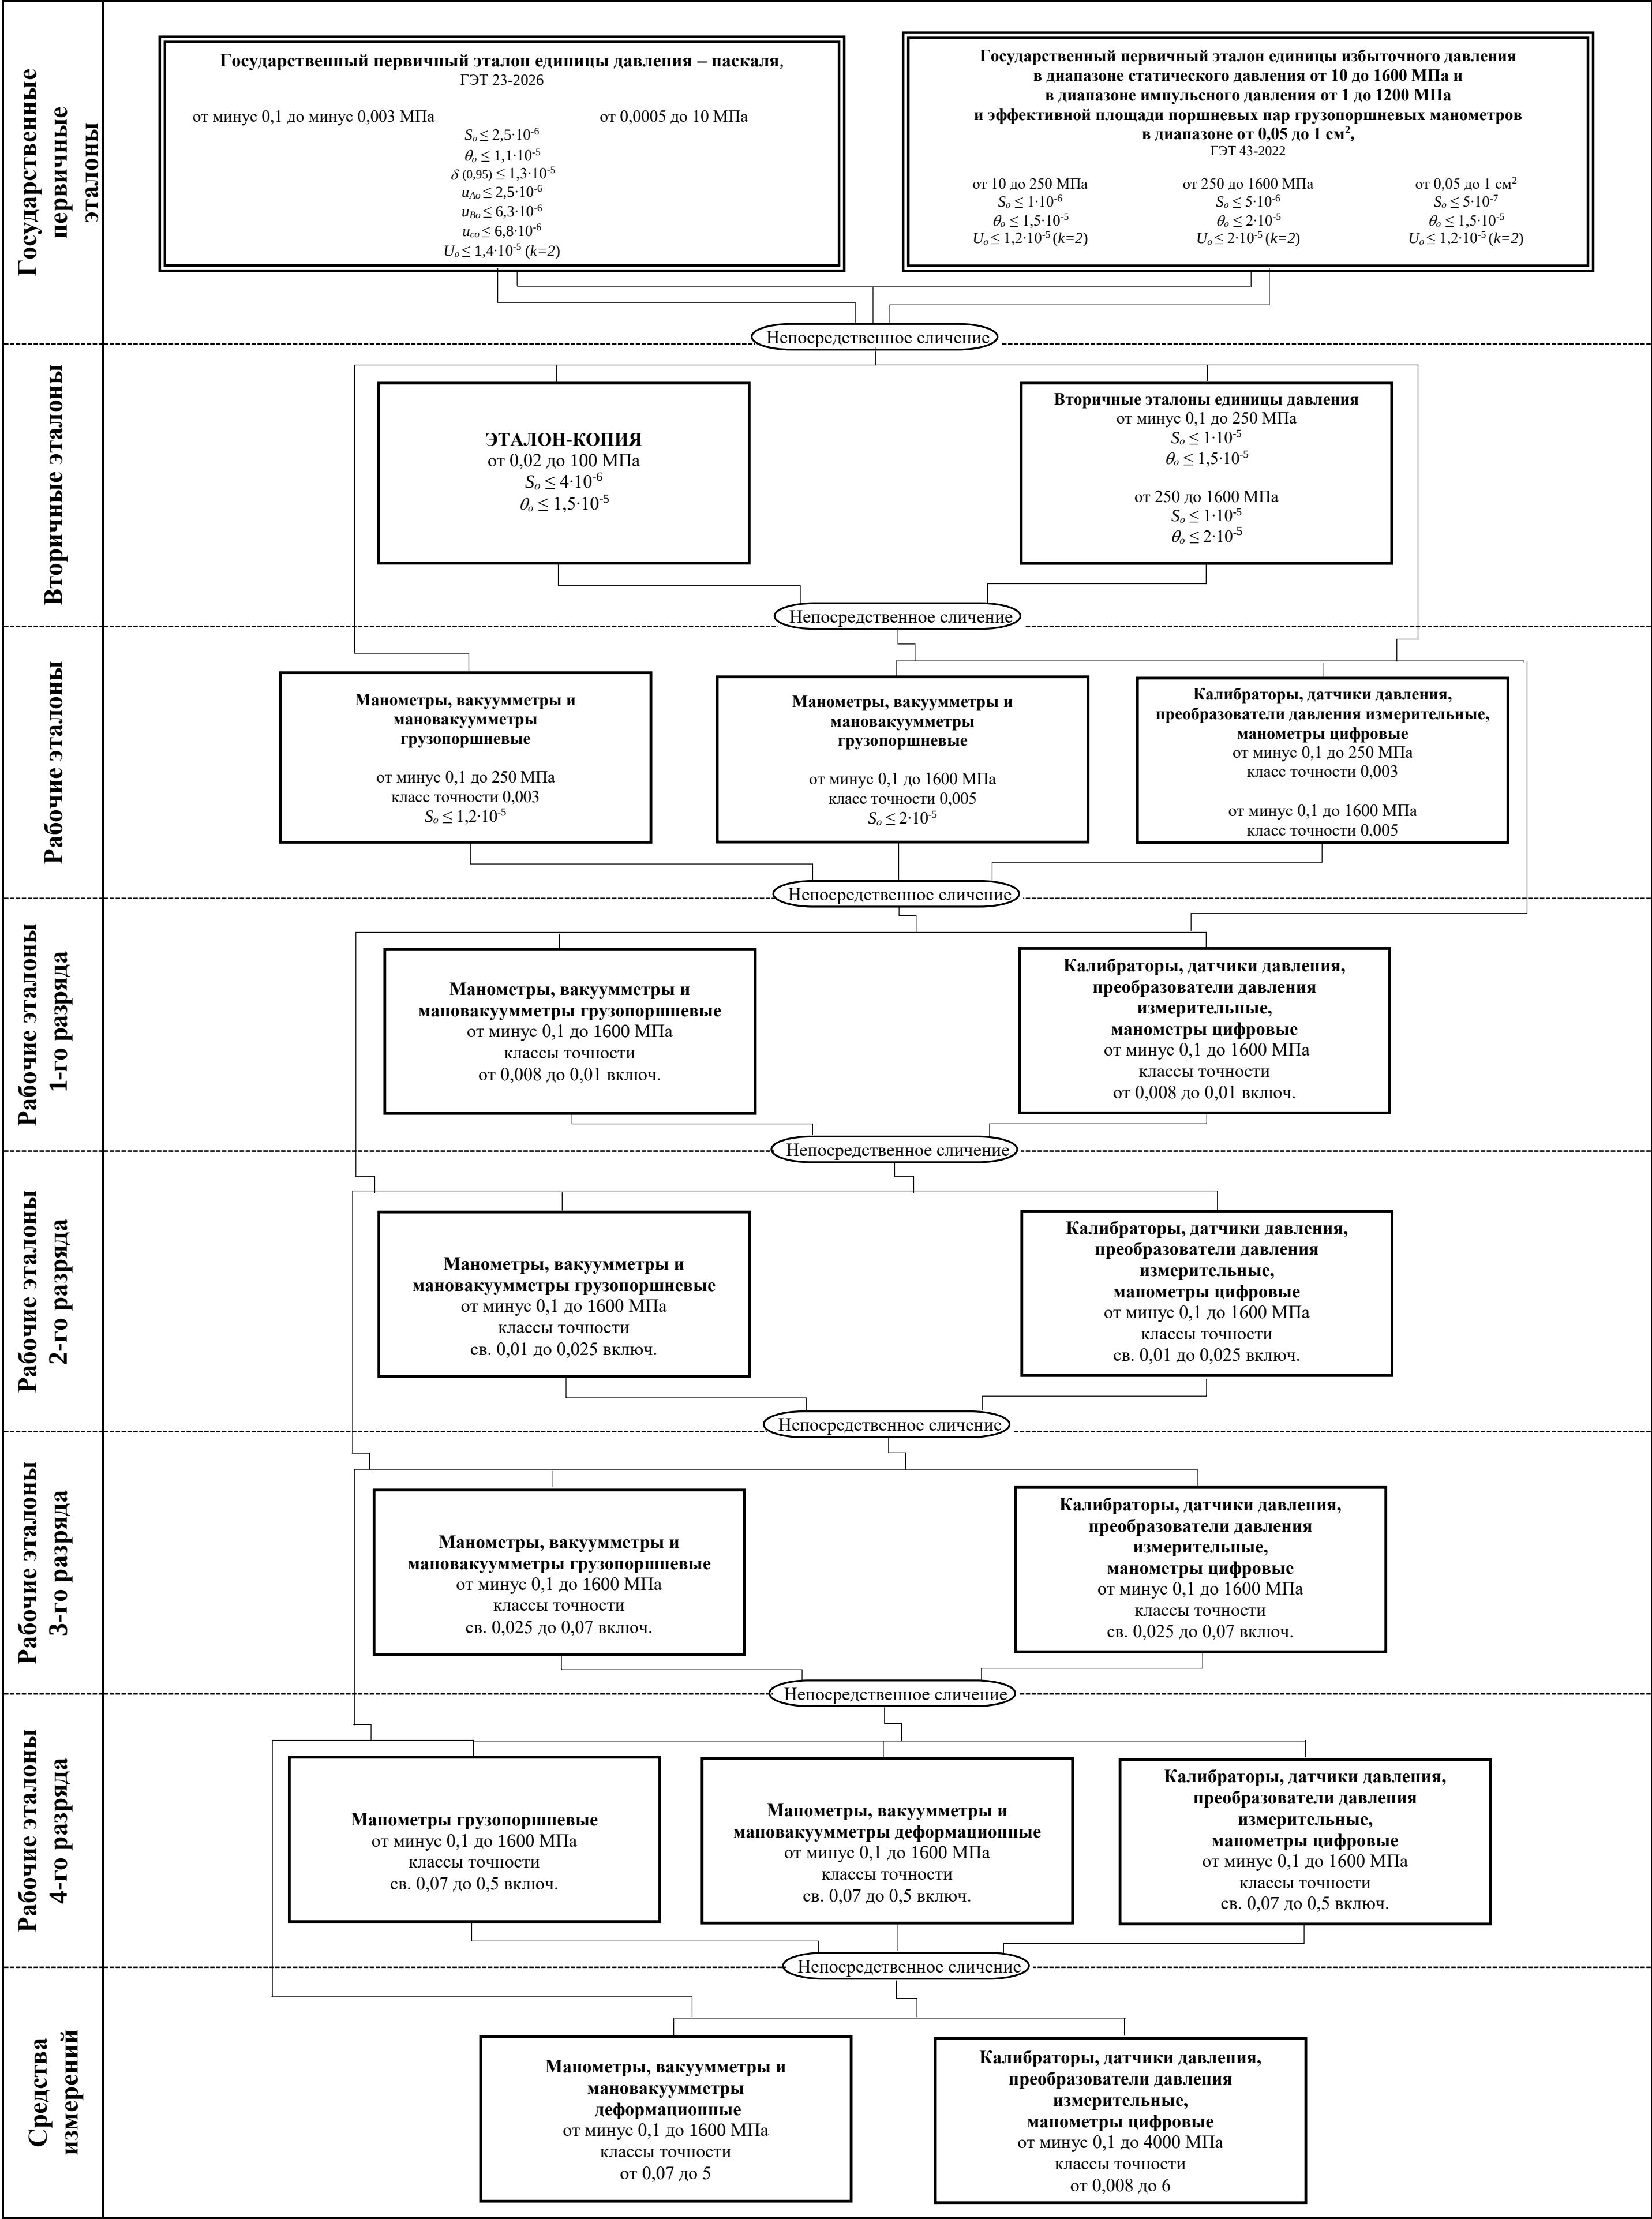

S_o – среднее квадратическое отклонение; θ_o – неисключенная систематическая погрешность; $\delta(0,95)$ – доверительные границы суммарной погрешности эталона при доверительной вероятности 0,95; u_{Ao} – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А; u_{Bo} – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В; u_{co} – суммарная стандартная неопределенность; U_o – расширенная неопределенность при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата $k = 2$.