



Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 0,2 до 300,0 мкм

Часть 1. Эталоны и средства измерений абсолютной и относительной спектральной чувствительности к потоку излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 14,0 мкм

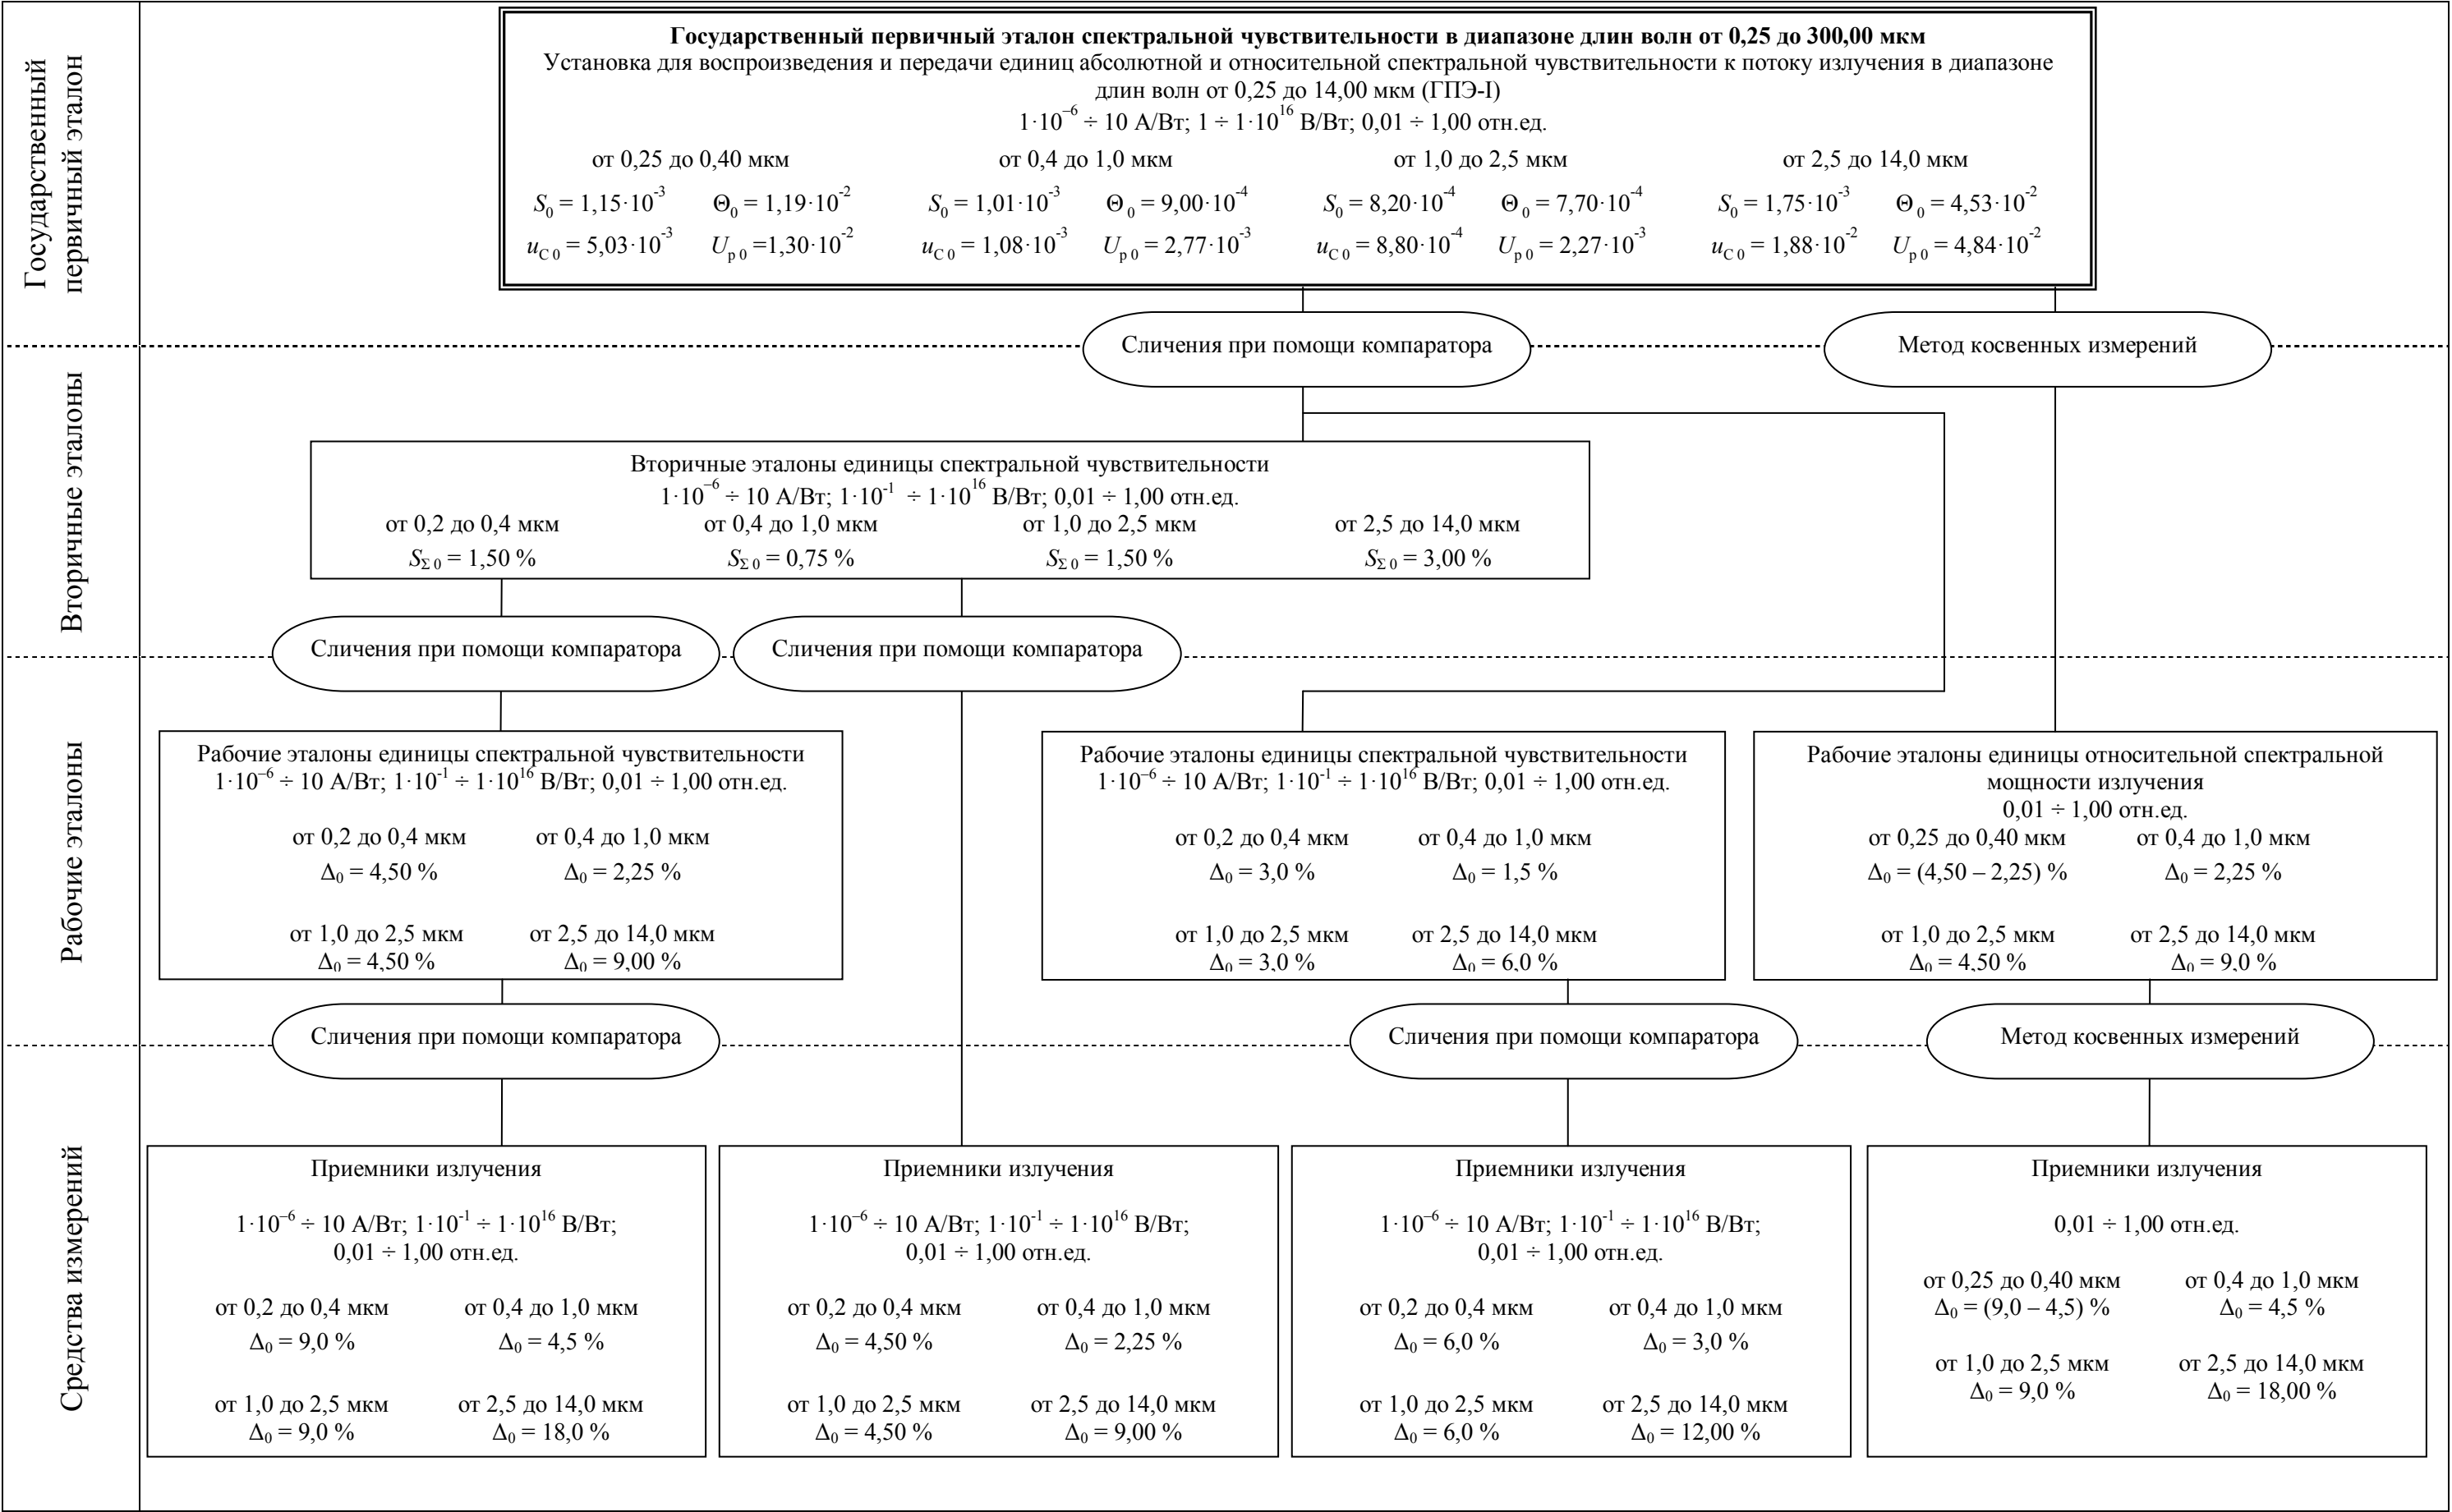

**Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной чувствительности
в диапазоне длин волн от 0,2 до 300,0 мкм**

Часть 2. Эталоны и средства измерений абсолютной и относительной спектральной чувствительности к освещенности в диапазоне длин волн от 0,35 до 2,50 мкм

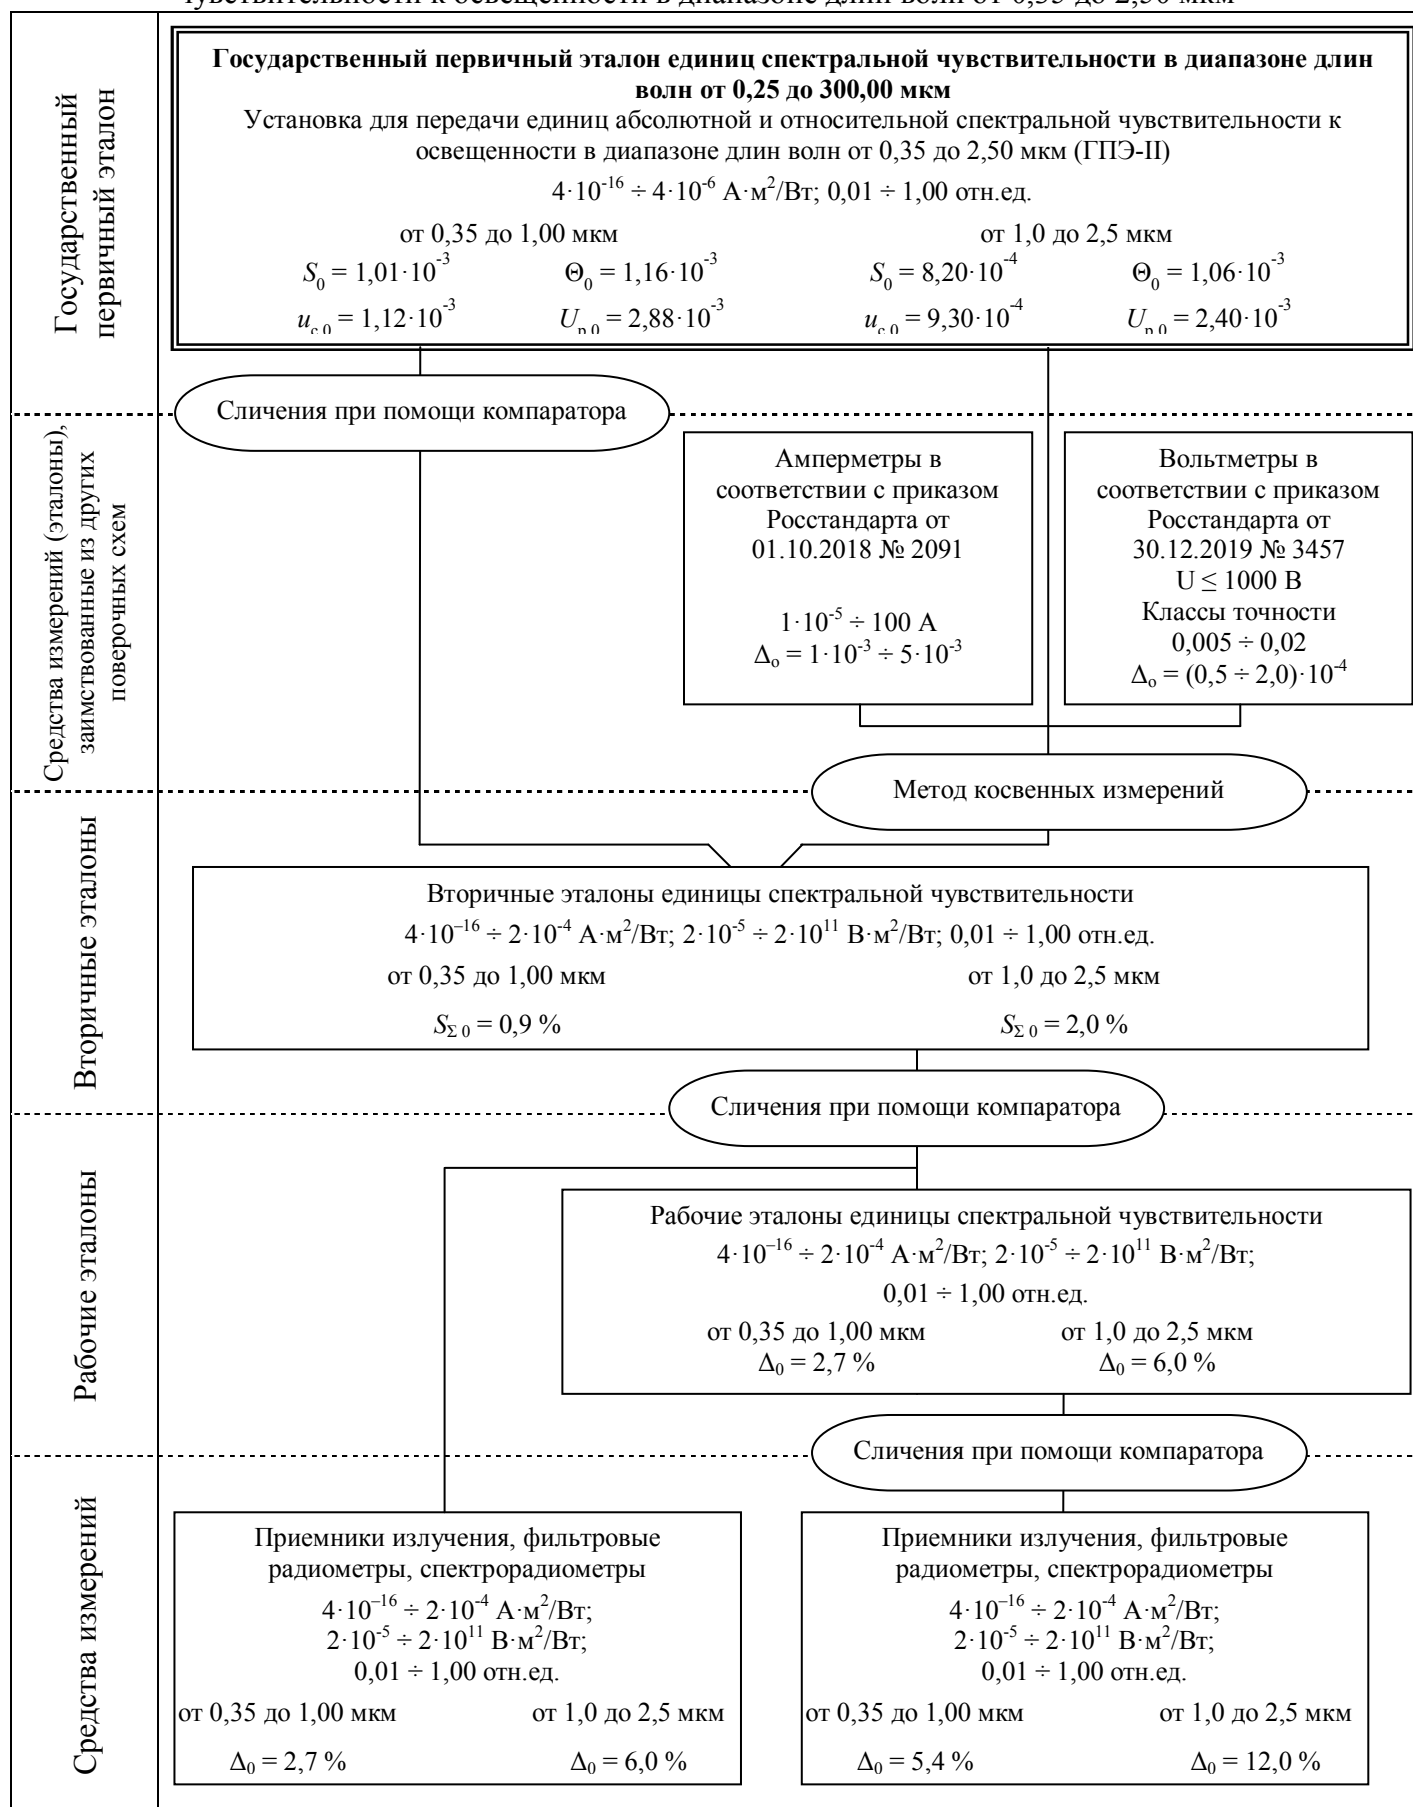

**Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной чувствительности
в диапазоне длин волн от 0,2 до 300,0 мкм**

Часть 3. Эталоны и средства измерений абсолютной и относительной спектральной чувствительности к потоку излучения в диапазоне длин волн от 14 до 300 мкм

