Приложение А
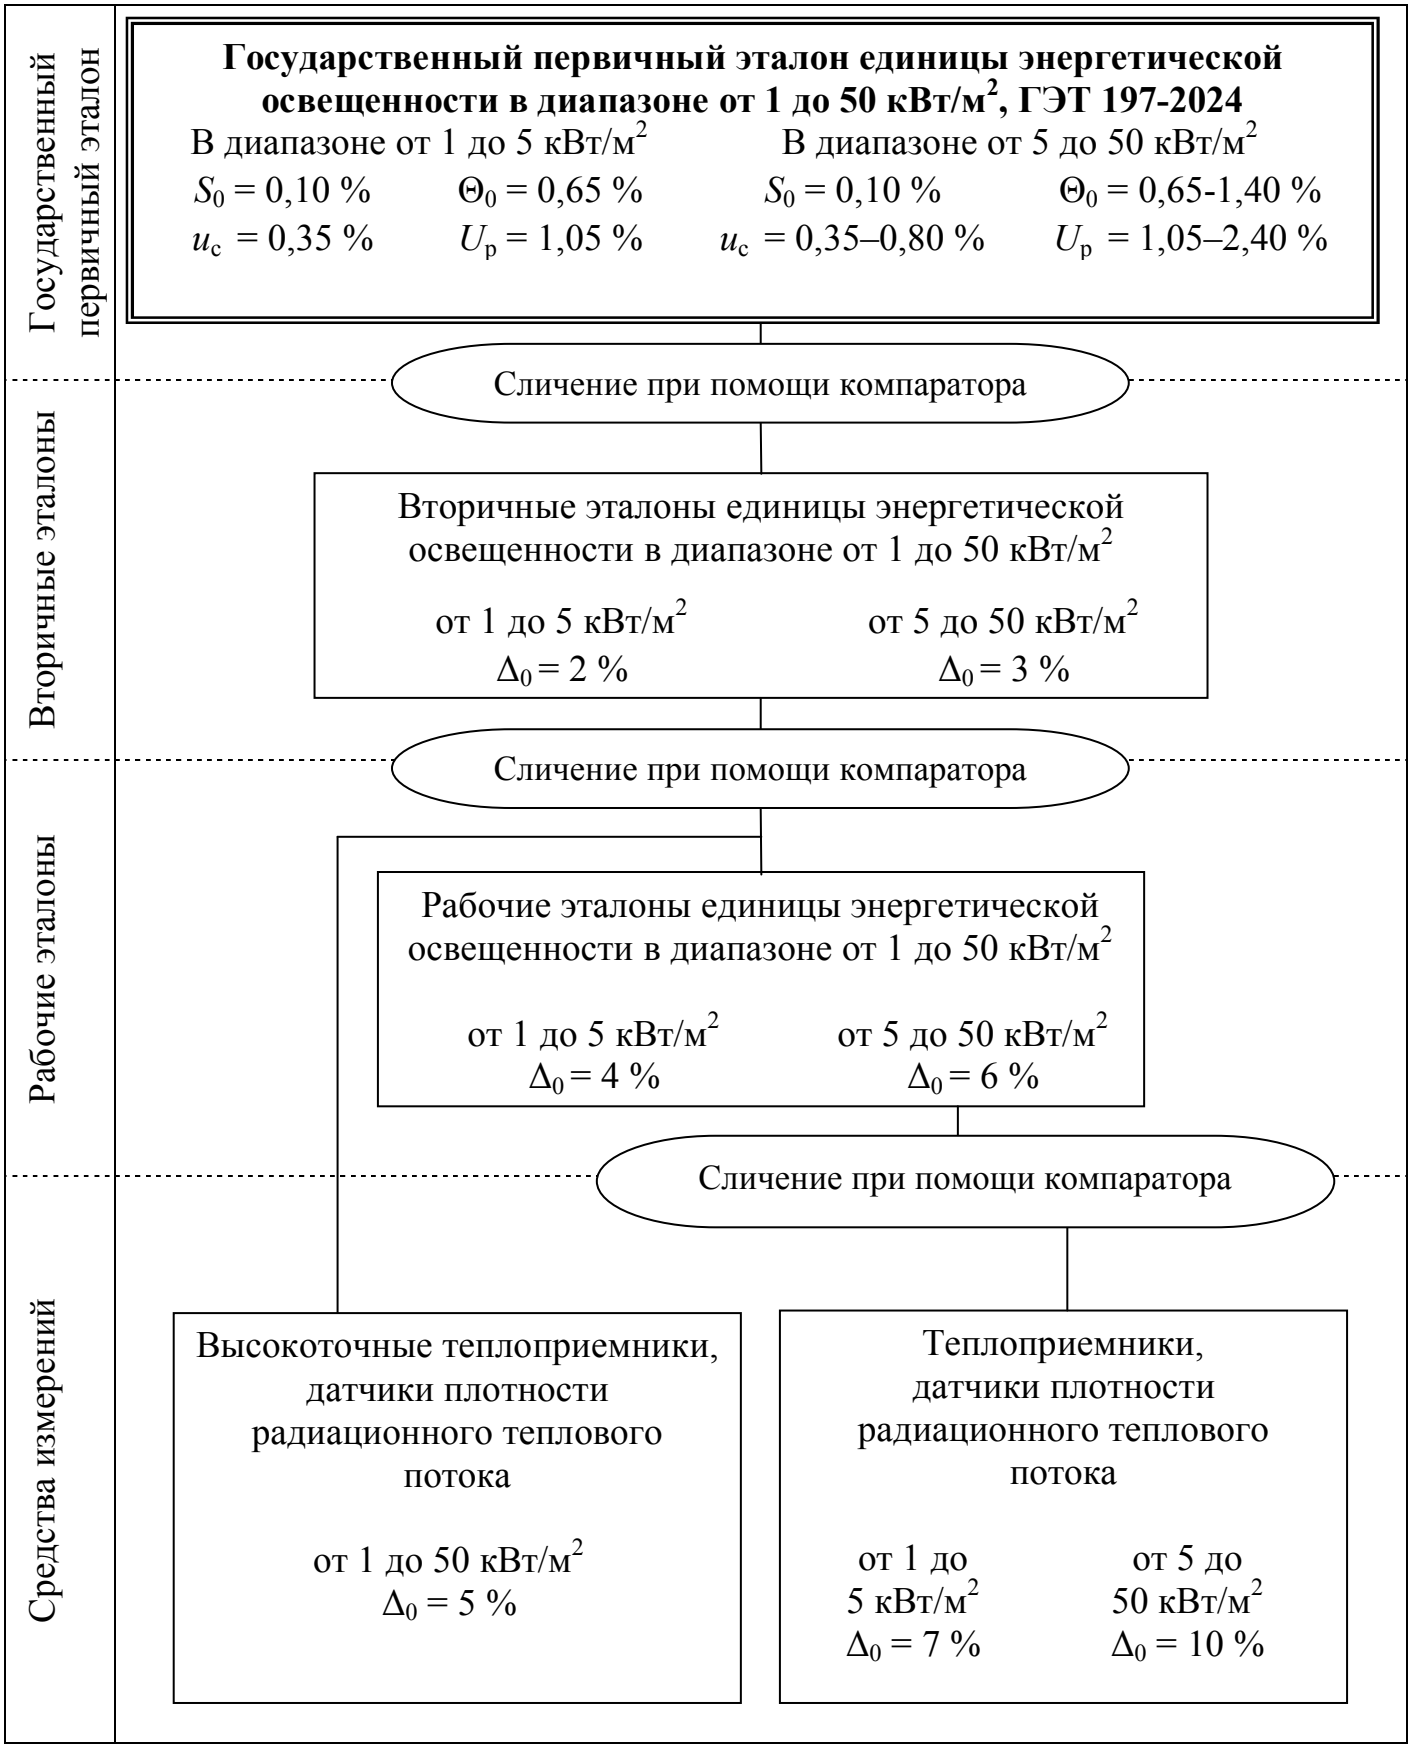
Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 50 кВт/м^2