


Приложение А (обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 14,0 Тл при температурах 4,2 и 77 К, от 1,5 до 14,0 Тл при нормальных условиях и импульсного магнитного поля в диапазоне от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до $1,4 \cdot 10^1$ Тл

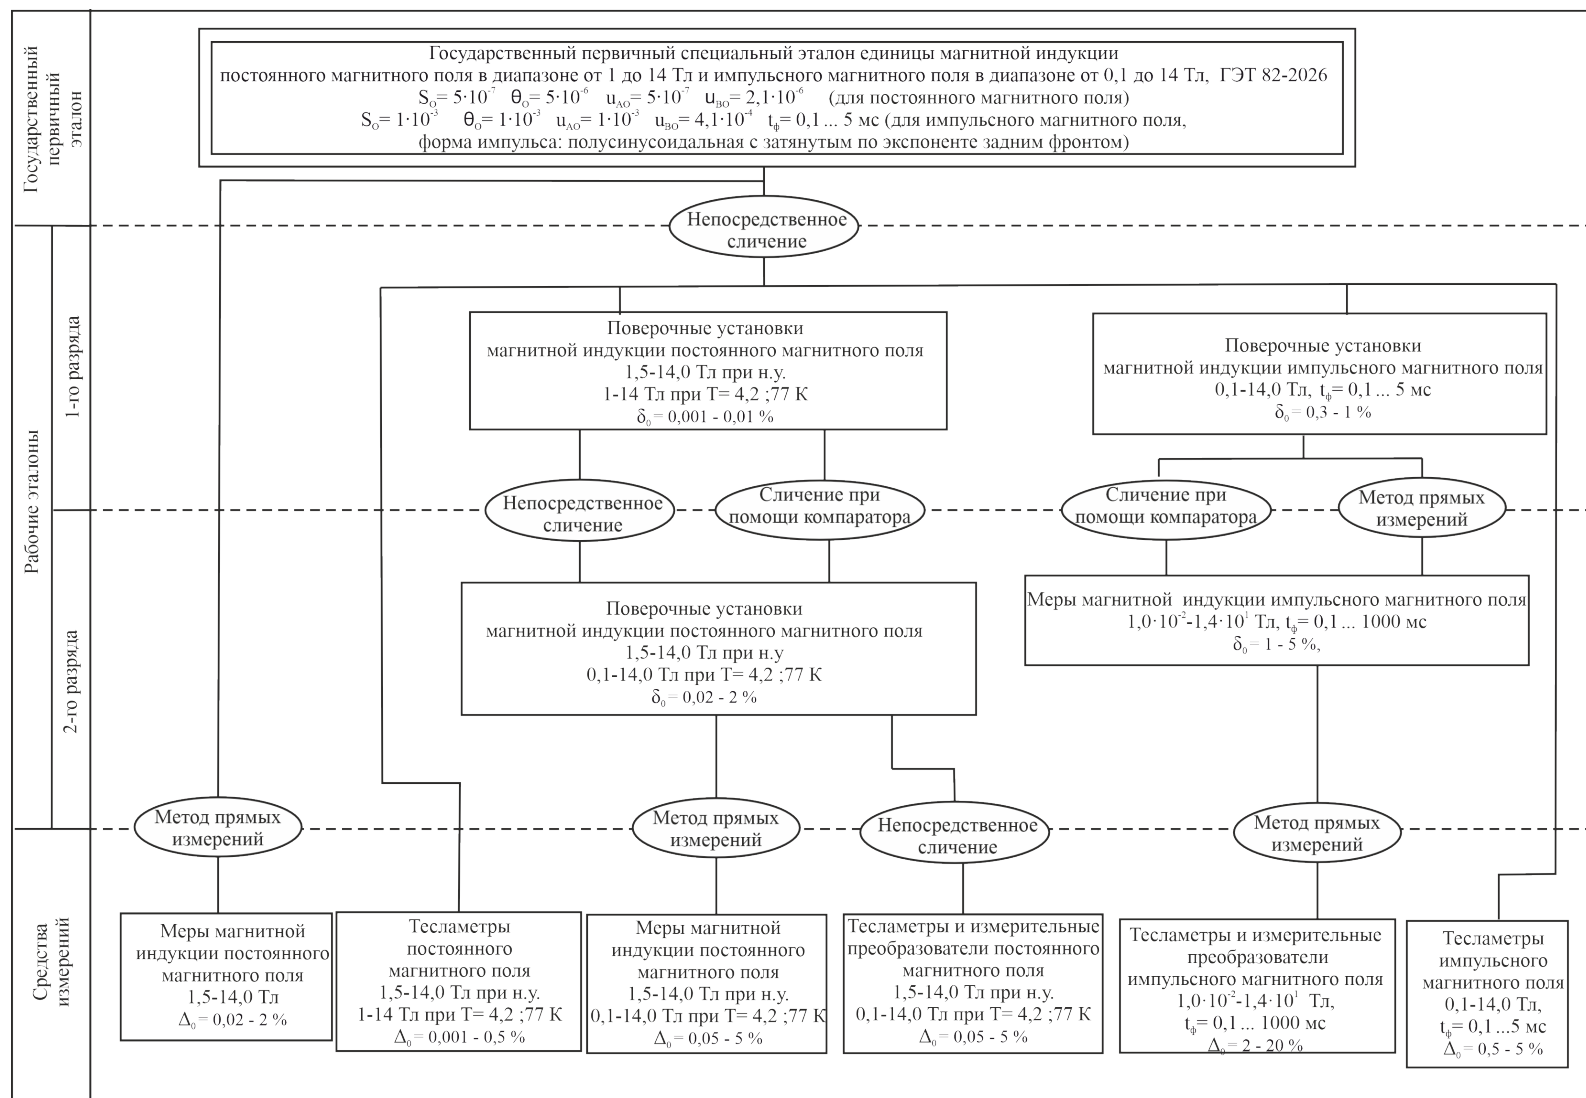

Обозначения:

S_0 - среднее квадратическое отклонение воспроизведения единицы; θ_0 - неисключенная систематическая погрешность воспроизведения единицы (P=0,99);

δ_0 - доверительные границы суммарной относительной погрешности воспроизводимой единицы (P=0,95); Δ_0 - пределы допускаемой относительной погрешности;

u_{A0} - относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A; u_{B0} - относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B

t_f - длительность фронта импульса между уровнями от 0,1 до 0,9; н.у. – нормальные условия